




AF-Xplorer™ II

BENUTZERHANDBUCH

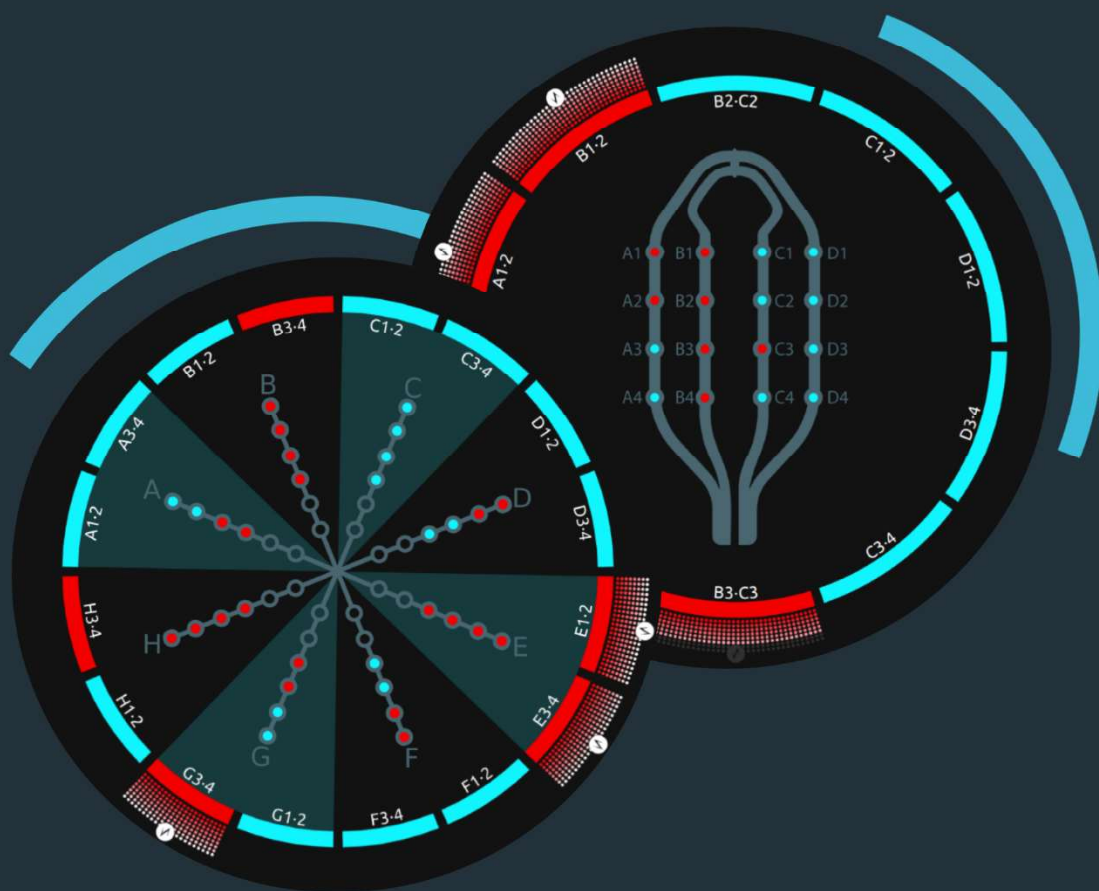

EU DE VERSION

P/N: 301013-E

OKTOBER 2025

BITTE LESEN SIE SICH DIESES DOKUMENT VOR GEBRAUCH DES
VOLTA AF-XPLORER II AUFMERKSAM DURCH.

Inhaltsverzeichnis

KAPITEL I – EINFÜHRUNG	6
KAPITEL II – SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN	7
2.1 – TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	7
2.1.1 – PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	7
2.1.2 – ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	7
2.1.3 – EMV-KENNZEICHNUNG	8
2.2 – SYMBOLE UND BESCHREIBUNG	9
2.3 – WARNHINWEISE	10
2.3.1 – ALLGEMEINE WARNHINWEISE	10
2.3.2 – ELEKTRISCHE GEFAHREN	10
2.3.4 – UMGEBUNG	11
2.3.5 – CYBERSICHERHEIT	11
2.4 – FEHLFUNKTIONEN	12
KAPITEL III – PRODUKTBESCHREIBUNG	13
3.1 – ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSPRINZIP	13
3.1.1 – ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	13
3.1.2 – FUNKTIONSPRINZIP	14
3.2 – VERWENDUNGSZWECK	15
3.3 – BENUTZRZIELGRUPPE	15
3.4 – PATIENTENZIELGRUPPE	15
3.5 – KONTRAINDIKATIONEN	15
3.6 – LEISTUNG UND SICHERHEIT	16
3.7 – REGELKONFORME ANWENDUNG UND KLINISCHER NUTZEN	16
3.8 – LISTE DER KOMPONENTEN UND DES OPTIONALEN ZUBEHÖRS	17
3.9 – KOMPATIBILITÄTEN	20
3.9.1 – KOMPATIBLE ERFASSUNGSSYSTEME	20
3.9.2 – KOMPATIBLE KATHETER	20
3.9.3 – KOMPATIBLE SIGNALE	21
3.9.4 – KOMPATIBLE DISPLAYS	21
KAPITEL IV – INSTALLATION UND INSTANDHALTUNG	22
4.1 – HARDWARE-INSTALLATION	22
4.1.1 – EINRICHTUNG MIT ERFASSUNGSSYSTEM	22
4.1.2 – EINRICHTUNG MIT ZUHÖR	27
4.1.3. ANSCHLUSS AN MEHRERE BILDSCHIRME	31
4.2 – EP-AUFZEICHNUNG UND KONFIGURATION DES 3D-MAPPING-SYSTEMS	32
4.2.1 – KONFIGURATION DES GE CARDIOLAB™:	34
4.2.2 – KONFIGURATION DES BOSTON SCIENTIFIC LAB SYSTEM™ PRO:	37

4.2.3 – KONFIGURATION DES ENSITEX MAPPING-SYSTEMS:	38
4.3 – Konfiguration des Volta AF-Xplorer II Systems	38
KAPITEL V – ANWENDUNG DES VOLTA AF-XPLORER II	39
5.1 – AUTHENTIFIZIERUNG.....	39
5.2 – EINSTELLUNGEN DES EP-AUFZEICHNUNGSSYSTEMS	40
5.3 – EINSTELLUNGEN DES VOLTA AF-XPLORER II	41
5.3.1 – KONFIGURATIONSMODUS AUSWÄHLEN	41
5.3.2 – ERFASSUNGSSYSTEM	41
5.3.3 – MAPPING-KATHETER.....	42
5.3.4 – KONFIGURATION DER VERSTÄRKUNG UND STARTEN DES VERFAHRENS	43
5.4 – SIGNALVALIDIERUNG	44
5.5 – MAPPING-PHASE	46
5.5.1 – KOMMUNIKATION EP-AUFZEICHNUNGSSYSTEM – MANUELLES TAGGING	46
5.5.2 – KOMMUNIKATION DES 3D-MAPPING-SYSTEM – AUTO-TAGGING	48
5.5.3 – ABLATION	51
5.5.4 – REMAPPING UND VORHOFTACHYKARDIE-MAPPING.....	52
5.5.5 – ENDE DES VERFAHRENS	52
KAPITEL VI – BERECHTIGUNGEN FÜR KRANKENHAUSADMINISTRATOREN	53
KAPITEL VII – FEHLERBEHEBUNG/VERBLEIBENDE ANOMALIEN.....	55
KAPITEL VIII – REINIGUNG	59
KAPITEL IX – LAGERUNG UND HANDHABUNG.....	59
KAPITEL X – INSTANDHALTUNG UND ÜBERWACHUNG	59

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AC	Wechselstrom
A/D	Analog zu Digital
VHF	Vorhofflimmern
KI	Künstliche Intelligenz
AT	Atriale Tachykardie
CS	Koronarsinus
DC	Gleichstrom
DE	Dispergierte Elektrogramme
EKG	Elektrokardiogramme
EGM	Elektrogramme
EP	Elektrophysiologie
GE	General Electric
IK	Intrakardial
PCI	Platform Component Interconnect (Plattform-Komponenten-Verbindung)
ROI	Bereich von Interesse
SW	Software
UI	Benutzeroberfläche

KAPITEL I – EINFÜHRUNG

Bei diesem Dokument handelt es sich um das Benutzerhandbuch für das von Volta Medical entwickelte und hergestellte Volta AF-Xplorer II Decision Support System (Entscheidungsunterstützungssystem) (Ref: A003), einschließlich der Software-Anwendung und Plattform.

Dieses Dokument ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt, das mit der Anwendung des Volta AF-Xplorer II befasst ist, wie z. B.:

- Elektrophysiologen, Hauptbedienpersonal des Geräts und seiner Anwendung,
- Medizinisches Personal, um die Software gemäß den Anweisungen des Elektrophysiologen zu überwachen und mit ihr zu arbeiten,
- Krankenhausadministratoren, um Bedienerkonten zu verwalten (Konto aktivieren oder deaktivieren, Bedienerkennwort zurücksetzen).

Dieses Dokument beschreibt die einzigartigen Fähigkeiten des Volta AF-Xplorer II und ist ein Leitfaden für seine sichere und effektive Anwendung.

Der Inhalt setzt voraus, dass die Benutzer über Vorkenntnisse in der Anwendung und Konfiguration von EP-Aufzeichnungssystemen und 3D-Mapping-Systemen verfügen.

Daher werden in diesem Handbuch nur Funktionen behandelt, die spezifisch für das medizinische Gerät Volta AF-Xplorer II sind, und zwar speziell für die Softwareversion V3.1.x des Volta AF-Xplorer II.

KAPITEL II – SYMBOLE UND BEZEICHNUNGEN

2.1 – TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

2.1.1 – PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemein		
Anwendung	Nur im Innenbereich	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	15 ° bis 35 ° Celsius
	Feuchtigkeit	10 % bis 80 % RF, nicht kondensierend
	Eingangsspannung	-10V bis +10V
	Das Produkt darf nicht in einer sauerstoffreichen Umgebung oder bei Vorhandensein von flammbaren Komponenten benutzt werden.	
	Vibration	0,5 Gms (5-500 Hz) (HDD)
	Schock	10 G mit 11ms Dauer, halbe Sinuskurve
	Luftdruck	60 – 106 kPa
Umgebungsbedingungen für Lagerung und Transport	Temperatur	-20 ° bis 60 ° Celsius
	Feuchtigkeit	5 % bis 85 % RF, nicht kondensierend
	Vibration	2 G
	Schock	10 G mit 11ms Dauer, halbe Sinuskurve
	Luftdruck	60 – 106 kPa
Lebensdauer	VOLTA AF-Xplorer II	5 Jahre
Abmessungen	180 mm x 214 mm x 240 mm	

2.1.2 – ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Computer		
Leistung	Typ	ATX/AT
	Eingangsspannung	19~24 VDC, 8A~6,5 A
	Ausgangsspannung (USB-Port)	5 VDC 500 mA pro Port
	Stromverbrauch	150 W bis 220 W (mit Erweiterungskarte)
Zertifizierungen	EMV	CE/FCC Klasse A, CCC, BSMI
	Sicherheit	UL, CCC, BSMI
AC-DC-Stromumschaltadapter		
Eingang	Spannung	100 – 240 V
	Frequenz	50 – 60 HZ
	Strom (Max)	3 A
Zertifizierungen	EMI/EMV	FCC Teil 15 Klasse B, EMV
	Sicherheit	CB, UL/cUL, TÜV

2.1.3 – EMV-KENNZEICHNUNG

Die folgenden Tabellen enthalten Daten zur Konformität des Volta AF-Xplorer II mit IEC60601-1-2, 4. Ausgabe.

Emissionen				
HF-Emissionen CISPR11			Gruppe 1, Klasse A	
Oberschwingungsströme IEC 61000-3-2			Nicht zutreffend	
Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen/Flicker (IEC 61000-3-3)			Nicht zutreffend	
Störfestigkeit				
Prüfungen	Anforderungen		Einhaltung der Bestimmungen	
Elektrostatische Entladung IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ± 2/4/8/15 kV Luft		±8 kV Kontakt ± 2/4/8/15 kV Luft	
Abgestrahlte HF EM IEC 61000-4-3	3 V/m (Umgebung: professionelle Gesundheitseinrichtung) 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM bei 1 kHz		3 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80% AM bei 1 kHz	
Nahfelder von drahtlosen HF- Kommunikationsgeräten IEC 61000-4-3	Frequenz (MHz)	Modulation	Erforderliches Niveau (V/m)	Konformitätsniveau (V/m)
	385	Pulsmodulation 18 Hz	27	27
	450	Pulsmodulation 18 Hz	28	28
	710-745- 780	Pulsmodulation 217 Hz	9	9
	810-870- 930	Pulsmodulation 18 Hz	28	28
	1720- 1845-1970	Pulsmodulation 217 Hz	28	28
	2450	Pulsmodulation 217 Hz	28	28
	5240- 5500-5785	Pulsmodulation 217 Hz	9	9
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	Stromversorgung: ± 2 kV Eingangs-/Ausgangsleitungen: ± 1 kV Wiederholungsfrequenz: 100 kHz		Stromversorgung: ± 2 kV Eingangs-/Ausgangsleitungen: ± 1 kV Wiederholungsfrequenz: 100 kHz	
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	Leitung zu Leitung: ± 0,5 kV, ± 1 kV Leitung zu Erde: ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV		Leitung zu Leitung: ± 0,5 kV, ± 1 kV Leitung zu Erde: ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV	
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte	3 V 0,15 MHz – 80 MHz 6 V in ISM-Bändern zwischen		3 V 0,15 MHz – 80 MHz	

Störgrößen, induziert durch HF-Felder IEC 61000-4-6	0,15 MHz und 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz		6 V in ISM-Bändern zwischen 0,15 MHz und 80 MHz 80 % AM bei 1 kHz	
Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen IEC 61000-4-8	30 A/m		30 A/m	
Spannungseinbrüche und -unterbrechungen: IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 Zyklus A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT; 1 Zyklus bei 0° 70 % UT; 25/30 Zyklen bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklen		0 % UT; 0,5 Zyklus A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT; 1 Zyklus bei 0° 70 % UT; 25/30 Zyklen bei 0° 0 % UT; 250/300 Zyklen	
Magnetfelder im Nahbereich IEC 61000-4-39	Frequenz	Modulation	Erforderliches Niveau (V/m)	Konformitätsniveau (V/m)
	134,2 kHz	Pulsmodulation 2,1 kHz	65	65
	13,56 MHz	Pulsmodulation 50 kHz	7,5	7,5

2.2 - SYMBOLE UND BESCHREIBUNG

	Warnung: Dieses Symbol wird verwendet, um den Benutzer vor einem potenziellen Risiko im Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts zu warnen, das Auswirkungen auf die Patienten- oder Benutzersicherheit haben kann.
	Vorsicht: Dieses Symbol wird verwendet, um darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb des Geräts Vorsicht geboten ist, ohne dass dies Auswirkungen auf die Sicherheit des Patienten oder des Benutzers hat.
	Siehe Bedienungsanleitung.
	Herstellernamen
	TT-MM-JJJJ entspricht dem Herstellungsdatum
	Artikelnummer
	Seriennummer des Produkts
	Medizinprodukt
	Ein durchgestrichener Abfallcontainer zeigt an, dass das Gerät gemäß der Richtlinie 2012/19/EU getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.
	Elektrostatisch empfindliches Gerät

2.3 - WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die unten aufgeführten Angaben sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass das Gerät unter besten Voraussetzungen und in vollständiger Sicherheit benutzt wird.

2.3.1 – ALLGEMEINE WARNHINWEISE

	Bei allen Benutzern muss vor Anwendung des Geräts eine Schulung durchgeführt werden.
	Lesen Sie alle Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.
	Das Gerät darf nicht verändert oder geöffnet werden. Wartungstätigkeiten oder Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Vertretern von Volta Medical ausgeführt werden. Jegliche Veränderung des Systems erfordert eine erneute Sicherheitsprüfung.

2.3.2 – ELEKTRISCHE GEFAHREN

	Vermeiden Sie Netzspannung über ± 10 V DC für die A/D Konverter-PCI-Karte.
	Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von allen AC-Anschlüssen. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie zum Säubern keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reiniger in Sprühform.
	Für Geräte mit Steckverbindung muss sich die Steckdose in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
	Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromquelle korrekt ist, bevor Sie das Gerät mit der Steckdose mit Erdanschluss verbinden.
	Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, trennen Sie es von der Stromquelle, um eine Beschädigung durch transiente Überspannung zu vermeiden.
	Füllen Sie niemals Flüssigkeiten in eine Öffnung. Es besteht Brandgefahr oder die Gefahr eines Stromschlags.
	Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Stromnetz mit Schutz Erde angeschlossen werden.
	Ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät vollständig auszuschalten.
	Schließen Sie nur Geräte an, die als Teil des Volta AF-Xplorer II oder die als kompatibel mit dem Volta AF-Xplorer II spezifiziert wurden.
	Kommunikationskabel müssen an den 60950-1-Eingangssignal-Port oder 60601-1-Signale mit folgender Isolierung angeschlossen werden: 1MOOP 230V.
	Das Gerät muss ohne Verwendung einer Steckdosenleiste direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen werden. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu elektrischen Gefährdungen führen.
	Das Gerät darf nicht an dieselbe Mehrfachsteckdose angeschlossen werden wie die Geräte von Drittanbietern, mit denen es verbunden ist.

2.3.3 – ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN UND ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN

	Dieses Gerät ist empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen. Vermeiden Sie unnötige Manipulationen an den Geräten, insbesondere während der Anwendung.
	Die Verwendung dieses Geräts neben anderen Geräten oder gestapelt auf anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu unsachgemäßem Betrieb führen kann.
	Die Verwendung von anderen Zubehörteilen, Transducern und Kabeln, als den angegebenen oder vom Hersteller dieses Geräts zur Verfügung gestellten, kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verringerten Störfestigkeit des Geräts und einer fehlerhaften Funktion führen.
	Tragbare HF-Kommunikationsgeräte sollten mit einem Mindestabstand von 30 cm zu allen Teilen des Volta AF-Xplorer II betrieben werden; dazu gehören auch von Volta Medical spezifizierte Kabel. Andernfalls kann der oben genannte Warnhinweis zu einer Beeinträchtigung der Leistung dieses Geräts führen.

2.3.4 – UMGEBUNG

	Halten Sie dieses Gerät von Feuchtigkeit fern.
	Stellen Sie das Gerät zur Installation auf eine feste Oberfläche. Wird das Gerät fallengelassen, kann dies zur Beschädigung führen.
	Bewahren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung auf, in der die Lagertemperatur unter -40° C oder über 60° C beträgt, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
	Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Luftzirkulation. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung. DECKEN SIE DIE ÖFFNUNGEN NICHT AB.
	Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten kann. Legen Sie keine Gegenstände über das Netzkabel.
	Vermeiden Sie Orte, die salziger Luft, korrosivem Gas oder einem organischem Lösungsmittel in der Atmosphäre ausgesetzt sind.
	Vermeiden Sie Orte, die vielen Vibrationen und Stößen ausgesetzt sind.
	Bei einigen Warnhinweisen des Volta AF-Xplorer II handelt es sich um akustische Signale. Deshalb müssen die Bildschirmlautsprecher immer eingeschaltet und so eingestellt sein, dass sie bei einem Abstand von 2 Metern hörbar sind.

2.3.5 – CYBERSICHERHEIT

	Das System ist so konzipiert, dass es nur mit offiziell identifizierten Systemen von Drittanbietern verbunden werden kann. Von einer Verbindung zu anderen Endgeräten wird dringend abgeraten.
	Geben Sie Ihre Zugangsdaten nicht weiter.
	An das System dürfen nur identifizierte Zubehörteile und USB-Massenspeicher für Wartungsarbeiten angeschlossen werden.
	Nehmen Sie keine physischen Änderungen am System vor. Wenn Sie eine solche Situation feststellen (Schrauben gelöst, Festplatte entfernt), informieren Sie bitte umgehend Volta Medical.
	Wenn das System zurückgenommen wird, werden gespeicherte Informationen (mit Ausnahme von Protokollen) nicht beibehalten und das System wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
	Wenn Sie sich mit Ihren Zugangsdaten nicht anmelden können oder unerwartete Änderungen an den Einstellungen vorfinden, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Volta Medical Vertreter.

2.4 – FEHLFUNKTIONEN

Beenden Sie die Verwendung des Geräts sofort, wenn eine der folgenden Situationen auftritt. Versuchen Sie, die Ursache der Fehlfunktion anhand der Beschreibung in diesem Dokument (Kapitel VII - FEHLERBEHEBUNG/VERBLEIBENDE AUFFÄLLIGKEITEN) zu ermitteln oder zu beseitigen. Wenn die Ursache nicht ermittelt oder die Fehlfunktion mithilfe dieses Dokuments nicht behoben werden kann, stellen Sie den Betrieb des Geräts ein und rufen Sie einen Volta Medical Vertreter an (siehe Abschnitt „Hersteller“ am Ende dieses Dokuments).

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt.
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen.
- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig, oder Sie können es nicht entsprechend dem Benutzerhandbuch in Betrieb nehmen.
- Das Gerät wurde fallengelassen und beschädigt.

KAPITEL III – PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 – ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND FUNKTIONSPRINZIP

3.1.1 – ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das Volta AF-Xplorer II Gerät ist ein Entscheidungsunterstützungssystem, das aus einem unsterilen, wiederverwendbaren Medizinprodukt, einer Computerplattform und einer Softwareanwendung besteht. Der Computer wird von Advantech (externe Produktionsstätte) hergestellt und dann von Volta Medical (interne Produktionsstätte) montiert und konfiguriert.

Volta AF-Xplorer II wird an bestehende elektrophysiologische Erfassungssysteme über maßgeschneiderte Verbindungskabel (DSUB und Octopus) oder Ethernet-Kabel angeschlossen, die von Volta Medical zur Verfügung gestellt werden.

Das Volta AF-Xplorer II Entscheidungsunterstützungssystem verarbeitet Analysen intrakardialer atrialer Elektrogramme (EGM) in Echtzeit auf der Grundlage eines datengestützten Ansatzes zur Identifizierung von spatiotemporalen dispergierten EGM während kardiologischer Elektrophysiologieverfahren. Diese Lösung basiert auf Techniken der künstlichen Intelligenz (KI), wie Deep Learning und maschinellem Lernen. Der Algorithmus wurde anhand einer umfangreichen Datenbank mit EGM aus Zentren in Europa und den USA trainiert. Die Daten wurden von erfahrenen Elektrophysiologen aus beiden Regionen kommentiert.

Die gezielte Elektrogramm-basierte spatiotemporale Dispersion bei einem Herzablationsverfahren hat sich gegenüber einer alleinigen Isolierung der Lungenvenen als vorteilhaft erwiesen, da diese Bereiche auf AF-Treiber hinweisen.

Die spatiotemporale Dispersion ist definiert als eine Gruppe intrakardialer Elektrogramme, die eine lokalisierte sequenzielle Aktivierung in einem bestimmten Bereich bilden, in dem Cluster von drei oder mehr benachbarten bipolaren Elektrogrammen eine intrakardiale Aktivierung über die gesamte Länge des Vorhofflimmernzyklus zeigen. Dieses Muster deutet auf eine lokalisierte reentryähnliche Leitung hin, die eine Rolle bei der Auslösung oder Aufrechterhaltung von Vorhofflimmern spielt (Deisenhofer et al. Artificial intelligence for individualized treatment of persistent atrial fibrillation: a randomized controlled trial. *Nature Medicine*, 2025).

Das Volta AF-Xplorer II System wird von Volta Medical mit Sitz in 65 Avenue Jules Cantini 13006 Marseille, FRANKREICH, hergestellt.

Das Volta AF-Xplorer II System wird im Operationssaal oder Elektrophysiologielabor bei Ablationsverfahren verwendet, ist aber nicht dazu bestimmt, im Sterilfeld platziert zu werden und hat kein Anwendungsteil.

Ärzte sollten den Volta AF-Xplorer II Computer während des Eingriffs nicht bewegen. Die Informationen des Volta AF-Xplorer II werden auf einem zweiten medizinischen Bildschirm oder auf einem Breitbildschirm im Operationssaal dupliziert (Abbildung 1).

Das Volta AF-Xplorer II System wird vom medizinischen Personal nach den Anweisungen des Arztes überwacht.



Abbildung 1: Funktionsprinzip: Die Volta AF-Xplorer II Benutzeroberfläche (obere linke Ecke des Breitbildschirms) zeigt dem Bediener eine einfache Farbcodierung der relevanten Signale an: Blau für keine Dispersion, Rot für eine hohe Dispersionswahrscheinlichkeit, weißer Indikator oben auf der Anzeige (dargestellt durch das Volta-Symbol „Bolzen“): zeigt eine sehr stabile Dispersion an.

3.1.2 – FUNKTIONSPRINZIP

Die Anwendung wird auf einer Computer-Plattform installiert und von einem Vertreter von Volta Medical bei der Installation vor Ort konfiguriert.

Die Anwendung unterstützt digitale Signale, die von der Plattform kommen und entweder von einem EP-Aufzeichnungssystem (über einen Analog/Digital-Wandler oder direkt im digitalen Format) oder von einem 3D-Mapping-System (direkt im digitalen Format) erfasst werden.

Die Anwendung unterstützt zwei Tagging-Konfigurationen, je nach Eingabequelle:


- Bei direkter Verbindung mit einem EP-Aufzeichnungssystem erfolgt das Markieren (Tagging) von Bereichen von Interesse (ROI) manuell.
- Bei direkter Verbindung mit einem 3D-Mapping-System erfolgt das Tagging von ROI entweder manuell oder automatisch. Im automatischen Modus sendet die Software die Tags direkt an das 3D-Mapping-System, wo sie ohne zusätzliche Intervention auf den 3D-Karten angezeigt werden.

Für jeden Mapping-Katheter zeigt die Anwendung an, welche Bipole zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Eingriffs von Interesse sind.

Betriebsart:

1. Während der Benutzer den Mapping-Katheter bewegt, beobachtet er regelmäßig die Anzeige des Volta AF-Xplorer II.
2. Wenn die Bipole auf dem Display zu blinken beginnen, stabilisiert der Benutzer den Mapping-Katheter.
3. Wenn die Software bestätigt, dass die Bipole von Interesse dispergiert sind, werden akustische und farbkodierte Hinweise auf dem oberen Halbkreisschema angezeigt. Der Benutzer kann auch einige Sekunden länger warten, um besonders stabile Dispersionspunkte zu identifizieren, die durch eine Füllstandsanzeige mit einem Indikator im oberen Bereich (dargestellt durch ein Volta „Bolzen“-Symbol) angezeigt werden.
4. Je nach Konfiguration:
 - o Der Benutzer kann die zugehörigen Stellen auf dem 3D-Mapping-System manuell markieren (verfügbar für alle Eingabequellen).
 - o Die dazu gehörigen Stellen werden automatisch auf der 3D-Oberfläche der Vorhöfe im 3D-Mapping-System markiert (nur verfügbar bei direkter Verbindung mit dem Mapping-System).

Durch Wiederholung dieser vier einfachen Schritte erhält der Elektrophysiologe schließlich eine Karte aller dispergierten Bereiche im Mapping-System.

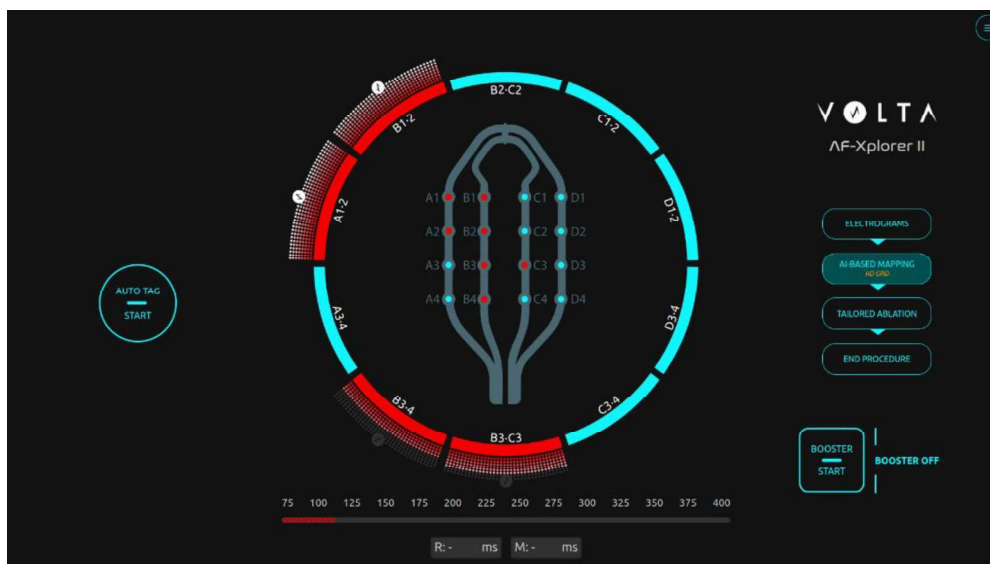

3.2 - VERWENDUNGSZWECK

Das Volta AF-Xplorer II System unterstützt den Benutzer bei der manuellen oder automatischen Echtzeit-Kommentierung anatomischer und elektrischer 3D-Karten der menschlichen Vorhöfe, um das Vorhandensein multipolarer intrakardialer atrialer Elektrogramme mit spatiotemporaler Dispersion bei Vorhofflimmern (VHF) oder atrialer Tachykardie (AT) zu erkennen.

Die Volta AF-Xplorer II Anwendung soll den Elektrophysiologen bei VHF- und AT-Ablationsverfahren zusätzlich zu den herkömmlichen Methoden unterstützen.

3.3 – BENUTZRZIELGRUPPE

Das Volta AF-Xplorer II darf nur von geschultem Personal angewendet werden.

Benutzer	Benutzerfunktionen
Elektrophysiologen	Überwachung der Software Klinische Entscheidung mithilfe der von der Software bereitgestellten Informationen
Medizinisches Personal (z. B. Biomedizintechniker oder Krankenpflegekräfte)	Software-Überwachung gemäß den Anweisungen des Elektrophysiologen
Krankenhaus-Administrator	Verwaltung des Benutzerkontos

3.4 – PATIENTENZIELGRUPPE

Das System kann bei erwachsenen Patienten eingesetzt werden, die für eine VHF- oder AT-Ablation infrage kommen.

3.5 – KONTRAINDIKATIONEN

Das Volta AF-Xplorer II System hat keine spezifischen Kontraindikationen, die über die mit einer Katheterablation im linken Vorhof verbundenen Kontraindikationen hinausgehen (z. B. Vorhandensein eines Thrombus im linken Vorhof).

3.6 - LEISTUNG UND SICHERHEIT

Die wichtigsten klinischen Funktionen der Volta AF-Xplorer II Anwendung sind die Erkennung und Annotation von dispergierten Regionen in Echtzeit bei Katheterablationseingriffen bei Vorhofflimmern oder atrialer Tachykardie.

Die wesentlichen Leistungsmerkmale des Volta AF-Xplorer II sind die Vermeidung von Übererkennung/-interpretation und/oder Fehlerkennung/-interpretation von EGM-Dispersionsbereichen. Eine Übererkennung/-interpretation und/oder Fehlerkennung/-interpretation kann die Anzahl der durchgeführten Ablationen und damit die Komplikationsrate bei Ablationen erhöhen.

Alle Sicherheitserwägungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise, die für den allgemeinen Umgang mit Medizinprodukten in einem Operationssaal oder Elektrophysiologielabor Gültigkeit haben, gelten auch für die Anwendung des Volta AF-Xplorer II. Es sind keine potenziellen unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Anwendung des Volta AF-Xplorer II bekannt. Das System muss in einer Krankenhausumgebung, außerhalb der Patientenumgebung und in Übereinstimmung mit den Standards für medizinische elektrische Geräte IEC 60601-1 und IEC 60601-1-2 installiert werden.



ANMERKUNG

Das Volta AF-Xplorer II System ist gemäß CISPR 11 als Klasse A eingestuft. Das Gerät eignet sich aufgrund seiner Merkmale für den Einsatz in industriellen Bereichen und Krankenhäusern. Es sollte nicht in einer Wohnumgebung verwendet werden, da es dort keinen ausreichenden Schutz für Hochfrequenz-Kommunikationsdienste bieten könnte. Möglicherweise müssen vom Benutzer Maßnahmen zur Risikominderung vorgenommen werden, wie die Umpositionierung oder Neuausrichtung des Geräts.

Komplikationen im Zusammenhang mit der Ablation von Vorhofflimmern sind gut dokumentiert und vorhersehbar (z. B. Schlaganfall, Perforation, Fistel, Herztamponade, Schädigung des Nervus phrenicus, periprozedurale thromboembolische Ereignisse, Gefäßkomplikationen). Es ist nicht zu erwarten, dass die Anwendung des Volta AF-Xplorer II unter normalen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit von unerwünschten Ereignissen erhöht, die andernfalls während einer HF-Katheterablation bei VHF/AT auftreten könnten.



ANMERKUNG

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Volta AF-Xplorer II aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer ansässig ist, gemeldet werden.

3.7 – REGELKONFORME ANWENDUNG UND KLINISCHER NUTZEN

Das Volta AF-Xplorer II Entscheidungsunterstützungssystem soll als Ergänzung zur klinischen Beurteilung durch die Ärzte und zu Schulungszwecken eingesetzt werden.

Die Anwendung dieses Systems ist beschränkt auf:

- Elektrophysiologen, die von Volta Medical für die Anwendung des Volta AF-Xplorer II zertifiziert sind.
- Elektrophysiologen, die von einem Aufsichtsführenden (Elektrophysiologen, die bereits von Volta Medical geschult wurden) oder einem Vertreter von Volta Medical überwacht werden.

Die Elektrophysiologen werden nach jeder Neuinstallation oder Software-Aktualisierung von einem Volta Medical Vertreter geschult. Wenn Sie als nicht geschulter Elektrophysiologe von Volta Medical in der Anwendung des Volta AF-Xplorer II geschult werden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Volta Medical Vertreter.

Jegliche unsachgemäße Anwendung ist untersagt.

Beachten Sie Folgendes, um Patienten, Dritte, andere Bediener, Assistenten und sich selbst vor jeglicher Gefahr zu schützen:


- Verwenden Sie nur fehlerfreie Produkte entsprechend ihrem vorgesehenen Verwendungszweck.
- Vermeiden Sie jegliche Verunreinigung des Produkts/Kontamination durch das Produkt.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Betriebssicherheit und den Zustand des Gerätes, insbesondere der Anschlusskabel.
- Lagern Sie das Gerät in geeigneter Weise und halten Sie es in gutem Betriebszustand.

Besonders zu beachten sind der Anschluss des Erfassungssystems und die Unversehrtheit der Katheter (nicht von Volta Medical hergestellt).

Der erwartete Nutzen für die Patienten ist ein besseres klinisches Gesamtmanagement ihres Vorhofflimmerns durch eine individuelle Katheterablation und eine bessere Reproduzierbarkeit zwischen den Anwendern, die VHF-Ablationen durchführen. VHF und AT werden als unterschiedliche Zustände derselben Krankheit betrachtet, wobei VHF die zugrunde liegende AT einschließt.

3.8 - LISTE DER KOMPONENTEN UND DES OPTIONALEN ZUBEHÖRS

 ANMERKUNG | Zubehör wird von Volta Medical geliefert

Name der Komponente	Teilenummer	Beschreibung	Abbildung	Medizinprodukt oder nicht medizinische Geräte
Volta AF-Xplorer II Anwendung	EU: 901007 CH: 901008	Software verarbeitet Echtzeit-Analysen intrakardialer atrialer EGM		Volta AF-Xplorer II System
Computer + Analoge/Digitale Konverter-PCI-Karte + TPM		Computer mit Intel Core i7-7700 CPU (8 MB Cache, bis zu 4,20 GHz, RAM 32 GB) Analoge/Digitale 16-Kanäle Konverter-PCI-Karte. Jeder Kanal bietet einen ± 10 V Messbereich bei einer Auflösung von 24 Bit. Der Konverter hat eine maximale Samplerate von 10 kS/s und verfügt über programmierbare Hardware-Filter.	 	

		Das TPM (Trusted Platform Module) ist ein in den Computer integriertes Sicherheitsmodul, das Schutz vor Cyberangriffen bietet.		
Computernetzteil. AC/DC- Schaltkonverter	EU: 901010 oder CH: 901013	Computer- Stromversorgung. AC/DC-Konverter		
Computer AC/DC- Schaltkonverter / Bildschirm- Netzkabel EU	EU: 901011 Oder CH: 901014	Computer- /Bildschirm-Netzkabel		
Optionales von Volta Medical geliefertes Zubehör				
DSUB Verbindungskabel H005	EU: 999014 CH: 999029	Verbindungskabel zwischen dem Analogausgang eines EP- Aufzeichnungssystems (siehe Kompatibilitäten im nächsten Abschnitt 3.9) und dem Analogeingang des Computers. Analog DB37 zu DB37 Stecker/Stecker		Medizinprodukt
Octopus Verbindungskabel H007	EU: 999015 CH: 999030	Verbindungskabel zwischen dem analogen Ausgang eines EP- Aufzeichnungssystems (siehe Kompatibilitäten im nächsten Abschnitt 3.9) und dem Analog- Eingang des Computers. Analog DB37 zu 16- poligem Stecker/Stecker		Medizinprodukt
Tastatur (austauschbar)	AZERTY: 998003 oder QWERTY: 998004 oder QWERTZ: 998005	AZERTY Tastatur mit USB-Verbindung zum Computer oder QWERTY Tastatur mit USB-Verbindung zum Computer Oder QWERTZ Tastatur mit USB-Verbindung zum Computer		Nicht medizinische Geräte
Maus (austauschbar)	998009	Maus mit USB- Verbindung zum Computer		Nicht medizinische Geräte

Bildschirm	EU: 998001 Oder CH: 998018	23,8" Bildschirm, Full HD 1920x1080 75 Hz. Bildformat 16:9 Lautsprecher 2x2 W, HDMI- und DP-Eingänge.		Nicht medizinische Geräte
Touchscreen und Netzkabel	EU: 998022 Oder CH: 998024	15,6" Touchscreen, Full HD 1920 x 1080. Bildformat 16:9 Lautsprecher 2x2 W, HDMI- und DP-Eingänge. Gerät mit taktiler PCAP-Technologie.		Nicht medizinische Geräte
Ständer für Touchscreen	EU/CH: 998025	Einstellbare Displayhöhe, neigbar und schwenkbar		Nicht medizinische Geräte
Ethernet Verbindungskabel	2 m: 998010 5 m: 998011 10 m: 998012 20 m: 998013	RJ-45 Verbindung zwischen Abbott EnSite X und GE CardioLab Workstations und dem Volta AF-Xplorer II Länge: 20 / 10 / 5 / 2 Meter		Nicht medizinische Geräte
Lautsprecherset	EU/CH: 998026	Anschluss für externe Lautsprecher		Nicht medizinische Geräte
HDMI Splitter-Set	EU/CH: 998016	HDMI Splitter mit Netzkabel und 30 cm HDMI-Kabel		Nicht medizinische Geräte

3.9 – KOMPATIBILITÄTEN

Die Anwendung unterstützt zwei Arten von Erfassungssystemen: Sie kann entweder an ein EP-Aufzeichnungssystem (im analogen oder digitalen Modus) oder an ein 3D-Mapping-System (im digitalen Modus) angeschlossen werden.

3.9.1 – KOMPATIBLE ERFASSUNGSSYSTEME

3.9.1.1 – Kommunikation mit einem EP-Aufzeichnungssystem

Das Tagging der Bereiche von Interesse (ROI) erfolgt manuell. Zur richtigen Anwendung muss das Volta AF-Xplorer II System direkt an die unten genannten Erfassungssysteme angeschlossen und mit den unten beschriebenen multipolaren kardialen Mapping-Kathetern (Abschnitt 3.9.2) verwendet werden.

Analoge Kommunikation:

Volta AF-Xplorer II ist für die Verwendung mit einem der beiden folgenden EP-Aufzeichnungssysteme zugelassen:

- LabSystem Pro (Boston Scientific)
- CardioLab (GE HealthCare).

Digitale Kommunikation:

Volta AF-Xplorer II ist für die Verwendung mit dem GE CardioLab Version 9.0.

Bei Anschluss an das CardioLab EP-Aufzeichnungssystem: Die digitalen Daten werden über ein Ethernet-Kabel zur Plattform geleitet und an die Anwendung übertragen.

3.9.1.2 – Kommunikation mit einem Mapping-System

Volta AF-Xplorer II ist für die Verwendung mit Abbott EnSite X DWS ab Version 3.1.

Bei Anschluss an das Ensite X 3D-Mappingsystem: Die digitalen Daten werden über ein Ethernet-Kabel zur Plattform geleitet und an die Anwendung übertragen.

3.9.2 – KOMPATIBLE KATHETER

Volta AF-Xplorer II ist für die Verwendung mit multipolaren Kathetern zugelassen die die folgenden Spezifikationen erfüllen:

Kathetertyp für das Mapping	Liste kompatibler mehrpoliger High-Density-Mapping-Katheter mit Elektrodengröße (Durchmesser für kreisförmig, Länge für rechteckig/quadratisch) zwischen 0,4 mm und 1 mm: • PentaRay Nav (Biosense Webster) • Advisor HD Grid (Abbott), Advisor HD Grid X (Abbott) • Intellamap Orion (Boston Scientific) • OctaRay 2-2-2, OctaRay 2-5-2, OctaRay 3-3-3 (Biosense Webster) • Lasso 20 (Biosense) • Affera Sphere-9 (Medtronic) Andere kompatible mehrpolige Katheter : • FARAWAVE NAV (Boston Scientific)
	- Elektrodengröße: 1 mm - Abstand zwischen den Elektroden: 2-3 mm - Anzahl der ausgewählten Dipole: 2 oder 5

3.9.3 – KOMPATIBLE SIGNALE

Das Signal, das vom Volta AF-Xplorer II erfasst wird, muss die folgenden Eigenschaften aufweisen, damit die Kompatibilität mit dem Gerät gewährleistet ist:

Spezifikationen für den Analogeingang:

32 unsymmetrische oder 16 differenzielle Analogeingänge oder eine Kombination von insgesamt 16 unsymmetrischen und differenziellen Analogeingängen.

Eingangsbereich: Bipolar: ± 5 V / Unipolar: 0-5 V

Spezifikationen für den Digitaleingang:

Digitaler Signaleingang über die Live-Export- oder LiveSync-Kommunikationsschnittstelle zwischen der EnSite X Workstation und dem Volta AF-Xplorer II.

Digitaler Signaleingang über die CardioLab-Kommunikationsschnittstelle zwischen dem GE CardioLab System und dem Volta AF-Xplorer II.

Die Verwendung der oben angeführten kompatiblen Katheter und Erfassungssysteme gemäß ihrer zugelassenen Kennzeichnung erzeugt ein Signal, das diese allgemeinen Signaleigenschaften aufweist.

Außerdem sollte das System nur mit Kathetern und Erfassungssystemen, die miteinander kompatibel sind, gemäß ihrer Kennzeichnung verwendet werden.

3.9.4 – KOMPATIBLE DISPLAYS

Volta Medical bietet ein Bildschirmgerät an, das die folgenden Mindestmerkmale aufweist:

Bildschirmgröße	Klassischer Monitor: Mindestens 17" 16:9 Touchscreen: Mindestens 15,6" 16:9
Bildschirmauflösung	Mindestens 1080 px für beide Bildschirmtypen
Bildschirmtyp	Flacher externer klassischer Farbbildschirm oder Touchscreen in der Nähe des Computers mit digitalem Videoeingang (HDMI oder gleichwertig)
Integrierte Lautsprecher	Ja mit mindestens 3 Watt

Ein sekundärer Bildschirm kann an den Volta AF-Xplorer II angeschlossen werden und muss die gleiche Auflösung wie der primäre Bildschirm aufweisen.

Nur der HDMI-Ausgang der Workstation ist nutzbar; benutzen Sie nicht den VGA-Ausgang.

KAPITEL IV – INSTALLATION UND INSTANDHALTUNG

Bitte beachten Sie, dass die Installation und Instandhaltung des Volta AF-Xplorer II Systems von einem Volta Medical Servicevertreter durchgeführt werden muss.

Die folgenden Angaben dienen dazu, die ordnungsgemäße Funktion des installierten Geräts sicherzustellen.

4.1 – HARDWARE-INSTALLATION


Die Integrität jeder Komponente des Volta AF-Xplorer II Systems muss vor der Installation und Anwendung überprüft werden.

Wie im Abschnitt Kompatibilitäten erwähnt, finden Sie im Folgenden detaillierte Hardware-Installationsdiagramme und Verbindungen zu Geräten anderer Hersteller:

4.1.1 – EINRICHTUNG MIT ERFASSUNGSSYSTEM

4.1.1.1 – Einrichtung mit dem LabSystem Pro EP-Aufzeichnungssystem (Boston Scientific)

Die gesamte Ausrüstung muss wie unten dargestellt angeschlossen werden:

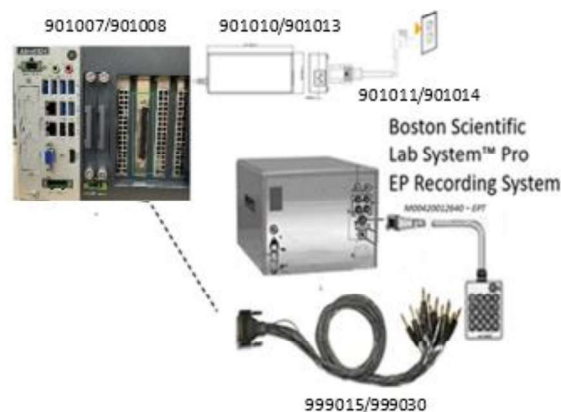

Bitte beachten Sie, dass die analoge Ausgangsbox mit 16 Kanälen mit dem LabSystem Pro EP-Aufzeichnungssystem von Boston Scientific verbunden ist (separat über den Boston Scientific-Vertreter oder -Händler erhältlich).

Jeder Stift des OCTOPUS-Kabels ist nummeriert, und jede Nummer muss mit der Steckernummer der analogen Ausgangsbox übereinstimmen.


4.1.1.2 – Einrichtung mit dem CardioLab EP-Aufzeichnungssystem (GE HealthCare)

A. Direkte analoge Verbindung mit dem GE EP-Aufzeichnungssystem

Die gesamte Ausrüstung muss wie unten dargestellt angeschlossen werden:



Das DSUB37-Verbindungskabel (Ref. 999014/999029) muss zwischen dem Analogausgang (3) des CardioLab™ IEB und dem Volta AF-Xplorer II Computer angeschlossen werden, wie im folgenden Diagramm dargestellt:

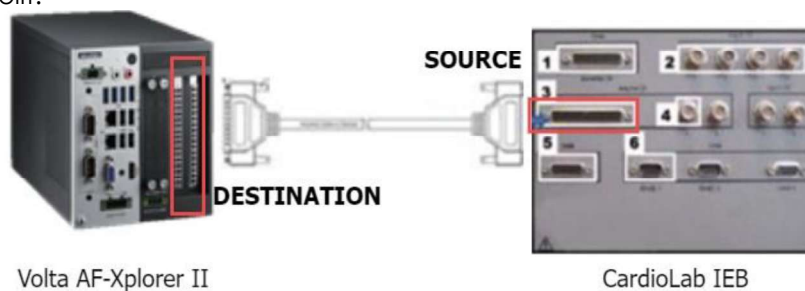


Das DSUB-Kabel hat 2 Anschlüsse mit der Bezeichnung „Quelle“ und „Ziel“.

Achten Sie auf die folgende Anschlussrichtung des DSUB-Kabels:

- Die Seite „Quelle“ muss mit dem CardioLab verbunden sein
- Die Seite „Ziel“ muss mit dem Volta AF-Xplorer II verbunden sein.

B. Anschluss an das GE EP-Aufzeichnungssystem über eine analoge Ausgangsbox

Die gesamte Ausrüstung muss wie unten dargestellt angeschlossen werden:

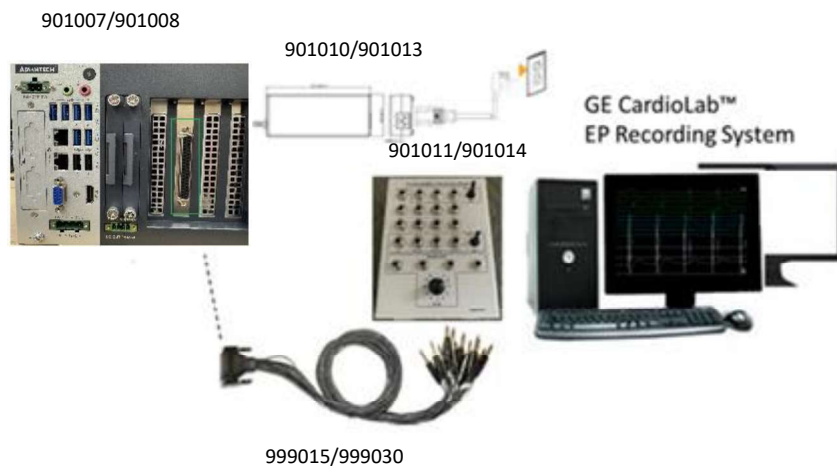

Bitte beachten Sie, dass die analoge Ausgangsbox mit 16 Kanälen mit dem GE CardioLab EP-Aufzeichnungssystem von Boston Scientific verbunden ist (separat über den GE Health Care Vertreter oder Händler erhältlich).


Das Octopus-Verbindungskabel muss zwischen der GE-Workstation über die von GE gelieferte analoge Ausgangsbox (**Ref. 2010476 – CardioLab/Mac-Lab Analogausgang**) und dem Volta AF-Xplorer II Computer angeschlossen werden.

Jeder Stift des OCTOPUS-Kabels ist nummeriert, und jede Nummer muss mit der Steckernummer der analogen Ausgangsbox übereinstimmen.

Beispiel für einen OCTOPUS-Anschluss an GE CardioLab mit analoger Ausgangsbox:




999015/999030




GE Workstation

C. Einrichtung für die digitale Kommunikation mit dem GE CardioLab (v9.0):

Die gesamte Ausrüstung muss wie unten dargestellt angeschlossen werden:

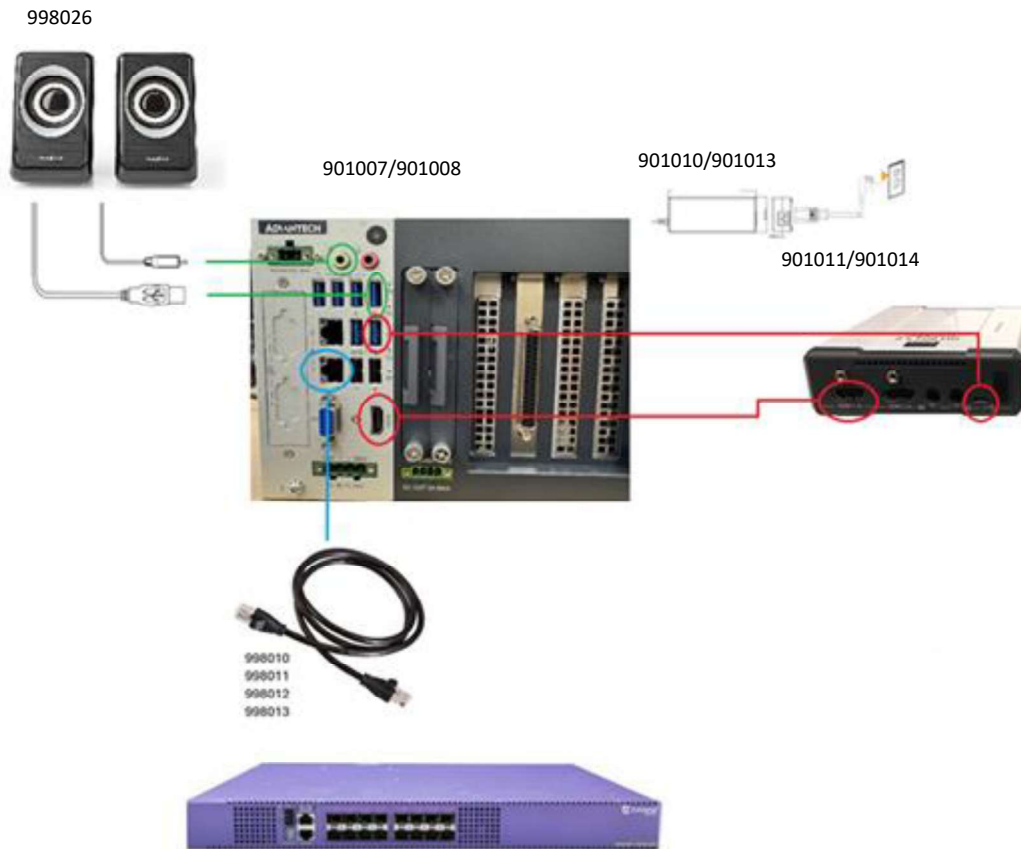

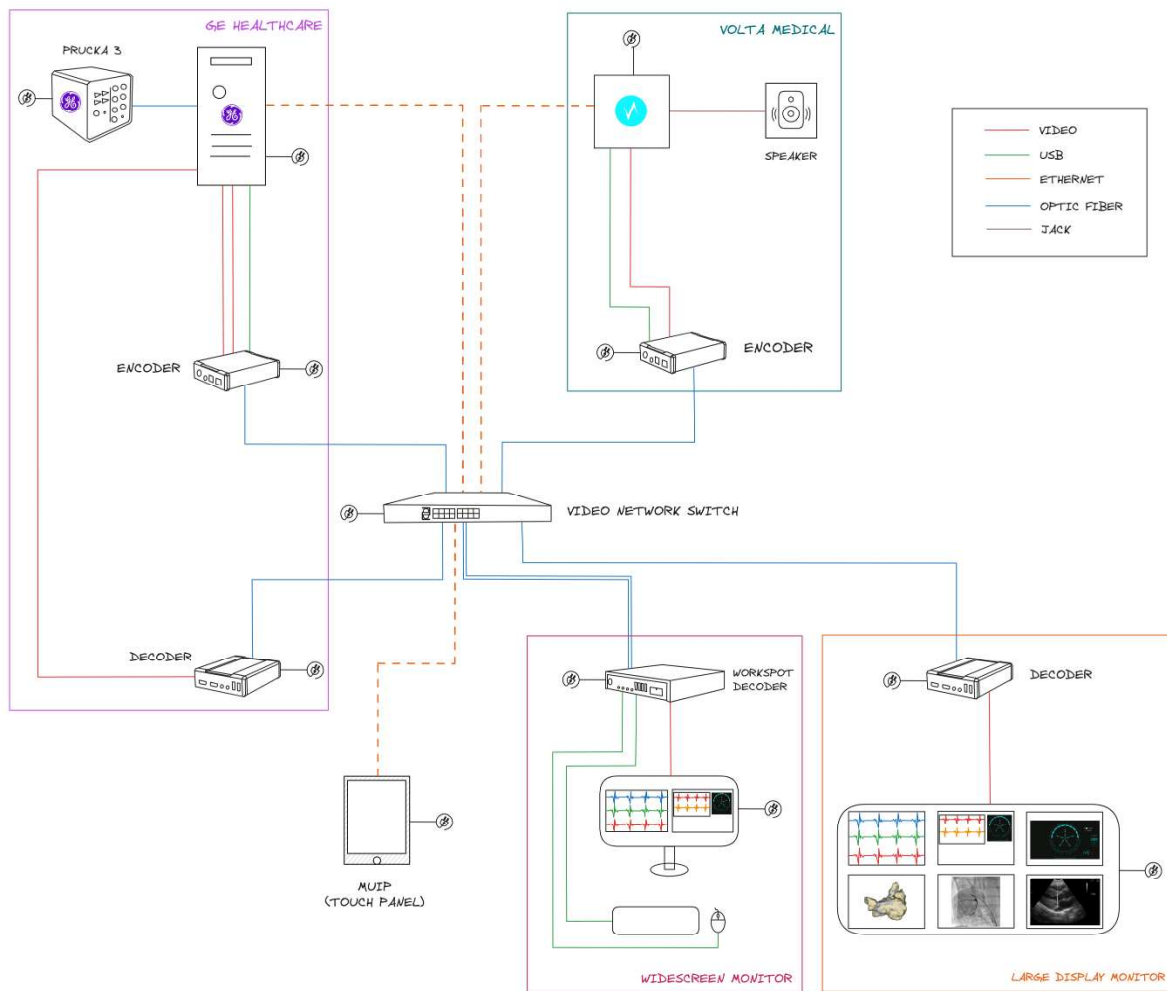

Sowohl das Volta AF-Xplorer II- als auch das GE CardioLab-System sind mit der EP-Steuerzentrale verbunden.

Die EP-Steuerzentrale ermöglicht die Anzeige und Steuerung mehrerer Geräte auf einem einzigen Monitor. Dadurch sind mehrere Monitore, Tastaturen und Mäuse überflüssig und Benutzer können über die UI-Steuerelemente zwischen dem Volta AF-Xplorer II und dem GE CardioLab wechseln. Das Bildschirmlayout kann nach den Vorlieben des Benutzers angepasst werden.

Die Integration der EP-Steuerzentrale ermöglicht außerdem eine einfachere Verbindung der Volta-Benutzeroberfläche mit dem großen Bildschirm (auch als „Boom“ bezeichnet).

Fokus auf die Verbindungen des Volta AF-Xplorer II:

- Ton: Über Klinkenkabel (und USB für die Stromversorgung)
- Anzeige: Über HDMI-Kabel, das an einen Volta-spezifischen **Encoder MNA-420** angeschlossen ist
- Steuerung: Über Mikro-USB-Kabel, das an einen Volta-spezifischen **Encoder MNA-420** angeschlossen ist
- Signale: Über Ethernet-Kabel, angeschlossen an **Ethernet Port 1** der Volta AF-Xplorer II Workstation und den **Video Network 16 Portschalter**.

4.1.1.3 – Einrichtung mit Abbott EnSite X DWS (v3.1)

Das Ethernet-Kabel muss den Ethernet-Port 2 auf der Volta AF-Xplorer II Workstation und den DATA-Port des EnSiteX DWS verbinden.




Volta AF-Xplorer II
Workstation
Ethernet - Port 2

EnSite X DWS
Ethernet – DATA Port

4.1.2 – EINRICHTUNG MIT ZUHÖR


Einrichtung mit Monitor, Tastatur und Maus

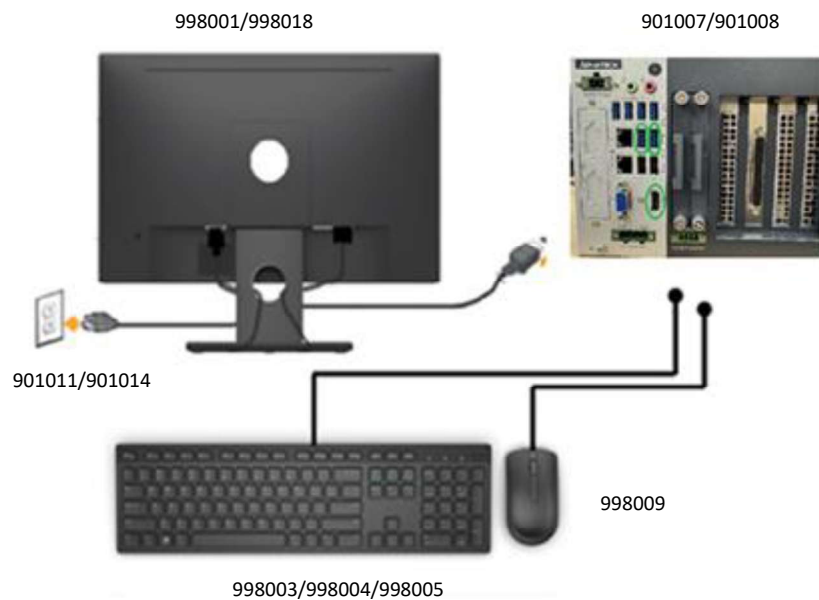

Einrichtung mit Touchscreen (iiYama-Modell)




998022/998024

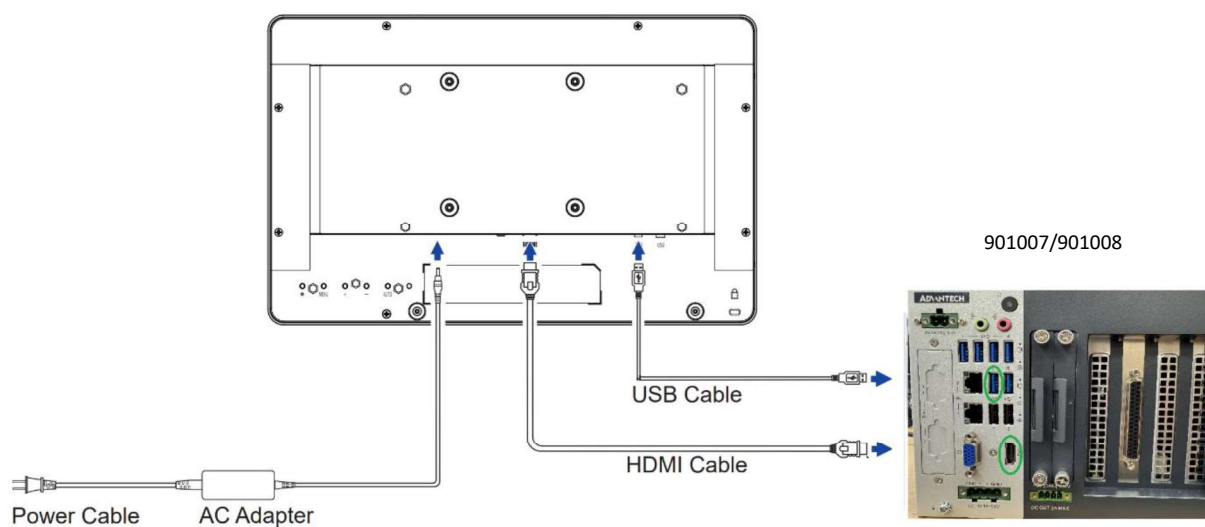

Einrichtung mit Touchscreen (Acula-Modell)

998022/998024


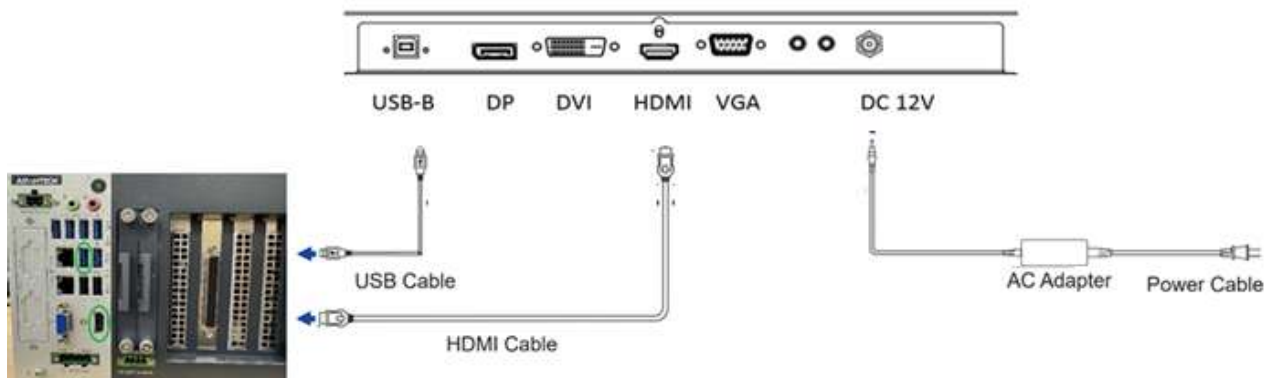


Optionale Lautsprecher

998026



901007/901008

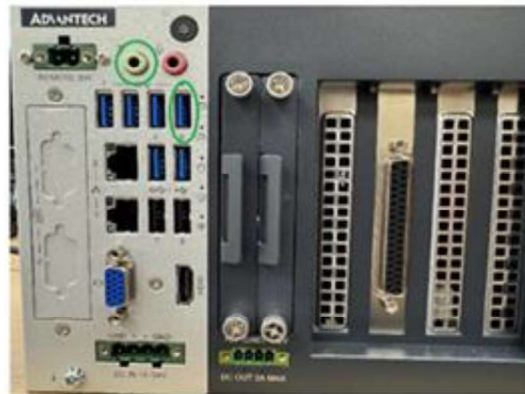

4.1.3. ANSCHLUSS AN MEHRERE BILDSCHIRME

Verfahren für den Anschluss mehrerer Bildschirme:

Alle angegebenen Anschlusskonfigurationen wurden anhand dieser Schritte getestet, die sicherstellen, dass alle Bildschirme die Schnittstelle mit der richtigen Auflösung anzeigen. **Wir empfehlen, nur die Auflösung Full HD (1920x1080) zu verwenden (oder einzustellen).**

- Schalten Sie alle Bildschirme und den anzuschließenden Computer aus.
- Trennen Sie alle Kabel von den Bildschirmen, dem Splitter und dem Computer.
- Schließen Sie alle Komponenten wieder an.
- Schalten Sie die Bildschirme und den Computer ein.

Diese Schritte müssen jedes Mal durchgeführt werden, wenn die Einrichtung geändert werden muss.


Geprüfte HDMI-Splitter:

Zubehör	Marke	Volta Medical Referenznummer
HDMI-Splitter – USB-Stromversorgung	Nedis	998016
HDMI-Splitter – Netzstromversorgung	Orei	107002


Anschlussdiagramme und Informationen mit geprüften Splitttern:

Nur der HDMI-Ausgang der Workstation ist nutzbar; benutzen Sie nicht den VGA-Ausgang.

HDMI-Bildschirme - mit Nedis-Splitter

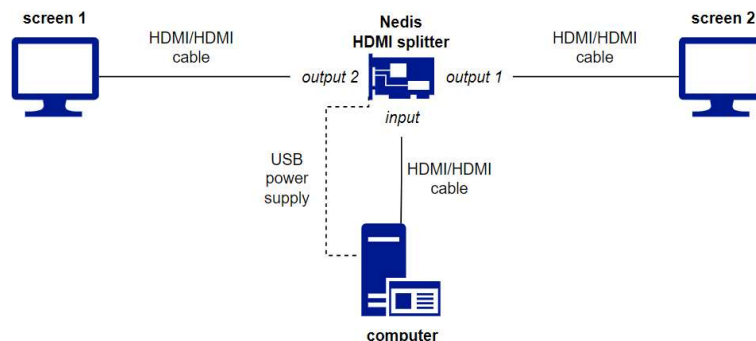

HDMI-Bildschirme - mit OREI-Splitter

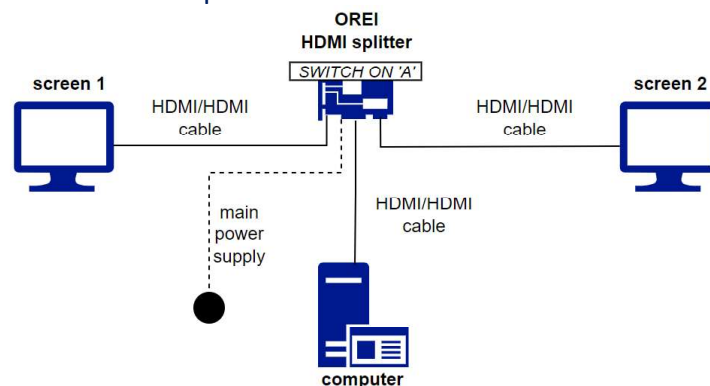

4.2 – EP-AUFZEICHNUNG UND KONFIGURATION DES 3D-MAPPING-SYSTEMS

Um das Volta AF-Xplorer II System im analogen Modus zu verwenden, muss das EP-Aufzeichnungssystem entsprechend dem Mapping-Kathetertyp wie folgt konfiguriert werden:

KANAL	PENTARAY / LASSO 20P	HD GRID HD GRID X	BASKET 64P	OCTARAY 2-5-2	OCTARAY 3-3-3	OCTARAY 2-2-2	FARAWAV E NAV	AFFERA SPHERE-9
1	EKG- Ableitung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ablei- tung	EKG- Ableitung
2	1-2	B2-C2	B4-5	A3-A4	A3-A4	A1-A2	1-2	D4-T
3	3-4	A3-A4	C3-4	B3-B4	B3-B4	B1-B2	2-3	P4-D4
4	5-6	B3-B4	D3-4	C3-C4	C3-C4	C1-C2	3-4	D3-D4
5	7-8	C3-C4	E3-4	D5-D6	D5-D6	D5-D6	4-5	P3-D3
6	9-10	D3-D4	F3-4	D3-D4	D3-D4	D1-D2	5-1	D2-D3
7	11-12	D1-D2	G4-5	E3-E4	E3-E4	E1-E2	/	D2-T
8	13-14	C1-C2	F5-6	F3-F4	F3-F4	F1-F2	/	P2-D2
9	15-16	B1-B2	E5-6	G3-G4	G3-G4	G1-G2	/	D1-D2
10	17-18	A1-A2	D5-6	A5-A6	A5-A6	A5-A6	/	P1-D1
11	19-20	B3-C3	C5-6	H3-H4	H3-H4	H1-H2	/	D4-D1
12	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2
13	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4
14	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6
15	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8
16	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10

Im digitalen Modus wird die Konfiguration des Katheters vom Volta AF-Xplorer II aus dem angeschlossenen Signalerfassungssystem abgerufen.

Liste der Bipole, die für die Verwendung im digitalen Modus entsprechend den kompatiblen Kathetern zu konfigurieren sind:

KANAL	PENTARAY / LASSO 20P	HD GRID HD GRID X	BASKET 64P	OCTARAY 2-5-2	OCTARAY 3-3-3	OCTARAY 2-2-2	FARAWAVE NAV	AFFERA SPHERE-9
1	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
2	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
3	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
4	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
5	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
6	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
7	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
8	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
9	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
10	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
11	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
12	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung	EKG-Ableitung
13	1-2	B2-C2	B4-5	A1-A2	A1-A2	A1-A2	1-2	D4-T
14	3-4	A3-A4	C3-4	A3-A4	A3-A4	A3-A4	2-3	P4-D4
15	5-6	B3-B4	D3-4	B1-B2	B1-B2	B1-B2	3-4	D3-D4
16	7-8	C3-C4	E3-4	B3-B4	B3-B4	B3-B4	4-5	P3-D3
17	9-10	D3-D4	F3-4	C1-C2	C1-C2	C1-C2	5-1	D2-D3
18	11-12	D1-D2	G4-5	C3-C4	C3-C4	C3-C4	CS 1-2	D2-T
19	13-14	C1-C2	F5-6	D1-D2	D1-D2	D1-D2	CS 3-4	P2-D2
20	15-16	B1-B2	E5-6	D3-D4	D3-D4	D3-D4	CS 5-6	D1-D2
21	17-18	A1-A2	D5-6	E1-E2	E1-E2	E1-E2	CS 7-8	P1-D1
22	19-20	B3-C3	C5-6	E3-E4	E3-E4	E3-E4	CS 9-10	D4-D1
23	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	F1-F2	F1-F2	F1-F2	/	CS 1-2
24	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	F3-F4	F3-F4	F3-F4	/	CS 3-4
25	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	G1-G2	G1-G2	G1-G2	/	CS 5-6
26	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	G3-G4	G3-G4	G3-G4	/	CS 7-8
27	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	H1-H2	H1-H2	H1-H2	/	CS 9-10
28	/	/	/	H3-H4	H3-H4	H3-H4	/	/
29	/	/	/	CS 1-2	CS 1-2	CS 1-2	/	/
30	/	/	/	CS 3-4	CS 3-4	CS 3-4	/	/
31	/	/	/	CS 5-6	CS 5-6	CS 5-6	/	/
32	/	/	/	CS 7-8	CS 7-8	CS 7-8	/	/
33	/	/	/	CS 9-10	CS 9-10	CS 9-10	/	/

4.2.1 – KONFIGURATION DES GE CARDIOLAB™:

Konfiguration des Analogausgangs

Um die Konfiguration des GE CardioLab für die Verwendung mit dem Volta AF-Xplorer II System durchzuführen, muss das entsprechende Protokoll ausgewählt werden (Vorhofflimmern, 3D-Mapping-System, multipolares Katheter-Mapping, 10-poliger Koronarsinuskatheter).

Die Konfiguration erfolgt über das Konfigurationsprotokollmenü  auf einer leeren Seite (i-te Seite). Beachten Sie, dass die Signalseite leer ist, wenn in der entsprechenden Spalte keine Nummer angegeben ist, und zwar bei allen Blöcken und EKGs.

Im folgenden Beispiel ist die Seite 7 im Block B leer.

Configuration

- Temps réel
 - Ampli Clab II Plus
 - ECG
 - Pression
 - Cathéter Bloc A
 - Cathéter Bloc B**
 - Cathéter Bloc C
 - Cathéter Bloc D
 - Cathéter Bloc E
 - Cathéter Bloc F
 - Cathéter Bloc G
 - Stim
- Entrée
 - Canal
 - Sortie analogique
 - Ablation
- Mesures
- Liste de protocoles
- Alignement d'activation
- Cartographie

Réglages de l'affichage Réglages du matériel

Echelle: 1/8


Canal	Etiquette	Clip	Couleur	Afficher pages								Toujours enreg.	
				1	2	3	4	5	6	7	8		
				#									
33	C1-C2/13-14					3	4	5					Oui
34	C2-C3							5				8	Oui
35	C3-C4/7-8					3	4	5					Oui
36	D1-D2/11-12					3	4	5				8	Oui
37	D2-D3							5					Oui
38	D3-D4/9-10					3	4	5				8	Oui
39	D1-D1							5					Oui
40	C2-D2							5				8	Oui
41	C3-D3							5				8	Oui
42	C4-D4							5					Oui
43	B1-C1							5					Oui
44	B2-C2/1-2					3	4	5					Oui
45	B3-C3/19-20					3	4	5					Oui
46	B4-C4							5					Oui
47	Stim 3												
48	Stim 4												
Nombre de signaux par page					12	11	19	19	12	13	0	18	

Nach der Bipol-Liste des zu konfigurierenden Katheters und mit Ausnahme des EKG müssen die Bipole in der richtigen Reihenfolge in der ausgewählten leeren Spalte angeklickt werden (die Nummer der Spalte wird in jeder Zeile angezeigt).

Die Bipole können auf mehrere Blöcke verteilt werden.

Wenn die Konfiguration der Bipole abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich auf der Seite mit der Signalanzeige, dass die Signale in der richtigen Reihenfolge gemäß der Liste angeordnet sind, mit Ausnahme des EKG. Falls erforderlich, können die Signale direkt auf der Seite neu geordnet werden. Diese zusätzliche Anzeigeprüfung stellt sicher, dass die Bipole in der richtigen Reihenfolge vom EP-Aufzeichnungssystem an das Volta AF-Xplorer II System gesendet werden.

Sobald die Seite richtig eingerichtet ist, gehen Sie zum Analogausgang und wählen „Feste Seite“ (i-te Seite wie oben beschrieben). Übernehmen Sie die Änderungen und speichern Sie die Konfiguration.

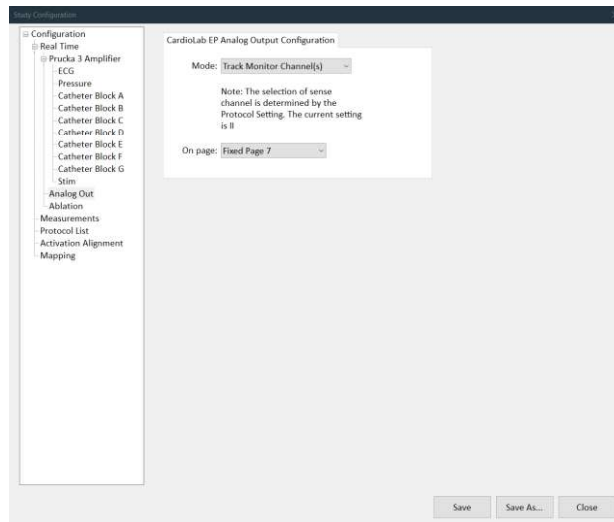

Die EKG-, Mapping- und CS-Katheter-Verstärkungswerte müssen in die Volta AF-Xplorer II Systemeinstellungen übertragen werden.

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen:

Empfehlungen GE CardioLab	Verstärkungen	Hochpass	Tiefpass	Kerbfilter
EKG	2500	0,5 Hz	50 Hz	JA
Mapping-Katheter	≥ 5000	30 Hz	100 Hz	JA
CS-Katheter	2500	30 Hz	100 Hz	JA

Die Konfigurationsseite unterscheidet sich von der Anzeigeseite, da dort kein EKG-Signal angezeigt wird.

Auf der Anzeigeseite werden die für den Bediener relevanten Bipole angezeigt (die 10 ausgewählten Bipole des Mapping-Katheters, CS-Signale und EKG-Kanal/Kanäle).

Anmerkung: Der an das Volta AF-Xplorer II System gesendete EKG-Kanal ist der „Sense-Kanal“, der auf der EKG-Seite durch ein „S“ neben dem Kanalnamen gekennzeichnet ist. Der Sense-Kanal ist ein Kanal, der an ein Stimulationsgerät gesendet wird.

Der Benutzer wählt einen Kanal aus, indem er ihn mit der Maus markiert und die Taste „S“ drückt.

Dieser Kanal darf für die Volta AF-Xplorer II Konfiguration nicht verändert werden.

Im Falle einer Verbindung über die Analogausgangsbox muss die Box wie folgt konfiguriert werden:

- Der Drehschalter wird auf die Nummer der Konfigurationsseite eingestellt, die für Volta AF-Xplorer II auf dem CardioLab verwendet wird.
- Beide Schalter an der Box werden auf CLAB AMP (nicht PDM) umgeschaltet.



4.2.2 – KONFIGURATION DES BOSTON SCIENTIFIC LAB SYSTEM™ PRO:

Um die Konfiguration des Lab System Pro für die Verwendung mit dem Volta AF-Xplorer II System durchzuführen, muss das entsprechende Protokoll ausgewählt werden (Vorhofflimmern, 3D-Mapping-System, multipolares Katheter-Mapping, 10-poliger Koronarsinuskatheter).


Die Konfiguration erfolgt über das Verstärker-Menü, indem „Konfigurieren“ ausgewählt wird.

Auf der Registerkarte „Analogausgang“ müssen die 16 analogen Ausgangskanäle wie folgt konfiguriert werden:

- 1: EKG
- 2 bis 11: Mapping-Katheter Dipole
- 12 bis 16: CS-Katheter Dipole 1-2 bis 9-10



Die EKG-, Mapping- und CS-Katheter-Spannungsbereichswerte müssen in die Volta AF-Xplorer II Systemeinstellungen übertragen werden.

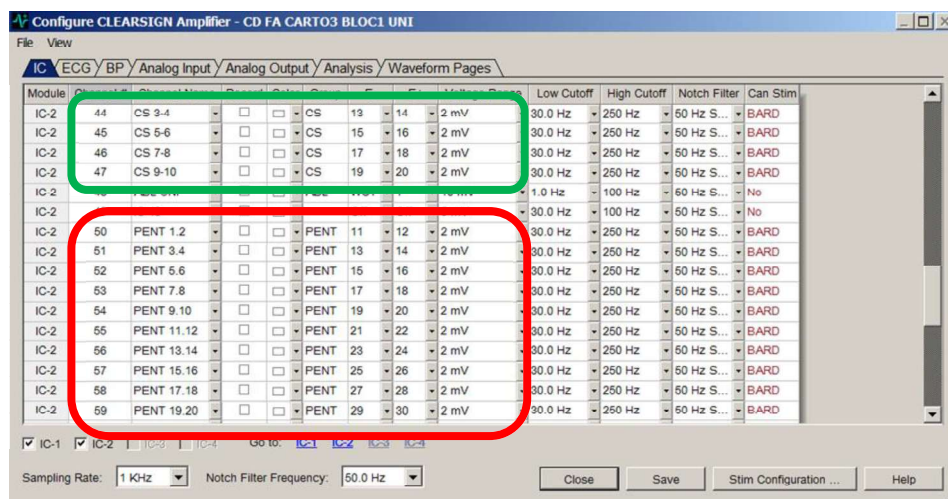

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen:

Empfehlungen Boston Lab System Pro	Spannungsbereich	Hochpass	Tiefpass	Kerbfilter
EKG	5 mV	0,5 Hz	50 Hz	JA
Mapping-Katheter	1 mV	30 Hz	100 Hz	JA
CS-Katheter	2 mV	30 Hz	100 Hz	JA

4.2.3 – KONFIGURATION DES ENSITEX MAPPING-SYSTEMS:

Um das Volta AF-Xplorer II System mit dem EnSite X Mapping-System zu verwenden, muss sichergestellt werden, dass eine gültige Live-Export- oder Live-Sync-Lizenz von Abbott auf dem EnSite X DWS vorhanden ist.

4.3 – Konfiguration des Volta AF-Xplorer II Systems

Um eine Systemkonfiguration vorzunehmen, die nicht über das Bediener- oder Krankenhausadministratorkonto verfügbar ist, wenden Sie sich bitte an einen Volta Medical Servicevertreter.

KAPITEL V - ANWENDUNG DES VOLTA AF-XPLORER II



Die Integrität jeder Komponente des Volta AF-Xplorer II Systems muss vor jeglicher Anwendung des Systems überprüft werden.
Besonders zu beachten sind der Anschluss des Erfassungssystems und die Unversehrtheit der Katheter (nicht von Volta Medical hergestellt).

5.1 – AUTHENTIFIZIERUNG

Drei Arten von Benutzern können auf das Volta AF-Xplorer II System zugreifen:

- Bediener (geschulter EP, der Verfahren durchführt, oder Biomedizintechniker/Pflegekräfte, die den Ärzten assistieren).
- Krankenhausadministrator (Krankenhauspersonal, das einige Managementtätigkeiten im Hinblick auf die Benutzerkonten durchführt).
- Service-Personal (Vertreter von Volta Medical, die auf das Backoffice der Anwendung zugreifen können)

Nach dem Einschalten von Volta AF-Xplorer II muss sich der Benutzer mit seinem persönlichen Benutzernamen und Passwort authentifizieren.

Je nach Profil hat er Zugang zu verschiedenen Menüs:

- Bediener haben Zugriff auf den Hauptbildschirm und die Einstellungen.
- Krankenhausadministratoren haben Zugriff auf die Registerkarte „Benutzer verwalten“.
- Das Service-Personal hat Zugriff auf alle Menüs.

Bei der ersten Verbindung sind Benutzername und Passwort identisch, aber sobald der Benutzer bei der Anwendung angemeldet ist, wird er aufgefordert, ein neues Passwort (zwischen 12 und 50 Zeichen) zu erstellen.

Sobald Sie die Felder „Benutzername“ und „Passwort“ ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Anmelden“. Geben Sie Ihre Anmeldedaten nicht an Dritte weiter.



ANMERKUNG Wenn ein Benutzer sich 10 Mal hintereinander nicht anmelden konnte, muss er 30 Sekunden warten, bevor er sich erneut anmelden kann. Wenn er sich weitere 10 Male nicht anmelden kann, wird die Zeitüberschreitung verdoppelt.

5.2 – EINSTELLUNGEN DES EP-AUFZEICHNUNGSSYSTEMS



ANMERKUNG

Die Erstkonfiguration des Systems DARF NUR von einem Vertreter von Volta Medical vorgenommen werden.


Bevor ein neues Verfahren gestartet wird, muss der Bediener mehrere Einstellungen am entsprechenden EP-Aufzeichnungssystem vornehmen, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben.

CardioLab Erfassungssystem (General Electric)		LabSystem Pro Erfassungssystem (Boston Scientific)
Digitaler Modus	Analoger Modus	
Auswahl des Signalerfassungssprotokolls	Wenn noch kein Verfahren gestartet wurden: - Öffnen Sie ein neues Verfahren. - Ein Popup-Fenster fragt automatisch nach dem Protokoll für die Signalerfassung. Wenn bereits ein Verfahren gestartet wurde: Gehen Sie zur Registerkarte „Studienkonfiguration“ > Umschalten	Gehen Sie zur Registerkarte „Verstärker“ > Last
	Wählen Sie für beide EP-Aufzeichnungssysteme das entsprechende Protokoll für: - VHF-Verfahren - 3D Mapping-System - multipolares Katheter-Mapping 10-poliger Koronarsinuskatheter.	
Überprüfung von Verstärkungen und Filtern	N/A Sobald die Studie gestartet ist, rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf, indem Sie  auf das folgende Symbol klicken Gehen Sie zur Registerkarte EKG > Einrichtung der Geräte Beachten Sie die EKG-Verstärkung. Gehen Sie zu den entsprechenden Blöcken, in denen die Mapping- und CS-Katheter konfiguriert sind > Einrichtung der Geräte. Beachten Sie die Mapping- und CS-Verstärkung Die Bipole können auf mehrere Blöcke verteilt werden. Überprüfen Sie, ob die Angaben auf der Volta-Konfigurationsseite korrekt sind.	Sobald die Studie gestartet ist, gehen Sie zur Registerkarte „Verstärker“ > Konfigurieren. Gehen Sie zur Registerkarte „IC“. Beachten Sie die Mapping- und CS-Verstärkung Gehen Sie zur Registerkarte „ECG“. Beachten Sie die EKG-Verstärkung.
Empfehlungen für Verstärkungs- und Filterwerte	N/A Verstärkungen: EKG: 2500 Mapping-Katheter: > 5000 CS-Katheter: 2500 Warnhinweis: Die Verstärkung sollte während des Verfahrens nicht verändert werden.	<u>Spannungsbereiche:</u> EKG: 5 mV Mapping-Katheter: 1 mV CS-Katheter: 2 mV
	N/A Filter für beide EP-Aufzeichnungssysteme: EKG: Mapping: CS: - Hochpass: 0,5 Hz - Tiefpass: 50 Hz Kerbfiler: JA (nicht zutreffend für digital)	- Hochpass: 30 Hz - Tiefpass: 100 Hz

5.3 – EINSTELLUNGEN DES VOLTA AF-XPLORER II


5.3.1 – KONFIGURATIONSMODUS AUSWÄHLEN

Um ein Verfahren zu starten, muss der Bediener den entsprechenden Modus (analog oder digital) auswählen und seine Wahl durch Klicken auf die Schaltfläche „Verfahren starten“ bestätigen.

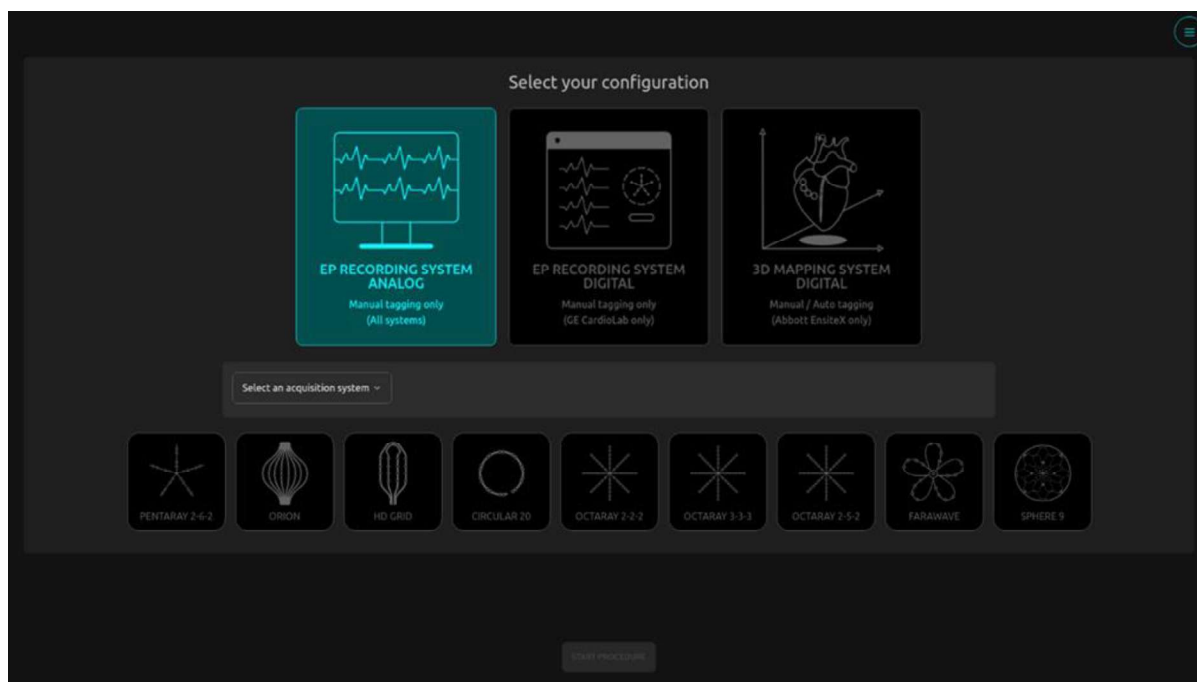

5.3.2 – ERFASSUNGSSYSTEM

Wenn der analoge Modus gewählt wird, muss das entsprechende EP-Aufzeichnungssystem ausgewählt werden.

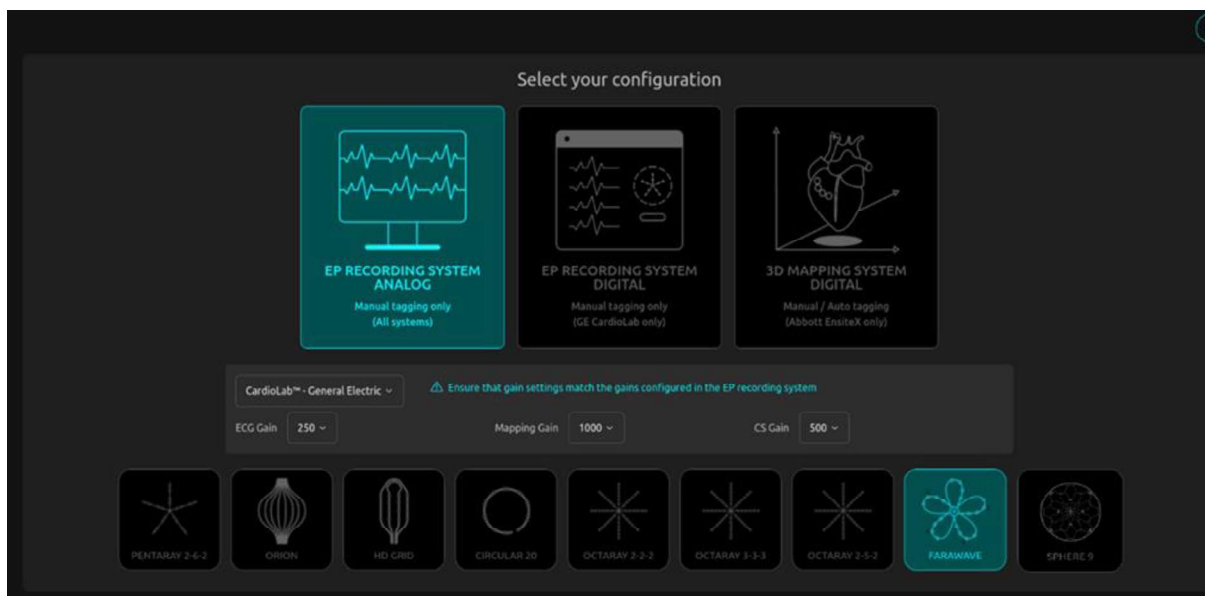


ANMERKUNG

Im digitalen Modus muss das Erfassungssystem nicht ausgewählt werden, da das Volta AF-Xplorer II System nur an das 3D-Mapping-System EnSite X von Abbott oder das GE Cardiolab angeschlossen werden kann.

5.3.3 – MAPPING-KATHETER

Wenn der analoge Modus ausgewählt ist, wählen Sie im Einstellungsfenster den gewünschten Mapping-Katheter entsprechend dem Verfahren aus.

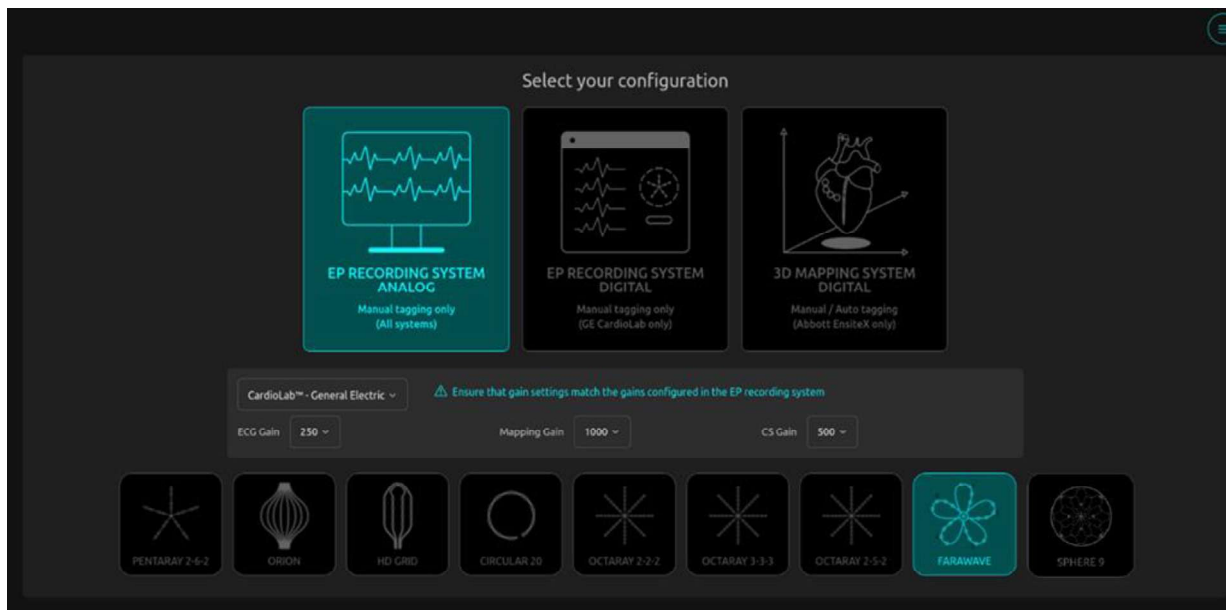


ANMERKUNG

Im digitalen Modus wird der Mapping-Katheter über das 3D-Mapping-System EnSite X von Abbott oder das CardioLab Erfassungssystem von GE automatisch auf den Volta AF-Xplorer II übertragen.

5.3.4 – KONFIGURATION DER VERSTÄRKUNG UND STARTEN DES VERFAHRENS

Konfigurieren Sie die Verstärkungsfaktor-Werte im analogen Modus wie folgt:

- Wenn EKG- und IC-Signale vom GE CardioLab™ oder Boston LabSystem Pro™ kommen, müssen die Verstärkungswerte in der Volta AF-Xplorer II Anwendung mit den im entsprechenden EP-Aufzeichnungssystem registrierten Werten übereinstimmen.

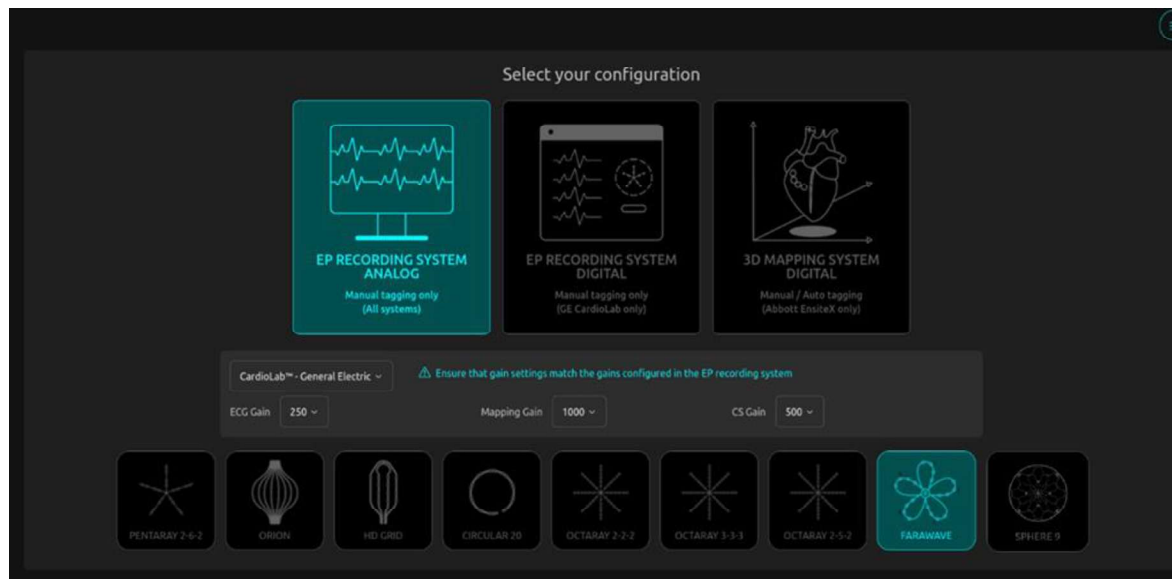

Die Verstärkungen können jederzeit während des Verfahrens bearbeitet werden. Insbesondere in CardioLab™ durch Erhöhen oder Verringern der Signalamplitude der Katheterbipole auf der Echtzeit-Bildschirmschnittstelle oder durch Ändern des Verstärkungswertes in der Verstärkerkonfiguration.

Die neuen Verstärkungswerte müssen in der Volta AF-Xplorer II Anwendung gemeldet werden.

Sobald Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Einstellungen speichern“ und dann auf „Änderungen übernehmen“.


Werden während des Verfahrens Änderungen an den Verstärkungen vorgenommen, muss der Initialisierungsschritt erneut durchgeführt werden.



ANMERKUNG

Im digitalen Modus sind keine Verstärkungseinstellungen erforderlich.

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Verfahren starten“.

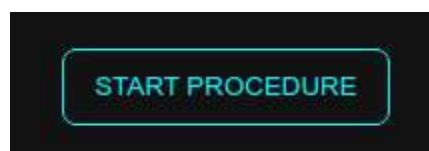


Im digitalen Modus sollte das Verfahren erst gestartet werden, wenn ein kompatibler Katheter angeschlossen, konfiguriert und bereit für das erste Mapping ist.

Die HD-Wave-Konfiguration der Polarität des Mapping-Katheters muss vor Beginn des Verfahrens auf dem Abbott EnSite X-System erfolgen.

5.4 – SIGNALVALIDIERUNG

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Initialisierung“, um die Validierung der Signale zu starten.

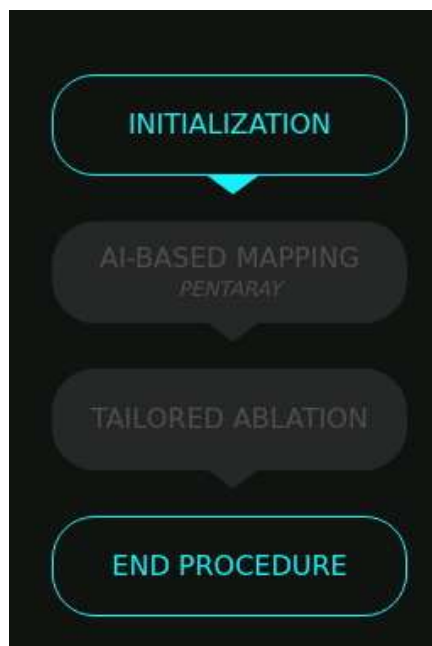

Prüfen Sie auf der Elektrogramm-Seite, dass alle Signale (EKG und IK-Bahnen) korrekt sind und denen im EP-Aufzeichnungssystem entsprechen.

Wenn eine Elektrode des Mapping-Katheters Geräusche macht, empfehlen wir, sie auszutauschen, um eine korrekte Erkennung der spatiotemporalen Dispersion sicherzustellen.



ANMERKUNG

Die Amplitude und die Dauer des Signalfensters können verändert werden, um die Visualisierung der Signale und den Vergleich mit dem EP-Aufzeichnungssystem zu optimieren.

Es ist zwingend erforderlich, 15 Sekunden zu warten, bis Volta AF-Xplorer II initialisiert ist. Sobald dies geschehen ist, drücken Sie auf „Validieren“, um die Echtzeit-Benutzeroberfläche zu öffnen.



ANMERKUNG


Die Seite „Signale“ kann jederzeit während des Verfahrens angezeigt werden, indem Sie auf die Schaltfläche „Elektrogramme“ klicken.

5.5 – MAPPING-PHASE

Klicken Sie auf „AI-Based Mapping“, um ein genaues Dispersions-Mapping zu erstellen.




5.5.1 – KOMMUNIKATION EP-AUFZEICHNUNGSSYSTEM – MANUELLES TAGGING

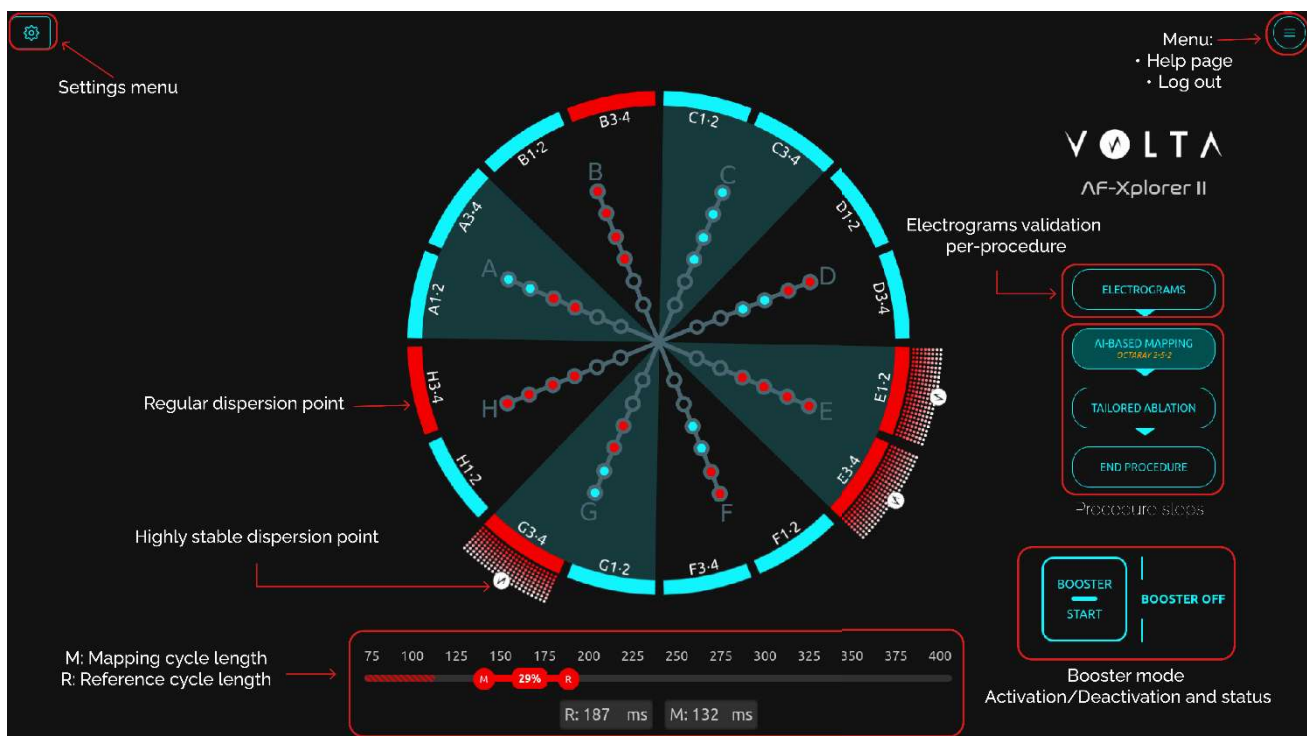

Für jeden Katheter zeigt die Software die für das Dispersions-Mapping relevanten Elektroden an. Nach Klicken auf die Schaltfläche „Mapping“ wird der Mapping-Prozess mit dem Volta AF-Xplorer II wie folgt fortgesetzt:

- Während der Bewegung des Katheters in den Vorhöfen beobachtet der Benutzer regelmäßig das Display.
- Wenn sich der Mapping-Katheter in einem nicht-dispergierten Bereich befindet, werden die Elektroden des Katheters auf dem Bildschirm des Volta AF-Xplorer II in **Blau** angezeigt.
- Befindet sich der Katheter in einem dispergierten Bereich, werden die relevanten Elektroden **Rot** angezeigt und ein akustisches Signal (doppeltes Fingerschnipsen) ertönt, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass er den Katheter stabilisieren muss.

- Wenn die relevanten Elektroden von der Software im Außenrahmen der Benutzeroberfläche bestätigt werden, kann der Benutzer **die entsprechenden Stellen manuell markieren**. Dies kann mit einem beliebigen 3D-Navigationssystem unabhängig vom Hersteller erfolgen.
- Um über die Standard-Dispersionsanalyse hinauszugehen, kann das System eine zusätzliche Analyse durchführen, um hochstabile Bereiche unter den als dispergiert klassifizierten EGM zu identifizieren. Diese erweiterte Analyse basiert auf der Stabilität der temporalen Dispersion und der Intensität für jeden Bipol.
 - Hierfür muss der Mapping-Katheter mindestens 5 Sekunden lang (maximal 15 Sekunden) über dem relevanten Bereich stabilisiert werden.
 - Wenn ein Bipol über den verlängerten Zeitraum eine hochstabile Dispersion aufweist, **erscheint eine Anzeige, die sich langsam füllt**. Wenn ein hochstabiler Dispersionspunkt identifiziert wird, **leuchtet oben in der Anzeige ein weißer Indikator auf**.
 - Diese hochstabilen Punkte können dann im 3D-Navigationssystem mit einer anderen Farbe markiert werden, um sie von den Standardpunkten zu unterscheiden.
- Diese Schritte werden wiederholt, bis das Mapping abgeschlossen ist.

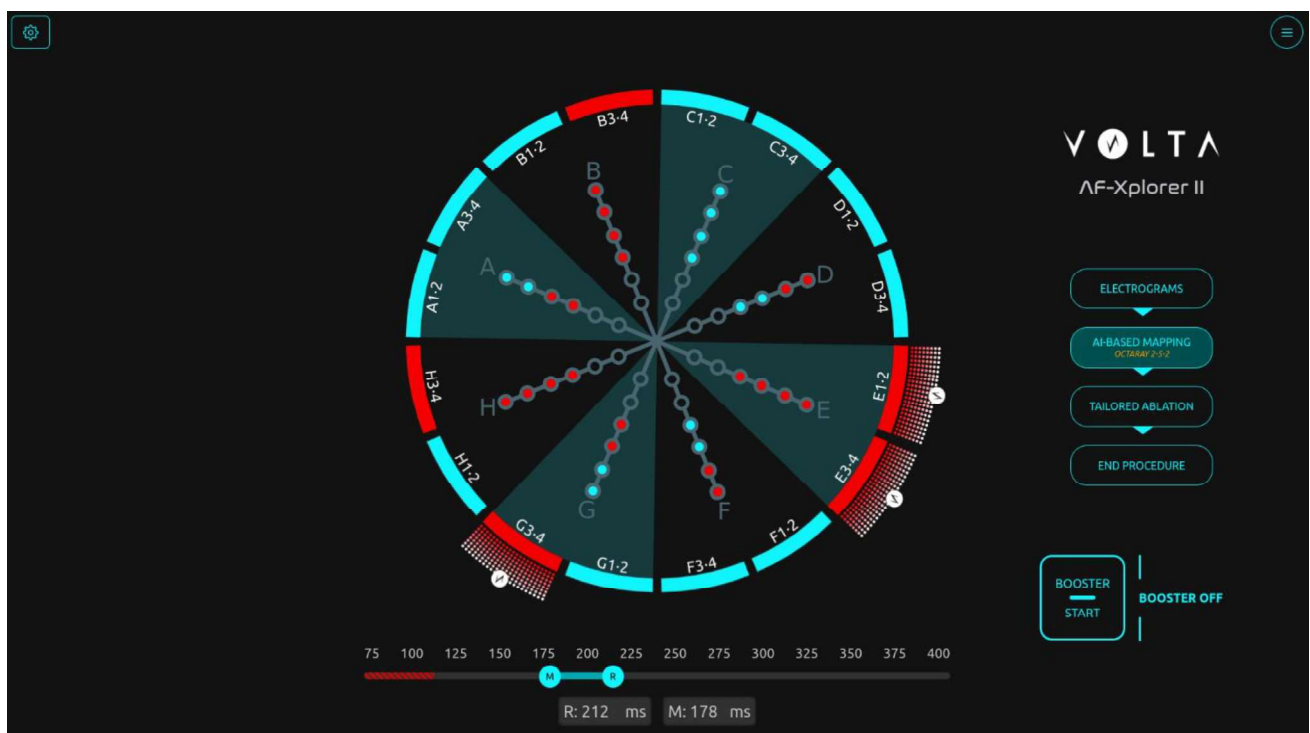

Der Bediener sollte ein komplettes Mapping beider Vorhöfe mit einer maximalen Punktdichte durchführen. Außerdem sollte der Mapping-Katheter langsam bewegt werden, und der Bediener sollte sicherstellen, dass der Medizintechniker, der das 3D-Navigationssystem handhabt, die Punkte auf der Karte lokalisiert hat, bevor er den Katheter bewegt.



Der Mapping-Katheter sollte für eine optimale Analyse der auf dem Außenrahmen angezeigten Dispersionspunkte mindestens 3 Sekunden lang über dem relevanten Bereich stabilisiert werden, für die zusätzliche Analyse der hochstabilen Dispersionspunkte maximal 5 bis 15 Sekunden, bevor die Punkte auf der 3D-Karte markiert werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Bereichen gewährt werden, bei denen das Mapping schwierig ist (linker Vorhofrand, linke interne Vorhofscheidewand usw.)

Der Bediener muss einen guten Kontakt mit dem Vorhofgewebe herstellen, um die Erfassung von Fernfeldsignalen zu vermeiden.

Am Ende kann der Benutzer intrakardiale Vorhofabbildungen mit Angaben zur Dispersion erhalten, basierend auf einer Analyse mit dem Volta AF-Xplorer II und der Validierung durch einen Elektrophysiologen.


Anmerkung: Um eine andere Beurteilung der Verteilung der dispergierten Elektrogramme während des Mappings zu erhalten, kann der Booster-Modus aktiviert werden, um die Empfindlichkeit der Software zu erhöhen. Der Booster-Modus kann beim Mapping von langsamem VHF (CL > 230 ms) oder AT eingeschaltet werden. (siehe Abschnitt 5.5.4 dieses Dokuments).

Auf der Hauptseite wird der Booster-Modus wie folgt dargestellt:

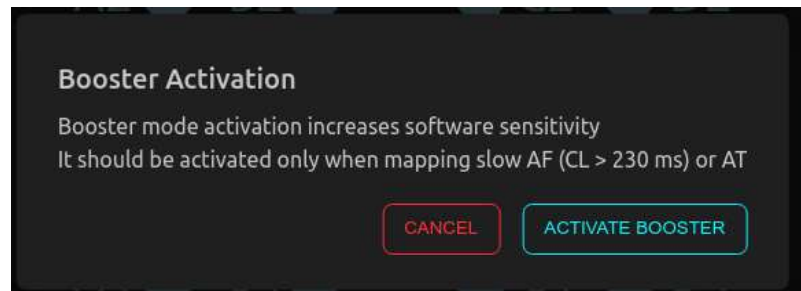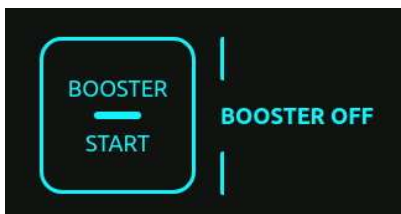

Der Benutzer muss sicherstellen, dass sich der Katheter nicht durch die Restatmung des Patienten bewegt.

5.5.2 – KOMMUNIKATION DES 3D-MAPPING-SYSTEM – AUTO-TAGGING

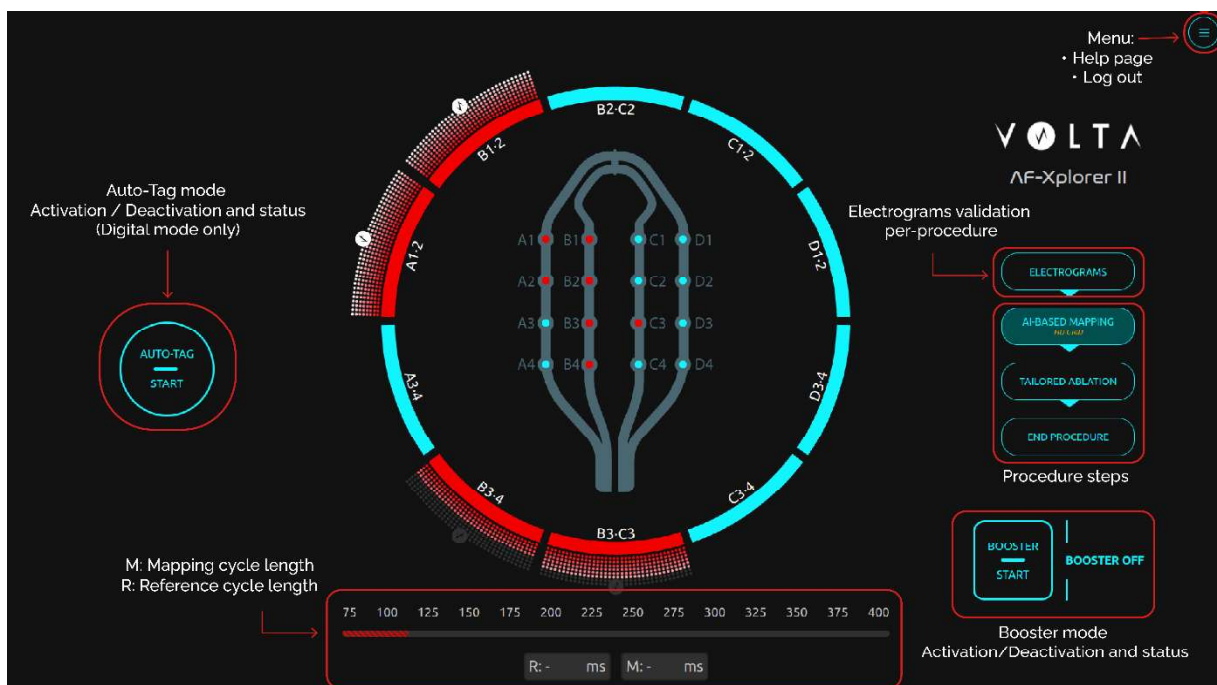

Die direkte Verbindung mit einem 3D-Mapping-System ermöglicht die digitale Signaleingabe und damit sowohl die manuelle als auch die automatische Markierung von ROI. Derzeit ist dies eine optionale Funktion und nur mit dem Abbott EnSite X Mapping-System verfügbar, bei dem das LiveSync-Modul aktiviert ist.

Das Auto-Tagging ist standardmäßig deaktiviert. Wenn der Bediener beabsichtigt, das Mapping mit Auto-Tagging durchzuführen, muss die Schaltfläche „Auto-Tag-Start“ gedrückt werden. Ein Ton ertönt, um zu bestätigen, dass das Auto-Tagging aktiviert ist.

Die Punkte, die von der Auto-Tagging Schaltfläche ausgehen, entsprechen der Anzahl der Tags, die in Echtzeit an das EnSite X System gesendet werden, und ermöglichen es Ärzten zu erkennen, wann ein Tag gesendet wurde.




Wenn die Mapping-Phase manuell durchgeführt wird, müssen die Anweisungen in Abschnitt 5.5.1 befolgt werden.

Für jeden Katheter zeigt die Software die für das Dispersions-Mapping relevanten Elektroden an. Nach Klicken auf die Schaltfläche „Mapping“ wird der Mapping-Prozess mit dem Volta AF-Xplorer II wie folgt fortgesetzt:

- Während der Bewegung des Katheters in beiden Vorhöfen beobachtet der Benutzer regelmäßig das Display.
- Wenn sich der Mapping-Katheter in einem nicht-dispergierten Bereich befindet, werden die Elektroden des Katheters auf dem Bildschirm des Volta AF-Xplorer II in **Blau** angezeigt.
- Befindet sich der Katheter in einem dispergierten Bereich, werden die relevanten Elektroden **Rot** angezeigt und ein akustisches Signal (doppeltes Fingerschnipsen) ertönt, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass er den Katheter stabilisieren muss.
- Wenn die relevanten Elektroden von der Software im Außenrahmen der Benutzeroberfläche bestätigt werden:
 - Ein Ton wird erzeugt, wenn zuvor alle Pads blau waren.
 - Wenn das automatische Tagging aktiviert ist, markiert die Volta AF-Xplorer II Anwendung automatisch die zugehörigen Stellen auf dem 3D-Mapping, die auf der EnSite X DWS zu sehen sind.
 - Um über die Standard-Dispersionsanalyse hinauszugehen, kann das Volta AF-Xplorer II System eine zusätzliche Analyse durchführen, um hochstabile Bereiche unter den als dispergiert klassifizierten EGM zu identifizieren. Diese erweiterte Analyse basiert auf der Stabilität der temporalen Dispersion und der Intensität für jeden Bipol.
 - Hierfür muss der Mapping-Katheter mindestens 5 Sekunden lang (maximal 15 Sekunden) über dem relevanten Bereich stabilisiert werden.
 - Wenn ein Bipol über den verlängerten Zeitraum eine hochstabile Dispersion aufweist, **erscheint eine Anzeige, die sich langsam füllt**. Wenn ein hochstabiler Dispersionspunkt identifiziert wird, leuchtet oben in der Anzeige ein weißer Indikator auf.
- Die Tags werden automatisch mit einem Läsionslabel an das Abbott EnSite X-System gesendet: „Name des Bipols“ für Dispersionspunkte und „**H** - Name des Bipols“ für hochstabile Dispersionspunkte. Diese Tags werden automatisch in Lila versendet. Die Farbe kann im EnSite X System je nach Benutzerpräferenz geändert werden, um die beiden Punktarten besser unterscheiden zu können.

Diese Schritte werden wiederholt, bis das Mapping abgeschlossen ist.

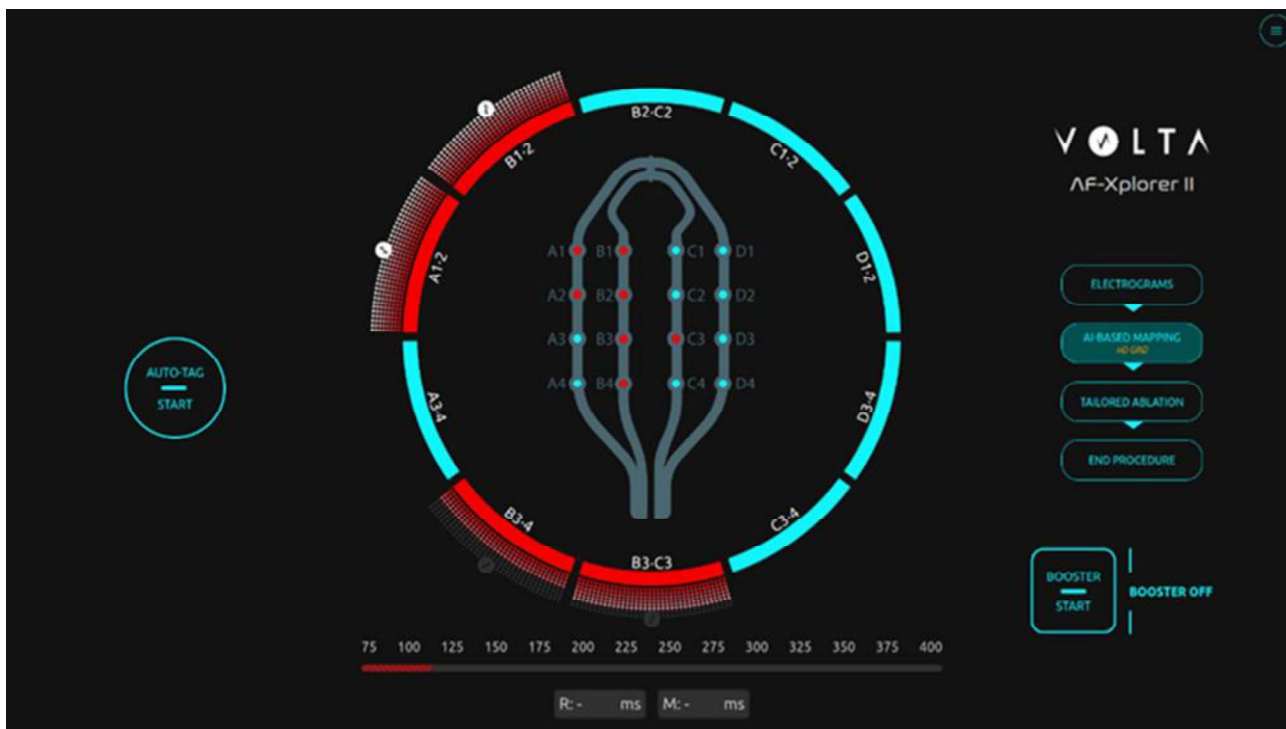

Der Bediener sollte ein komplettes Mapping beider Vorhöfe mit einer maximalen Punktdichte durchführen. Auch sollte der Mapping-Katheter langsam bewegt werden und der Bediener sollte sicherstellen, dass die Punkte auf der Karte korrekt markiert wurden, bevor er den Katheter bewegt.

Der Mapping-Katheter sollte für eine optimale Analyse der auf dem Außenrahmen angezeigten Dispersionspunkte mindestens 3 Sekunden lang über dem untersuchten Bereich stabilisiert werden, für die zusätzliche Analyse der hochstabilen Dispersionspunkte maximal 5 bis 15 Sekunden, bevor die Punkte auf der 3D-Karte automatisch markiert werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Bereichen gewährt werden, bei denen das Mapping schwierig ist (linker Vorhofrand, linke interne Vorhofscheidewand usw.)

Der Bediener muss einen guten Kontakt mit dem Vorhofgewebe herstellen, um die Erfassung von Fernfeldsignalen zu vermeiden.

Am Ende kann der Benutzer intrakardiale Vorhofabbildungen mit Angaben zur Dispersion basierend auf einer Analyse mit dem Volta AF-Xplorer II erhalten.


Der Elektrophysiologe muss die von der Volta AF-Xplorer II Anwendung erstellte Dispersionskarte validieren.



ANMERKUNG

Um eine andere Beurteilung der Verteilung der dispergierten Elektrogramme während des Mappings zu erhalten, kann der Booster-Modus aktiviert werden, um die Empfindlichkeit der Software zu erhöhen. Der Booster-Modus kann beim Mapping von langsamem VHF (CL > 230 ms) oder AT eingeschaltet werden (siehe Abschnitt 5.5.4 dieses Dokuments).

Auf der Hauptseite wird der Booster-Modus wie folgt dargestellt:

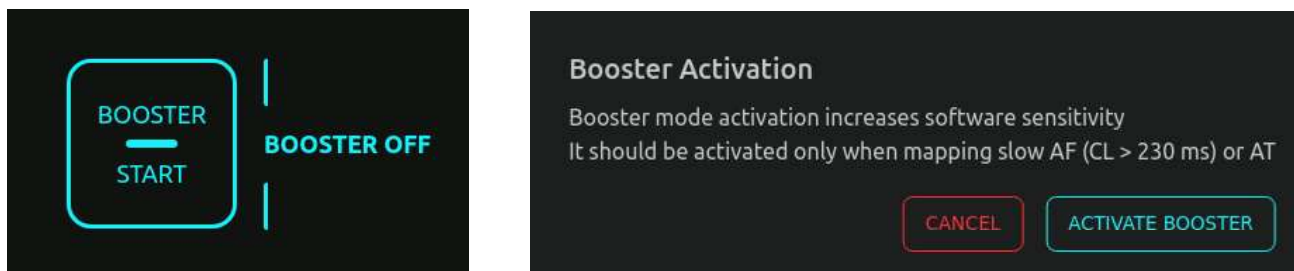

ANMERKUNG

Im digitalen Modus beträgt die maximale Anzahl der auf dem Abbott EnSite X-System aufgezeichneten Läsionen 1024.




Der Benutzer muss sicherstellen, dass sich der Katheter nicht durch die Restatmung des Patienten bewegt.

5.5.3 – ABLATION

Während der Ablation werden die Dispersionsinformationen nicht mehr angezeigt, und die intrakardiale Mapping-Zykluslänge (LCL) ist deaktiviert.

Die Ablationsphase wird unabhängig von dem Volta AF-Xplorer II durchgeführt.

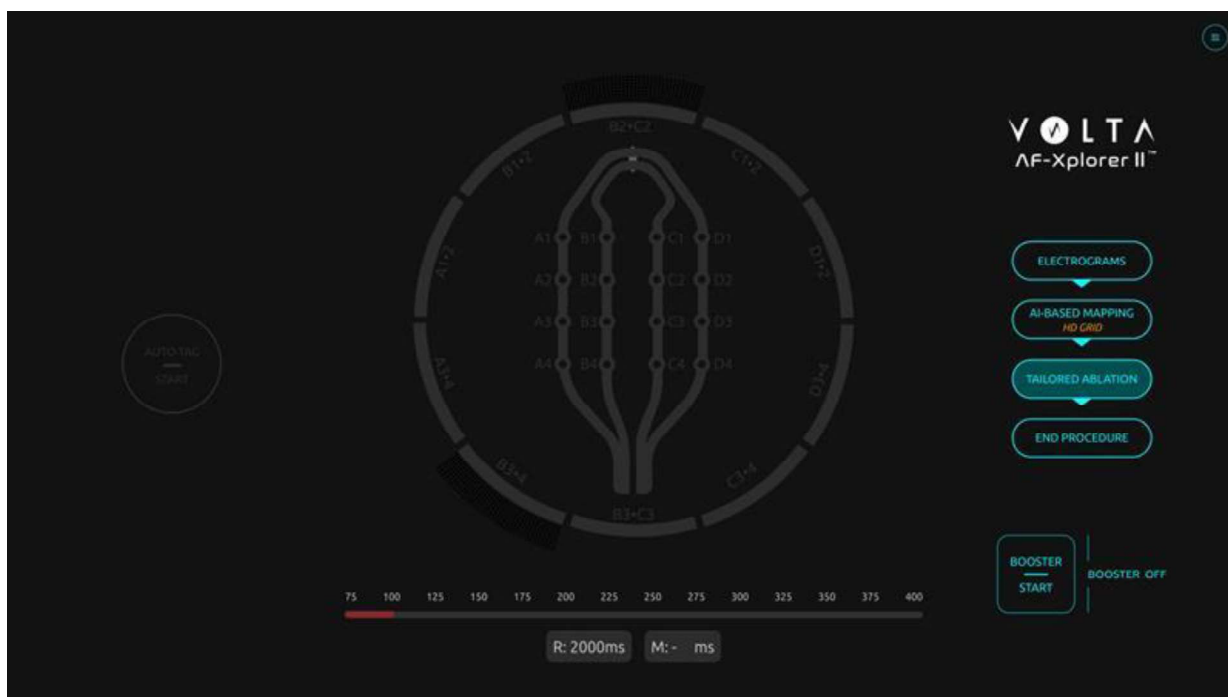


5.5.4 – REMAPPING UND VORHOFTACHYKARDIE-MAPPING




ANMERKUNG

Um eine andere Beurteilung der Verteilung der dispergierten Elektrogramme während des Mappings zu erhalten, kann der Booster-Modus aktiviert werden, um die Empfindlichkeit der Software zu erhöhen. Der Booster-Modus kann beim Mapping von langsamem VHF (CL > 230 ms) oder AT eingeschaltet werden (siehe Abschnitt 5.5.4 dieses Dokuments).

Auf der Hauptseite wird der Booster-Modus wie folgt dargestellt:

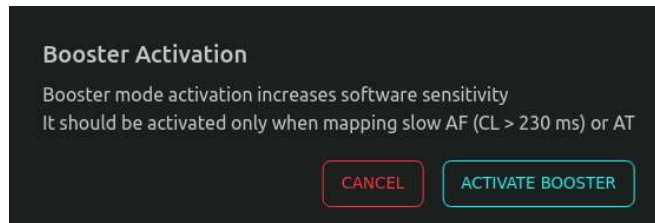


Spezieller Fall des digitalen Modus: Der Benutzer kann entweder das Mapping fortsetzen (vorherige Tags werden bei der Tag-Entscheidung berücksichtigt) oder ein neues Mapping wählen, um ein neues Dispersions-Mapping zu starten (vorherige Tags werden ignoriert).

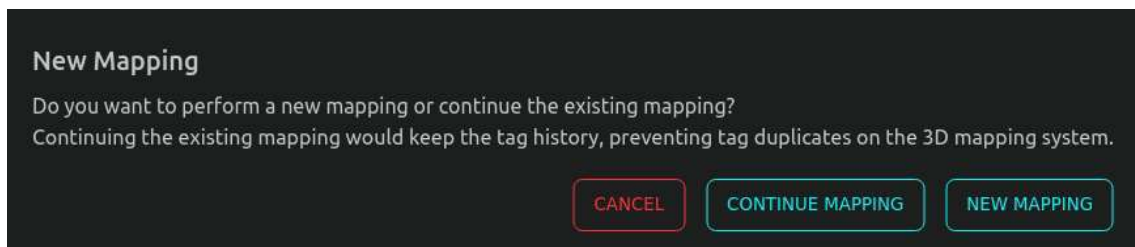

5.5.5 – ENDE DES VERFAHRENS

Wenn das Verfahren des Patienten beendet ist, beendet der Bediener das Verfahren und wählt „Abmelden“ oder „Neues Verfahren starten“. Sobald der Bediener abgemeldet ist, kann er den Computer sicher herunterfahren.

Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, um die Aktion zu bestätigen.

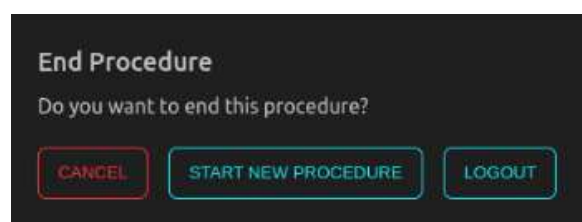



Wenn die Volta AF-Xplorer II Anwendung nicht geschlossen wird und der Computer drei Stunden lang inaktiv bleibt, **während ein Benutzer angemeldet ist**, wird der Benutzer abgemeldet und die Authentifizierungsseite wird angezeigt.

Wenn die Volta AF-Xplorer II Anwendung nicht geschlossen wird und der Computer drei Stunden lang inaktiv bleibt, **ohne dass sich ein Benutzer anmeldet**, schaltet sich der Computer automatisch ab. In diesem Fall wird fünf Minuten vorher eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Computer heruntergefahren wird.



KAPITEL VI – BERECHTIGUNGEN FÜR KRANKENHAUSADMINISTRATOREN

Krankenhausadministratoren, die Bedienerkonten verwalten (Konto aktivieren oder deaktivieren, Bedienerkennwort zurücksetzen).


Um ein Benutzerkonto zu aktivieren, muss der Krankenhausadministrator auf „Benutzer aktivieren“ klicken.

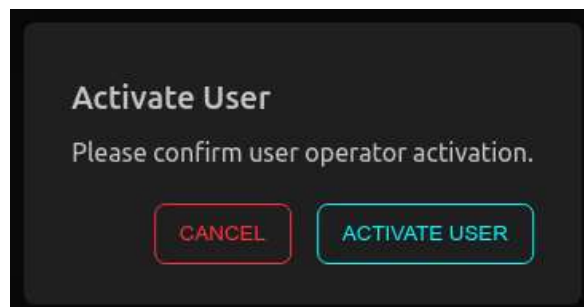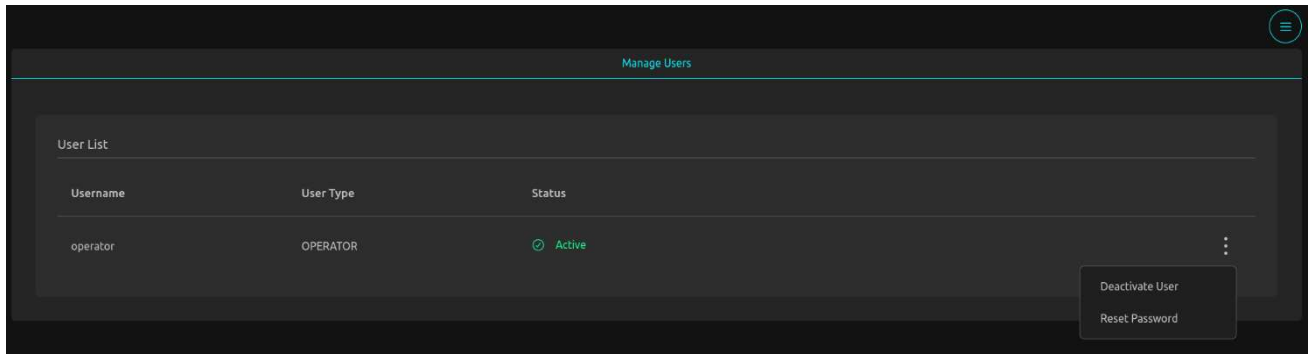


Um ein Benutzerkonto zu deaktivieren, muss der Krankenhausadministrator auf „Benutzer deaktivieren“ klicken.

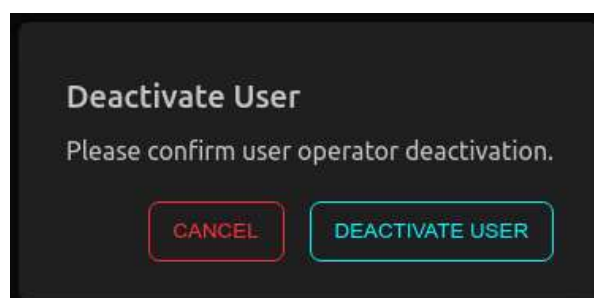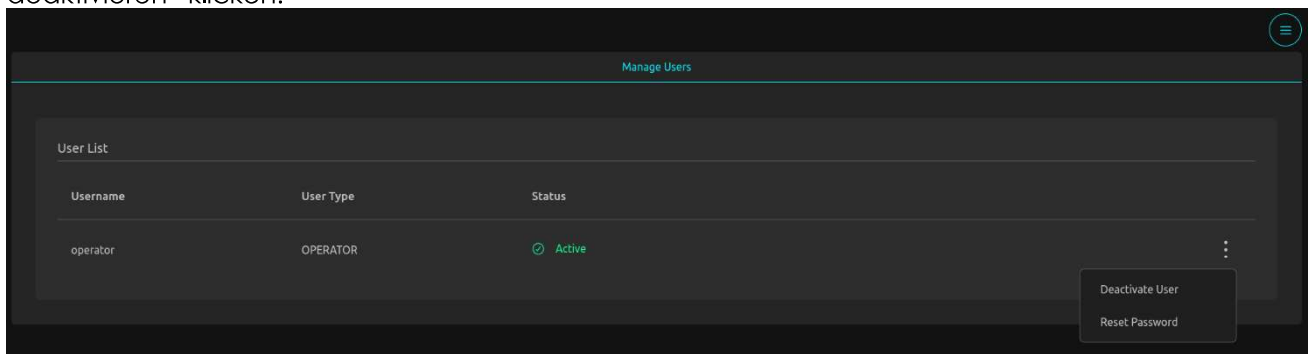

Um ein Benutzerpasswort zurückzusetzen, muss der Krankenhausadministrator auf „Passwort zurücksetzen“ klicken.

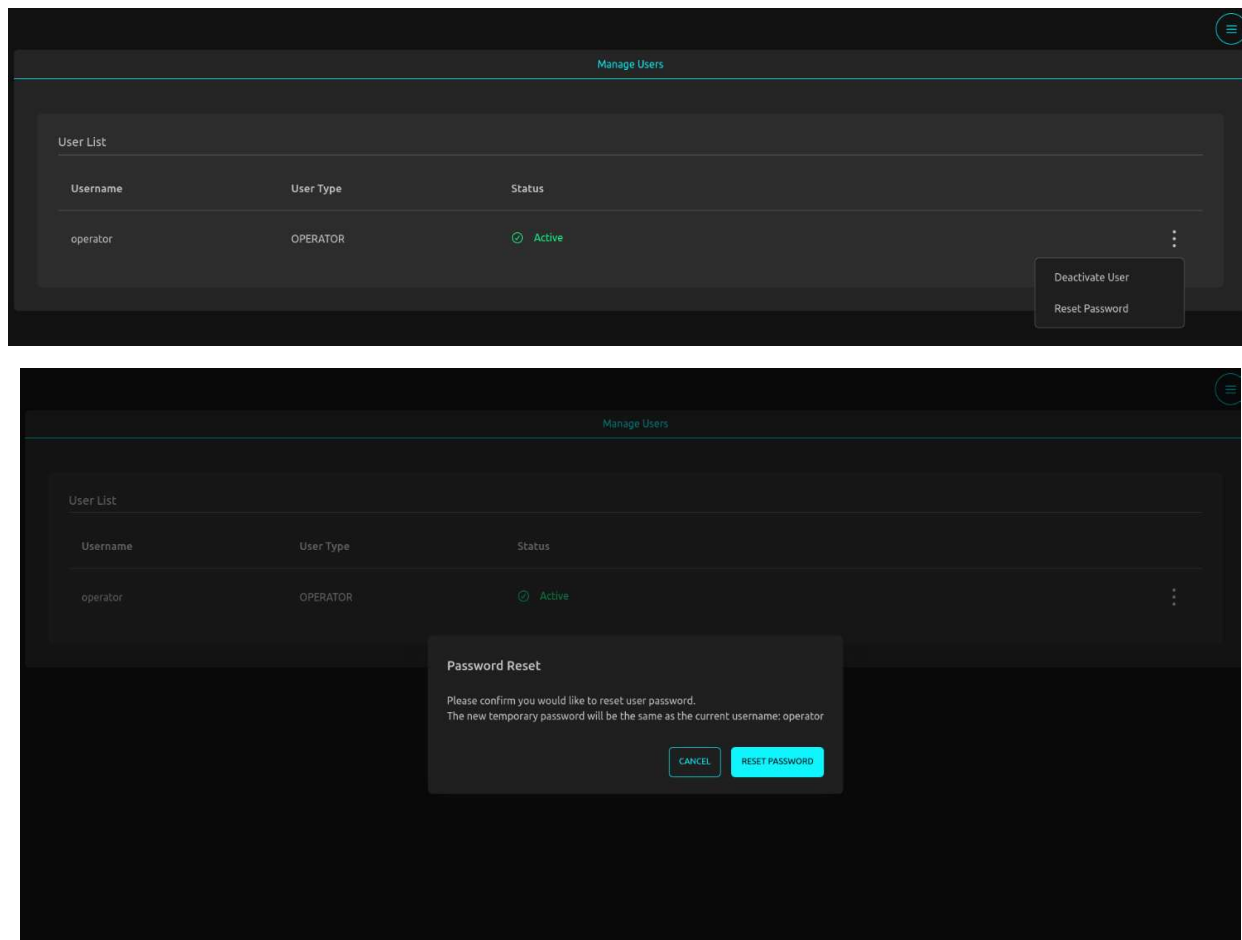

Wenn das Passwort eines Benutzers zurückgesetzt wird, ist das Passwort, das zum Anmelden verwendet wird, identisch mit seinem Benutzernamen. Der Benutzer wird dann aufgefordert, ein neues Passwort zu erstellen, das den Passwortrichtlinien entspricht (zwischen 12 und 50 Zeichen), und auf „Passwort aktualisieren“ zu klicken. Die Passwortrichtlinie wird bei der Installation des Computers über ein Service-Konto festgelegt und definiert bestimmte Anforderungen wie Mindestlänge, Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen.

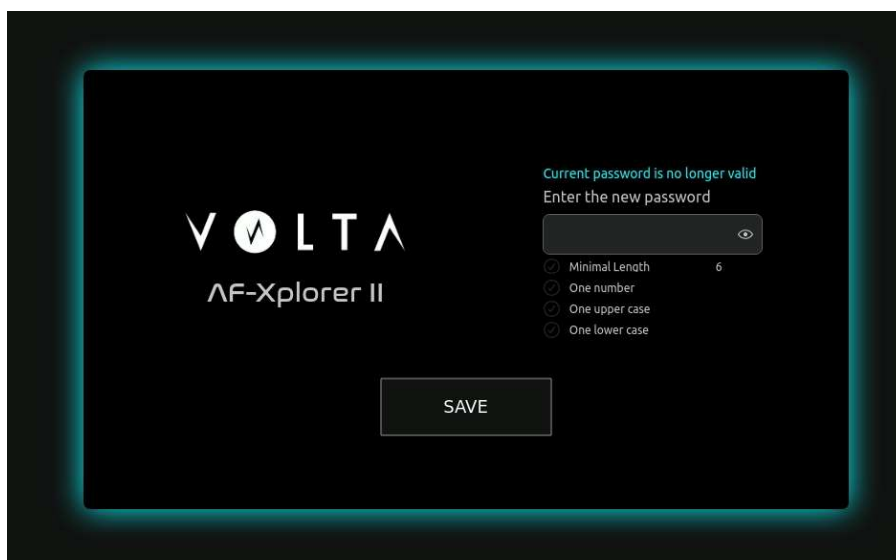

KAPITEL VII – FEHLERBEHEBUNG/VERBLEIBENDE ANOMALIEN

Identifizierte Problemkategorien:

- Anzeigeproblem: Schwarzer Bildschirm, eingefrorener Bildschirm, Auflösung
- Tonsignale
- Authentifizierung
- Vor oder nach einem digitalen Verfahren
- Vor oder nach einem analogen Verfahren

Wenn diese Informationen zur Fehlerbehebung Ihr Problem nicht lösen, oder in Ausnahmefällen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volta Medical Servicevertreter.

Anzeigeproblem:

Problem	Maßnahmen
Bildschirm	Bildschirm an die Stromversorgung anschließen Bildschirm einschalten Prüfen, ob HDMI als Ausgang gewählt ist Netzstecker überprüfen
Workstation	→ Workstation Beleuchtung aus: Workstation ausgeschaltet und nicht mit Strom versorgt → Workstation leuchtet rot: Workstation ausgeschaltet aber mit Strom versorgt → Workstation leuchtet grün: Workstation eingeschaltet  Workstation an die Stromversorgung anschließen Workstation einschalten Netzstecker überprüfen
Bildschirm-Auflösungsproblem	Siehe Hinweise zum Anschluss mehrerer Bildschirme im Kapitel „Installation und Instandhaltung“.

Tonproblem:

Der Ton kommt aus den Lautsprechern des Bildschirms oder aus zusätzlichen Lautsprechern. Der Computer verfügt nicht über integrierte Lautsprecher. Sicherstellen, dass die Lautsprecher des Bildschirms oder zusätzliche Lautsprecher eingeschaltet sind und dass der Ton nicht stummgeschaltet ist.

Authentifizierungsproblem:

Die erstellten Benutzer (Bediener und Krankenhausadministrator) werden in der Registerkarte „Benutzer verwalten“ aufgeführt, die in der Krankenhausadministrator-Sitzung angezeigt wird. Sicherstellen, dass ein Konto für den angegebenen Benutzer erstellt wurde und aktiv ist.

Im Falle eines falschen Passworts oder Benutzernamens sicherstellen, dass der Benutzername und das Passwort entsprechend den Passwortanforderungen, die vom Service-Personal festgelegt wurden, korrekt geschrieben sind, wobei auf Klein- und Großbuchstaben (oO, il, IL), Sonderzeichen und Ziffernblocksperrung zu achten ist. Das verwendete Tastaturlayout muss dem konfigurierten Systemlayout entsprechen.

Passwörter können über das Krankenhaus-Admin-Konto zurückgesetzt werden. Siehe Abschnitt VI. Um ein neues Konto zu erstellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Volta Medical Servicevertreter.

Problem vor oder während eines Verfahrens im digitalen Modus:

Beachten Sie, dass der analoge Modus des Volta AF-Xplorer II Systems im Falle eines Problems im digitalen Modus weiterhin zur Verfügung steht.

Fehlermeldung oder Problem	Maßnahme
Verbindung zu EnSiteX fehlgeschlagen: Zertifikatsfehler - Volta kontaktieren, um das Zertifikat zu aktualisieren	Die Gültigkeit des Zertifikats ist abgelaufen. Wenden Sie sich an Ihren Volta Medical Servicevertreter.
Verbindung zu CardioLab fehlgeschlagen: Zertifikatsfehler - Volta kontaktieren, um das Zertifikat zu aktualisieren.	
Digitaler Kommunikationsfehler - Abbott Live Export Lizenzfehler. Überprüfen, ob der Live-Export auf der Abbott EnSite korrekt konfiguriert ist und erneut versuchen.	Das Volta AF-Xplorer II System stellt fest, dass die Live-Export- oder Live-Sync-Lizenz auf dem EnSiteX nicht richtig konfiguriert ist. Wenden Sie sich an Ihren Abbott Servicevertreter.
Verbindung zu EnSiteX fehlgeschlagen - Überprüfen, ob eine Studie auf dem EnSiteX korrekt gestartet wurde.	Die Studie auf Volta AF-Xplorer II muss nach dem Start der Studie auf EnSite X oder CardioLab gestartet werden.
Verbindung zu CardioLab fehlgeschlagen - Überprüfen, ob eine Studie auf CardioLab läuft.	
Verbindung zu EnSiteX fehlgeschlagen - Überprüfen, ob das Ethernet-Kabel korrekt an Port 2 des Volta AF-Xplorer II Systems und an den Datenport von EnSite X angeschlossen ist.	Einzelheiten zur Verbindung zwischen dem Volta AF-Xplorer II und EnSite X/CardioLab sind im Kapitel Installation zu finden. Wenn das Problem weiterhin besteht: - Das Ethernet-Kabel austauschen. - Volta AF-Xplorer II Systeme neu starten.
Verbindung zu CardioLab fehlgeschlagen - Überprüfen, ob das Ethernet-Kabel korrekt an Port 1 des Volta AF-Xplorer II Systems und an den Datenport von CardioLab angeschlossen ist.	
Kein CS-Katheter erkannt. Sicherstellen, dass der CS-Katheter am EnSite X angeschlossen und richtig konfiguriert und dass der CS-Katheter richtig beschriftet ist.	CS-Katheter anschließen. Sicherstellen, dass der CS-Katheter am EnSite X mit „CS“ oder „SC“ gekennzeichnet ist, oder dass die richtige Katheter-Bezeichnung in der Studienkonfiguration von CardioLab konfiguriert wurde. Das Verfahren neu beginnen, und falls das Problem weiterhin besteht, das Volta AF-Xplorer II System neu starten.
Kein CS-Katheter erkannt. Sicherstellen, dass der CS-Katheter an CardioLab angeschlossen und richtig konfiguriert und dass der CS-Katheter richtig beschriftet ist.	
Es wurde kein kompatibler Mapping-Katheter erkannt. Sicherstellen, dass ein kompatibler, im Benutzerhandbuch aufgeführter Mapping-Katheter angeschlossen ist.	Kompatible Katheter für das digitale Abbott-Verfahren: HD GRID – REFLEXION HD Kompatible Katheter für das digitale GE-Verfahren: alle in Abschnitt 3.9.2 aufgeführten Mapping-Katheter Den kompatiblen Mapping-Katheter anschließen. Wenn das Problem weiterhin besteht: - Den kompatiblen Mapping-Katheter abtrennen und wieder anschließen. - Den Volta AF-Xplorer II Computer neu starten.

Digitaler Kommunikationsfehler: Prüfen, ob das EnSite X in Betrieb ist und ob das Volta-System mit ihm verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Volta.	Zeigt an, dass eine Unterbrechung der Signalübertragung von mehr als 1 s vorliegt. Wenn das Problem weiterhin besteht, den Computer neu starten.
Digitaler Kommunikationsfehler: Prüfen, ob CardioLab noch in Betrieb ist und ob noch eine Studie auf ihm läuft.	
Die Verbindung zu EnSiteX konnte nicht hergestellt werden: Unbekannter Fehler: Prüfen, ob das EnSite X in Betrieb ist und ob das Volta-System mit ihm verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Volta.	Wenden Sie sich an Ihren Volta Medical Servicevertreter.
Digitaler Kommunikationsfehler: Prüfen, ob CardioLab in Betrieb ist und ob das Volta-System mit ihm verbunden ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an volta.	
CardioLab-Kommunikationsfehler: Während einer Studie sind keine Änderungen der Konfiguration möglich.	Nachdem ein Verfahren im Volta AF-Xplorer II System gestartet wurde, darf die Studienkonfiguration von CardioLab nicht mehr geändert werden.
Digitaler Kommunikationsfehler: In der Konfiguration existiert mehr als ein Mapping-Katheter.	Die Studienkonfiguration von CardioLab öffnen und sicherstellen, dass nur ein einziger Mapping-Katheter für die Mapping-Kanäle ausgewählt wurde, die an das Volta AF-Xplorer II System gesendet wurden.
Wir haben festgestellt, dass das System nicht stabil ist. Dies bedeutet, dass der Computer langsamer wird oder dass es eine Latenz in den Signalen gibt. Warten, bis die Meldung verschwunden ist. Wenn das Problem nach einigen Sekunden weiterhin besteht, den Computer neu starten.	- Warten, bis die Meldung verschwunden ist. - Das System neu starten, wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht.
Nach einer Fehlermeldung friert die Software ein: 	Den Netzschalter des Computers betätigen, um ihn auszuschalten. Den Netzschalter erneut betätigen, um den Computer wieder einzuschalten. Wenn das Ausschalten nicht funktioniert, die Stromversorgung für 5 Sekunden unterbrechen und wieder anschalten, bevor das System eingeschaltet wird.
Volta AF-Xplorer II Bildschirm-Standbild	Fehler in der Live-Export-Funktion, aufgrund dessen die Signale nicht richtig vom EnSite X empfangen werden. Wenn auf dem Volta AF-Xplorer II keine Fehler angezeigt werden und die Software dennoch nicht zu reagieren scheint, sollte die Konfiguration überprüft und das Verfahren neu gestartet werden. Wenn der Benutzer nicht in der Lage ist, das Verfahren nach der Überprüfung der Konfiguration erneut zu starten, sollte der Benutzer für den Rest des Verfahrens in den Analogmodus wechseln.

Problem vor oder während eines Verfahrens im analogen Modus:

Problem	Maßnahme
Die Signale sind nicht konsistent zwischen der Signalseite des EP-Aufzeichnungssystems und der Volta AF-Xplorer II Elektrogrammseite.	Den Anschluss und die Konfiguration des EP-Aufzeichnungssystems gemäß dem Kapitel „Installation und Instandhaltung“ überprüfen. Sicherstellen, dass die Parameter auf der Volta AF-Xplorer II Systemeinstellungsseite korrekt angezeigt werden. Sicherstellen, dass das Kabel richtig angeschlossen ist: - DSUB: - o Quelle = EP-Aufzeichnungssystem - o Ziel = Volta AF-Xplorer II - OCTOPUS: Die Stift-Nummern müssen zwischen dem Kabel und der analogen Ausgangsbox übereinstimmen. Siehe Benutzerhandbuch des EP-Aufzeichnungssystems, um einen korrekten Anschluss des Geräts sicherzustellen.
Rauschen der empfangenen Signale	Die korrekte Verbindung der Körperoberflächen-Elektrode des EKG zum Patienten prüfen. Es wird empfohlen, die Kerbfilter während der Überprüfung auszuschalten. Die empfohlenen Filtereinstellungen sollten verwendet werden, um das Rauschen zu reduzieren. Alle Signalkabel (EKG, Katheterkabel, Schläuche, Ablation usw.) so weit wie möglich von Wechselstromfeldern entfernt halten (Komponenten des 3D-Mapping-Systems, Bildschirme, Trenntransformatoren, Stromversorgung usw.).

KAPITEL VIII – REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch und nur mit nicht entflammbar und nicht explosiven Mitteln. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.

Reinigen Sie die Systemkomponenten nicht mit Desinfektionsmitteln, die Tenside enthalten

Reinigen Sie die Systemkomponenten nicht mit Bleichmittel.

Wenden Sie keine Reinigungsmittel an, solange sich das System noch warm anfühlt.

Sterilisieren Sie die Systemkomponenten nicht.

Tauchen Sie die Systemkomponenten nicht in Flüssigkeiten ein.

KAPITEL IX – LAGERUNG UND HANDHABUNG

Das elektro-medizinische Produkt darf nicht in einer sauerstoffreichen Umgebung oder bei Vorhandensein von flammbar Komponenten benutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter § 2.1.

Nur für den Gebrauch in Innenräumen.



Der Konverter ist empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen.
Vermeiden Sie jegliche nicht notwendige Manipulation des Konverters.

KAPITEL X – INSTANDHALTUNG UND ÜBERWACHUNG

Wenn der Volta AF-Xplorer-Computer gewartet oder das System ausgetauscht werden muss, wird das Gerät von einem Vertreter von Volta Medical zurückgenommen und gegebenenfalls ordnungsgemäß recycelt (nach Maßgabe der EEAG-Richtlinie 2012/19/EU).


Bevor das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wird ein Wartungstermin vereinbart, und das Gerät wird von einem Vertreter von Volta Medical ordnungsgemäß entsorgt (nach Maßgabe der EEAG-Richtlinie 2012/19/EU).

Diese Seite ist absichtlich leer

.

Diese Seite ist absichtlich leer

Diese Seite ist absichtlich leer

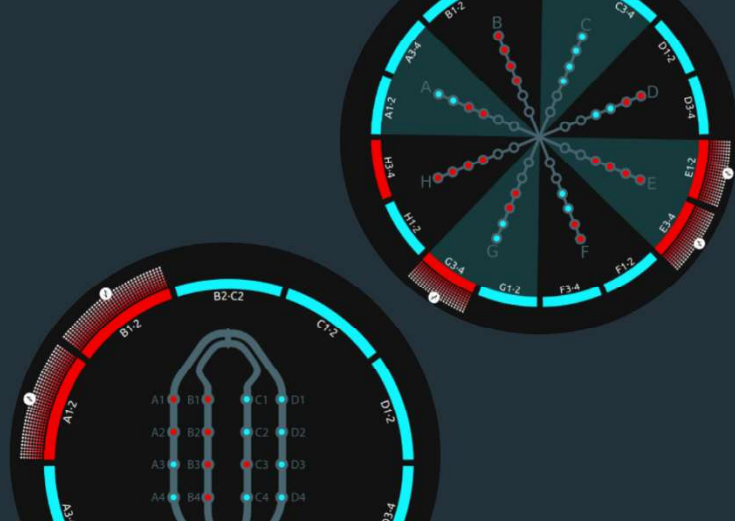

HERSTELLERINFORMATIONEN

PATENTE

Volta Medical hat mehrere Patente auf dem Gebiet der computergestützten Chirurgie angemeldet. Das hier beschriebene Produkt basiert auf einige dieser Patente.

ÄNDERUNG

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Wir haben unser Möglichstes getan, um die Genauigkeit der Informationen in diesem Dokument zu gewährleisten.

COPYRIGHT

©2025 Volta Medical. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Weitergabe dieses Dokuments, oder Teilen daraus, in jeglicher Form oder mit jeglichem Mittel ist ohne eine schriftliche Genehmigung von Volta Medical nicht autorisiert.



Volta Medical
65 Avenue Jules Cantini
13006 Marseille, France



volta-medical.com



contact@volta-medical.com



Für Vertriebs- und technische Anfragen:
sales@volta-medical.com



Online-Benutzerhandbuch: volta-medical.eu/volta-access-ifu

P/N: 301013-E OKTOBER 2025



301013-E