

MedITEX Release Notes

Version 4.0.1


Features

1) MedITEX IVF

a) Allgemein

Dokumentenanhänge aus Emails können per drag & drop direkt in MedITEX hinterlegt werden.

In der Hauptübersicht wurde die Schnellzugriffleiste erweitert. Es können dadurch direkt Einträge aus den Bereichen **Verwaltung**, **Anamnese**, **Untersuchungen** und **Labor** aufgerufen und hinzugefügt werden.

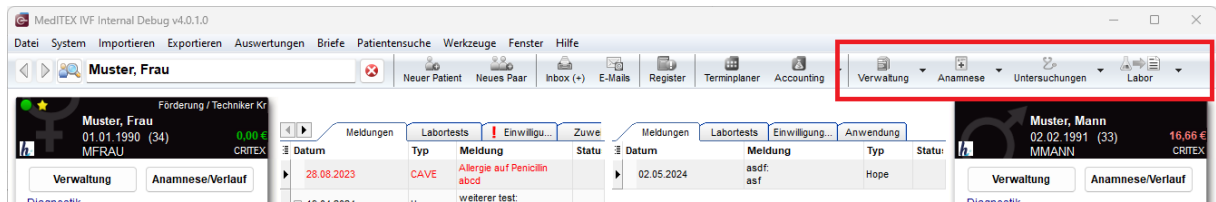


Die Funktion **Krankenschwester** wurde in allen Bereichen zu **MFA** umbenannt.

b) Geplante Therapie

Änderungen in den Vorlagen der geplanten Therapie werden nun im Änderungsprotokoll angezeigt. Dieses kann über **Auswertungen** -> **Protokollierung der Aktivitäten** aufgerufen werden.

c) Therapie

Dem Standardbrief „Zellen am letzten Tag“ wurde der Platzhalter „Eizellnummer“ hinzugefügt.

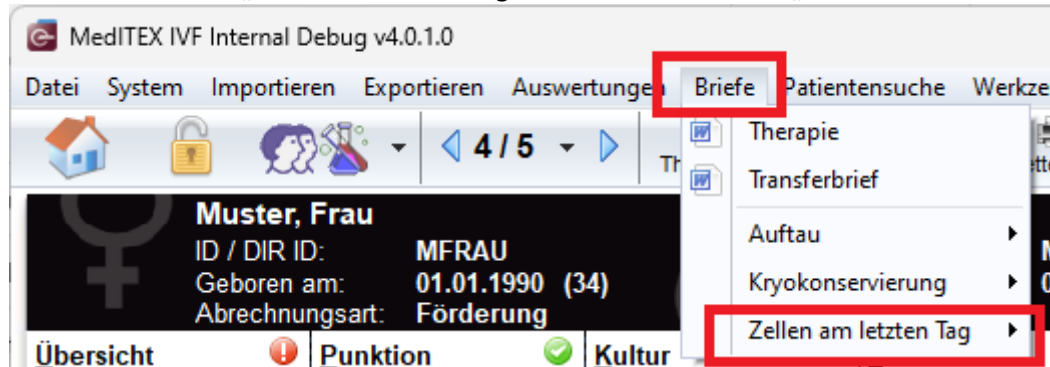

d) Hauptübersicht

Die Spalte „durchgeführte Zusatzmaßnahmen“ wurde zur Hauptübersicht hinzugefügt. Diese kann über die Funktion Spalten ein-/ausblenden angezeigt werden.

MedITEX Release Notes


The screenshot displays the MedITEX software interface. On the left, a filter menu is open, listing various categories with checkboxes. The checkbox for 'Durchgef. Zusatzmaßnahmen' is checked and highlighted with a red rectangular box. The main area shows a patient record for 'Techniker Kr' with a balance of '0,00 € CRITEX'. Below this, there is a table of reports with columns 'Datum', 'Typ', and 'Meldung'. The table contains four entries with dates ranging from 28.08.2023 to 19.04.2024. At the bottom, a table lists patient records with columns 'Nr.', 'Partner', 'Start', 'Behandlung', 'Durchgef. Zusatzmaßnahmen', and 'Stimulation'. The 'Durchgef. Zusatzmaßnahmen' column is highlighted with a red box, and a red arrow points to the first row of this table.

Nr.	Partner	Start	Behandlung	Durchgef. Zusatzmaßnahmen	Stimulation
4	Muster, Mann	18.04.2024	ICSI	Assisted Hatching, Kryokonse	18.04.2024 5d
5	Muster, Mann	15.04.2024	IVF		15.04.2024 5d
3	Muster, Mann	01.04.2024	ICSI		
2	Muster, Mann	04.12.2023	IVF		
1	Muster, Mann	28.08.2023	IVF		28.08.2023 5d

e) Anamnese

Das Bemerkungsfeld in den vorausgegangenen Schwangerschaften wurde vergrößert. Es können nun bis zu 2048 Zeichen anstatt 255 eingegeben werden.

MedITEX Release Notes

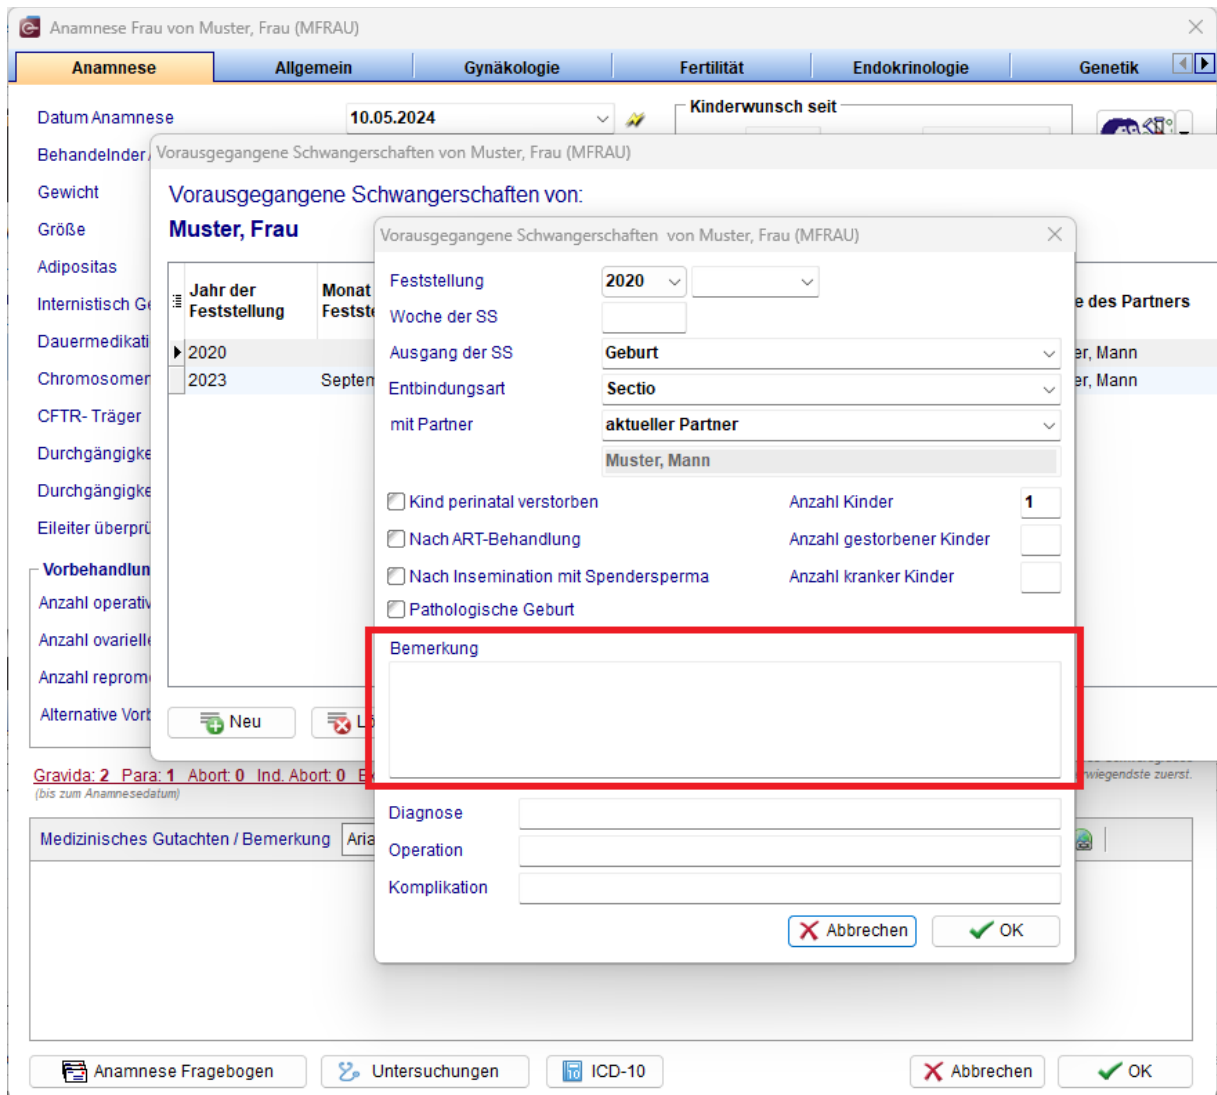

f) Auswertungseditor

Briefe können nun auch in Excelformat erstellt werden.

Für Fragen bzgl. der Erstellung melden Sie sich bitte an unseren Support.

Folgende neuen Felder wurden dem Auswertungseditor hinzugefügt:

Tabelle:

- KRYO Frau
- KRYO Mann

Feld:

- SEC ausgehend
- SEC eingehend

Tabelle:

- Letzten Anamnesen des Paares

Feld:

- Typ der Unfruchtbarkeit

Tabelle:

- Dokumente
- Befunde

MedITEX Release Notes

Feld:

- Bestätigung: Zur Beachtung für
- Bestätigung: Status
- Bestätigt am
- Bestätigung: Kommentar
- Bestätigt von Benutzer

g) Voreinstellungen

Medikamente wurden um die Einheit „Pessar“ erweitert.

The screenshot shows the 'Medikamenten Editor' window. The 'Einheit' field is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing various units. The unit 'Pessar' is also highlighted with a red box. The 'Einsatzbereich' section contains several checkboxes for different medical uses. The 'Darreichung' and 'Mischungsverhältnis' fields are also visible.

Einheit	Darreichung	Mischungsverhältnis
[Amp]		2 : 1
[Creme]		
[Drag.]		
[g]		
[Hübe]		
[IU]		
[Kps.]		
[mg]		
[ml]		
[ng]		
[Pessar]		
[Pflaster]		
[sonstiges]		
[Spray]		
[Tbl]		
[Zäpfchen]		
[µg]		
[µl]		

rec FSH + r	Gonadotropin	Stimulation
rec FSH + r	Gonadotropin	Stimulation
rec hCG	nCG	Auslösung,Lutealphase
rec FSH	Gonadotropin	Stimulation
rec FSH	Gonadotropin	Stimulation
rec FSH	Gonadotropin	Stimulation

2) Accounting

MedITEX Release Notes

Die automatische Erzeugung von Abrechnungsposten für Kryorechnungen wurde erweitert. Die Überprüfung erfolgt nicht mehr ausschließlich beim Programmaufruf, sondern zusätzlich jede Nacht um 4:00 Uhr.

3) ARTBox

Zwei neue Pflichtfelder wurden hinzugefügt. Zum einen in der Anamnese das Feld „Kinderwunsch seit - Jahr“

Anamnese Frau von Muster, Frau (MFRAU)

Tabular navigation: Anamnese | Allgemein | Gynäkologie | Fertilität | Endokrinologie | Genetik

Datum Anamnese: [Redacted]

Behandelnder Arzt: [Redacted]

Gewicht: [Redacted] | BMI: [Redacted]

Kinderwunsch seit

Jahr: [Redacted] | Monat: [Redacted]

und zum anderen das Feld „Abrechnungsart“ in den Therapie Details.

Therapie von Muster, Frau (MFRAU) und Muster, Mann (MMANN)

Muster, Frau (01.01.1990, 34) | Muster, Mann (02.02.1991, 33) | Therapiestandort: CRITEX

Navigation: Allgemein | AWB | Zusatzmaßnahmen | Dokumente | **Accounting**

Abrechnungsart: [Redacted]

Bemerkung für Abrechnung: [Empty text area]

Kosten übernimmt KV:

Die Registereinwilligung für **Kinder Langzeit-Nachverfolgung** wurde hinzugefügt

Registereinwilligungen

Muster, Frau | Filter: [Empty] | Aktualisieren | Drucken

Patientendetails

Patient:	Muster, Frau	Partner:	Muster, Mann	Zustimmung pseudonym. Datenexport an:	Dokument:
ID:	MFRAU	ID:	MMANN	D-I-R / FertiPROTEKT	Ja
Geb-Datum:	01.01.1990	Geb-Datum:	02.02.1991	QSRReproMed	Ja / Nicht notwendig
				D-I-R: Langzeit-Nachverfolgung Kind(er)	[Redacted]
					Ja
					Nein

Patienten / Paare

4) PEI

Die komplette Berechnung des PEI-Exports wurde überarbeitet und an den aktuellen Stand angepasst. Die neuen Berechnungen finden Sie auf unserer Wiki-Seite unter <https://wiki.meditex-software.com/index.php?title=Paul-Ehrlich-Institut>

MedITEX Release Notes

Bugs

5) MedITEX IVF

a) Allgemein

Die fehlerhafte Systemmeldung im Kulturbereich bzgl. fehlendem Spermogramm wurde entfernt.

Dokumente können nun direkt in PDF umgewandelt werden, ein erneutes Öffnen des Eintrags ist nicht mehr notwendig.

Der Report Assistent wurde komplett entfernt.

Darstellungsfehler in Bezug auf Sonderzeichen/Umlaute wurden behoben.

Die Digitale Signatur funktioniert nun wieder wie gewohnt.

Unstimmigkeiten beim Patientenaufruf aus externen Programmen wurden überarbeitet.

b) Therapie

Das Feld „geprüft durch“ beim Erstellen einer Insemination zeigt nun nur noch die dafür möglichen Mitarbeiter an.

Die Anzeige des Screeningtyps in der PID-Analyse stimmt nun mit der Anzeige in der Kultur überein.

Kompatibilitätsanpassungen für unterschiedliche Datumsformate wurden vorgenommen.

c) Geplante Therapie

Unstimmigkeiten in der Funktion „Geplante Therapie aus der ursprünglichen Planung erzeugen“ wurden behoben.

Der Titel des Patienten wird in der geplanten Therapie wieder angezeigt.

Fehlermeldung beim Benutzerwechsel wurde behoben.

d) Anamnese

Befunde mit Medikamenten können nun wieder dupliziert werden.

Fälschlicherweise erzeugte vorausgegangene Schwangerschaften wurden wieder entfernt.

e) Untersuchungen

Ultraschallbilder bleiben in MedITEX bestehen, auch wenn die Therapie gelöscht wird.

f) Verwaltung

Falsche Infomeldung beim Erstellen einer Partnerschaft wurde angepasst.

g) Auswertungseditor

Schwangerschaftsauswertungen ohne dokumentierte Schwangerschaft werden nun richtig angezeigt.

Der Eintrag **Auftau Embryo/Eizelle** wurde zur besseren Verständlichkeit in **Auftau Embryo/Eizelle geplant** umbenannt.

Darstellungsprobleme für Filter wurden behoben.

Die Verlinkung zwischen Kryo Mann und Spermogramm wird wieder richtig ausgeführt.

MedITEX Release Notes

h) Kryolager

Partner ID wird nun wieder überall angezeigt.

Blitzsymbole für **Eingefroren/Eingelagert durch** können wieder wie gewohnt verwendet werden.

i) Voreinstellungen

Doppelte Medikamente in der Medikamentenliste können nun wieder bearbeitet werden.

6) Terminplaner

Fehlermeldung in der allgemeinen Terminliste wurde behoben.

7) Accounting

Probleme mit Erreichen der letzten Rechnungsnummer wurden beseitigt.

Schreibfehler wurden wieder richtiggestellt.

Nicht dokumentierte Transaktionen werden nun wieder angezeigt.

8) KPI

Layoutprobleme wurden behoben.

9) ARTBox

Durchgeführte heterologe und homologe Behandlungen werden wieder richtig an die ARTBox geschickt.

Regelanpassungen in Bezug auf DERI wurden vorgenommen.

Fehlendes Pflichtfeld für OHSS wurde wieder hinzugefügt.

10) Backup

Anpassungen an der Funktion „alle Verbindungen automatisch schließen“ der täglichen Datensicherung wurden vorgenommen.

Die Datensicherung während dem Betrieb funktioniert nun wieder wie gewohnt.