2026年09月16日(三) 智齡科技JUBO | 三三分享會

長照3.0智慧輔具補助制度大解析（三年6萬額度）




劉旻宜 Mini

輔具家ATHome 營運長

- 臺灣長照物理治療學會LTCPTA 副秘書長
- 高齡智慧照護產業加速器ATAP 顧問
- 臺灣輔助科技及照顧福祉推廣協會ATCW 監事
- 臺灣輔具產業發展協會TATIA 理事


LINE請搜尋 @athome.Taiwan

輸入「JUBO好朋友」取得今日簡報完整檔

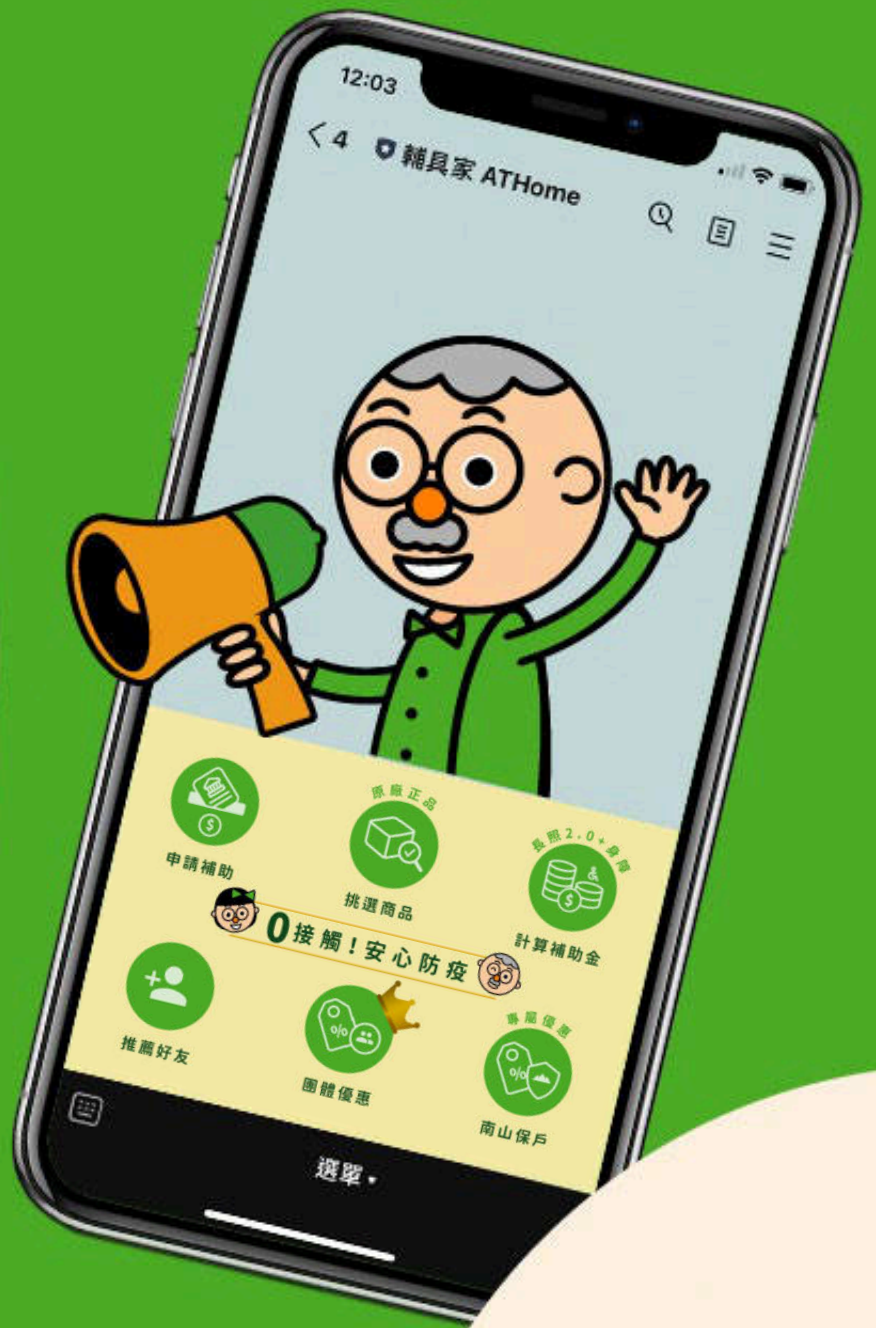

長照3.0將擴大服務對象（2026年1月1日起）

- **全年齡失智症者**：從過去僅限50歲以上失智症者，放寬至未滿50歲的年輕型失智症者，只要符合失能程度評估，即可申請長照服務。
- **急性後期整合照護計畫（PAC）對象**：PAC收案對象（如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭與衰弱高齡病人等）在出院後若經評估仍失能，可無縫銜接長照3.0服務，避免出院後的照顧空窗期。

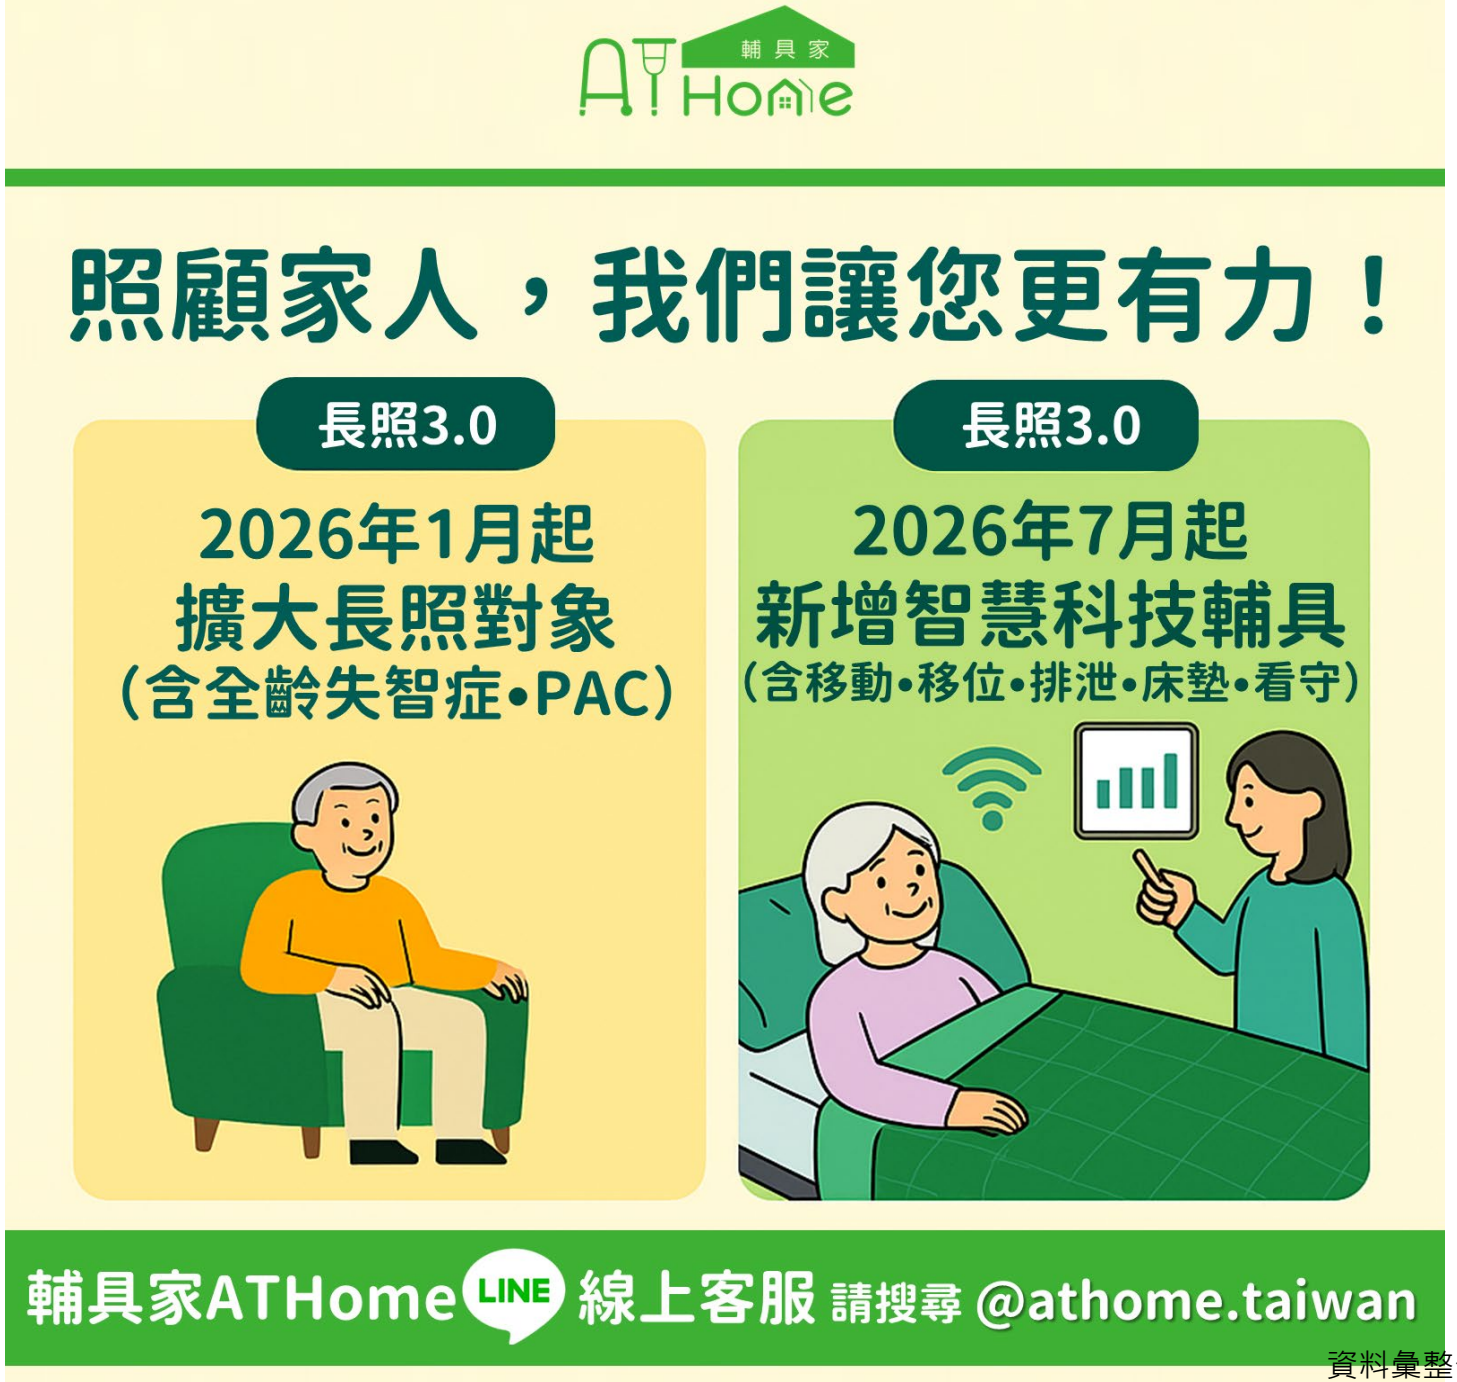

長照3.0將新增智慧輔具補助（2026年7月1日起）

- EI 01 移位類
- EI 02 移動類
- EI 03 排泄類
- EI 04 居家照顧床類
- EI 05 安全看視類

資料彙整分析｜輔具家ATHome｜2026年03月

● 2024年09月起｜衛生福利部住宿機構照顧品質獎勵計畫（2024年 至 2027年）

【機構】指標4 智慧輔助照顧科技運用（每家機構每年至多獎助3項，每項至多獎助2年）				
第一類	第二類	第三類	第四類	第五類
行動感知	移動支援	照護支援	排泄支援	入浴支援
結合物聯網與人工智慧技術，與整體環境整合，協助使用者進行各種日常生活活動，含離床、跌倒、走失等監測功能或 24 小時安全與健康自動巡房輔助照顧科技、智慧床墊。	結合資通訊、感測與機電等先進技術，提升高齡者獨立生活與社會參與的能力 ，如健康促進復能訓練功能、自動翻身輔助照顧科技。	如久臥監測、可即時監測及收集個案移動情形。	如排泄物處理、尿量監測、排泄監測。	如自動沐浴輔助照顧科技。

● 2026年07月起｜衛生福利部新增「居家智慧科技輔具（五大類）」補助（一般戶每3年6萬上限）

【居家】長期照顧服務申請及給付辦法 附表四之一 照顧組合表-智慧科技輔具				
第一類	第二類	第三類	第四類	第五類
EI 01 移位類	EI 02 移動類	EI 03 排泄類	EI 04 居家照顧床類	EI 05 安全看視類
執行移轉位活動經常有困難，需使用輔助移轉位裝置者	執行步行活動經常有困難，需使用電動輪椅、電動代步車或步行移動裝置者	活動能力有困難且動作控制能力不佳、執行排泄活動經常有困難，需使用輔助如廁或輔助處理排泄物裝置者	長期臥床、執行翻身或坐起活動經常有困難，或下肢與平衡功能不佳之高跌倒風險者，需使用輔助照顧長時間臥床或不定時離床裝置	長期臥床、獨居、失智症者或需生理或活動數據監控者
詳細「規格/功能規範」請見下列簡報逐項載明細節規定	詳細「規格/功能規範」請見下列簡報逐項載明細節規定	詳細「規格/功能規範」請見下列簡報逐項載明細節規定	詳細「規格/功能規範」請見下列簡報逐項載明細節規定	詳細「規格/功能規範」請見下列簡報逐項載明細節規定



長期照顧輔具產品資料庫查詢平臺

查詢公開輔具產品、廠商與長照補助相關資訊

快速查詢

找產品與長照輔具給付碼別

可依產品名稱、型號或長照輔具給付碼別查詢公開輔具產品資料。

產品名稱

輸入產品名稱

型號

輸入型號

長照輔具給付碼別

如 EI04，或碼別名稱如：床、移位

產品查詢 →

製造商/代理商查詢

長期照顧輔具產品資料庫查詢平臺產品(115.6.30 更新)

No	產品名稱	產品型號	廠商	給付碼別
1	FREE Walk 自立行外骨骼輔助機器人	FW-PR-01 / FW-PR-02	福寶科技股份有限公司	EI02
2	HipBO-輕量型動力髖關節機器人輔具	HB-PR-02	福寶科技股份有限公司	EI02
3	AI 智慧定位鞋墊	-	有創科技股份有限公司	EI05
4	智慧光纖坐墊	USC-003B-10	滙嘉健康生活科技股份有限公司	EI05
5	智慧光纖照護薄墊	USC-003B-10	滙嘉健康生活科技股份有限公司	EI04、EI05
6	智慧光纖薄墊監視器	HIME-001-A	滙嘉健康生活科技股份有限公司	EI04、EI05
7	AIoT 智慧型翻身輔助器	SL-BBI00M-EX	碩享科技股份有限公司	EI04
8	AIoT 全自動排泄處理機	SL-EEI02M	碩享科技股份有限公司	EI03
9	WhizPad 安心臥智慧床墊	SP-600	世大福智科技股份有限公司	EI04、EI05
10	智世代變形電動車 銀翼 BSG	"BestShape" Go Powered Wheelchair	緯創醫學科技股份有限公司	EI02
11	AI 零接觸樂活偵測系統	BestShape Care	緯創醫學科技股份有限公司	EI05
12	AI 零接觸智能照護系統	BestShape VS	緯創醫學科技股份有限公司	EI05
13	iCue 智慧照護幫手	SM_N01	維思感創股份有限公司	EI04、EI05
14	iCue 智慧照護幫手+生理量測組	SM_N01/iCue_Hah	維思感創股份有限公司	EI04、EI05
15	智慧感知氣墊(基礎版)	Lite-V101	輔人科技股份有限公司	EI04、EI05
16	智慧感知氣墊(標準版)	Std-V101	輔人科技股份有限公司	EI04、EI05
17	伊鍵通-Ai+高齡智慧守護系統服務	OT Guard	瞬通科技股份有限公司	EI05

● 長照2.0提供一般輔具購買及租賃、長照3.0提供智慧輔具租賃，兩者有何不同？

長照2.0 vs. 長照3.0

每三年可**擇一組合**輔具補助

基礎輔具+住宅改造(3年4萬)

包含47項基礎輔具(E碼)、21項住宅改造(F碼) 、爬梯機

● 組合一(3年4萬)：基礎輔具+住宅改造

包含47項基礎生活輔具(E碼)、29項住宅改造(F碼)、【爬梯機】

● 組合二(3年6萬)：科技輔具+住宅改造

2026年7月1日起新增這一組合選擇

- 限定「租賃訂閱」服務模式
- 包含「五大類 居家科技輔具」

(移位類、移動類、排泄類、居家用照顧床類、安全看視類)

Mini建議：

1. 特別適合已有一般基礎輔具，想加強自主生活訓練、讓居家生活更安全的家庭！
2. 不論選擇哪一組合，記得同步搭配「身障輔具購買補助」資源，更靈活彈性！

資料彙整分析｜輔具家ATHome｜2026年06月





【輔具家ATHome】生活動態安心看守感應器

月租金：$999（僅為範例試算，預計10月正式上市）

【範例】65歲媽媽，身體衰弱，長照CMS等級2，與健康爸爸同住，子女皆沒有住在一起。長期運用長照資源使用生活動態感應器(3年)，維持安心獨立的自在生活，工作忙碌的子女也能遠端同步安心守護。

長照智慧輔具補助｜$999 * 70% * 36個月= $25,175（三年總計）
剩餘自付額度｜$999 * 30% * 36個月= $10,789（三年總計）

運用政府資源省下$25,175元、三年總計自付額度為$10,789元。
還有剩餘$24,036額度可靈活運用！（每人總額度有3年6萬）
還可再進行住宅微改造(扶手/防滑等等)、購買簡易助行輔具，安心生活❤️



【輔具家ATHome】緯創醫學BSG智慧助行器(專業版)

月租金：$18,000（僅為範例試算，預計10月正式上市）

單機購買價：$250,000

【範例】75歲爸爸，患有帕金森氏症，長照CMS等級5，有身障證明第七類，先運用長照資源租賃智慧助行器2個月後，決定轉為購買作為長期生活使用，幫助生活維持自立、安全步行、健康生活。

搭配長照資源｜$18,000*30%*2個月= 自付額 $10,800（租賃）
搭配身障資源｜$250,000-$25,000= 自付額 $225,000（買斷）
廠商額外優惠：租轉購｜自付額租金全額再折抵！（折$10,800）

先租賃試用2個月，確認合適再轉購買。整體自付額$225,000元。
等於運用政府資源省下$50,200元，獲得免費2個月租賃試用體驗！❤️

每三年，兩大組只能選擇一組。

長照2.0
3年4萬(一般戶2.8萬)

照顧管理中心

- 住長照機構者無法申請
- 額度包含「輔具」+「住宅改造」+「爬梯機(租賃)」
- 共68項目：購買(64項)、租賃(15項)
  EA01-EH05 生活輔具(47項)
  FA01-FA21 居家無障礙設施(21項)
- **都需要先經政府核定再購買，才能取得補助。**
- 部分縣市有再加碼補助項目

長照3.0
3年6萬(一般戶4.2萬)
2026年7月1日起

- 新增五大類「智慧輔具科技」補助：EI 01 移位類、EI 02 移動類、EI 03 排泄類、EI 04 居家照顧床類、EI 05 安全看視類。
- **傳統輔具vs.智慧輔具每三年只能擇一類**

身障
2年4項

輔具中心

生活輔具

醫療輔具

- 16項限居家使用
- 包含242項生活輔具+16項醫療輔具
- 只補助「購買」
- 包含「住宅改造」、「爬梯機(購買)」
- **都需要先經政府核定再購買，才能取得補助。**
- 部分縣市有再加碼補助項目

資料彙整分析｜輔具家ATHome

長照 智慧輔具

- **EI 01 移位類**
- EI 02 移動類
- EI 03 排泄類
- EI 04 居家照顧床類
- EI 05 安全看視類

碼別	照顧組合名稱	適用對象	規格/功能規範	租賃價格
EI 01	移位類	執行移轉位活動經常有困難，需使用輔助移轉位裝置者	一、應符合下列情形之一： (一)以電力驅動馬達或電動缸，搭配站立式、臥式或坐式之各款拉升或撐起裝置，以進行人員移位。 (二)以人力操作齒輪、滑輪、槓桿或吊帶拉升以進行人員移位之省力機械裝置。 二、除上述一情形外，選配之輔具並應符合下列功能之一： (一)可進行活動監控或生理數據記錄，藉由影像、壓力、訊號或其他方式感測，並具有掌握受照顧者活動及異常事件通報功能，且得透過記錄數據、通訊傳輸、分析判斷與回饋機制(使用者或設備本體)之設備。 (二)具備壓力偵測、動作感知、異	由長照特約單位訂定，並報經地方主管機關備查

資料來源｜全國法規資料庫｜長期照顧服務申請及給付辦法｜2025年06月19日

長照 智慧輔具

- EI 01 移位類
- **EI 02 移動類**
- EI 03 排泄類
- EI 04 居家照顧床類
- EI 05 安全看視類

EI 02	移動類	執行步行活動經常有困難，需使用電動輪椅、電動代步車或步行移動裝置者	一、電動輪椅、電動代步車或步行移動裝置，並應符合下列功能之一： (一)可進行活動監控或生理數據記錄，藉由影像、壓力、訊號或其他方式感測，或透過雲端方式管理數據，並具有掌握受照顧者活動及異常事件通報功能，且得透過應用程式、簡訊、社群媒體或其他方式即時推播訊息、分析判斷與回饋機制(使用者或設備本體)之設備。 (二)具備危險偵測、行動感知、異常事件警示或其他任一反應。 二、電動代步車以四輪規格為原則，且兩前輪之輪胎內側距離須大於三十公分。	由長照特約單位訂定，並報經地方主管機關備查

資料來源｜全國法規資料庫｜長期照顧服務申請及給付辦法｜2025年06月19日

標準產品

Canpower 系列



多功能升降(移位)機

用途:照護者進行個案從床、輪椅、洗澡椅等移轉位運用



如廁移位升降機

用途:照護者進行個案移轉位、如廁、坐站訓練等運用



懸吊步態訓練機

用途:輔助中重度失能個案進行站立、步行訓練等運用



扶持步態訓練機

用途:輔助輕中度失能個案進行站立、步行訓練等運用

Canlife 系列



照護移位機

用途:提供下肢無力及高齡長輩日常生活照護與訓練運用



起身站立照護機


用途:提供下肢失能或高齡長輩照護及站立訓練運用

資料來源｜全能照護｜2026年03月

應用案例-扶持步態訓練機

- 輔助個案乘坐於床邊之輔助使用。
- 提供站立、行走之輔助，添加胯下防護帶可避免個案跌倒。

- **主要用戶:**
  居家、照護機構
  、

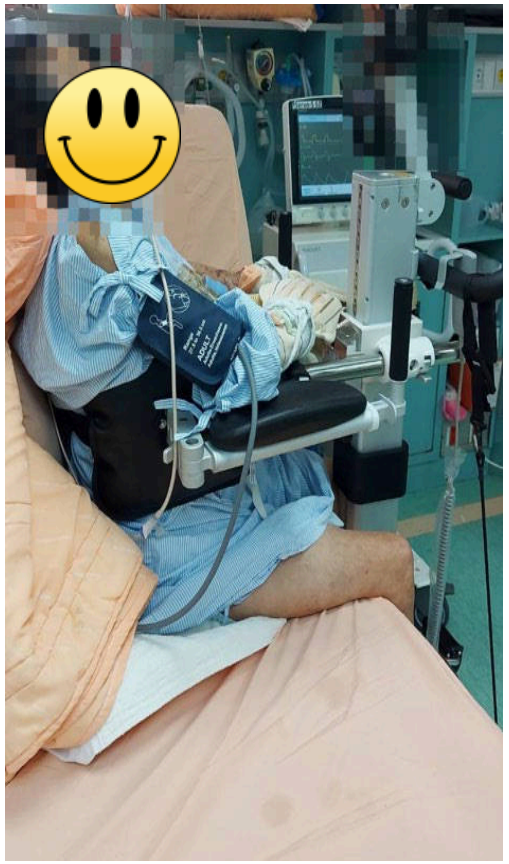



床邊輔助





站立訓練

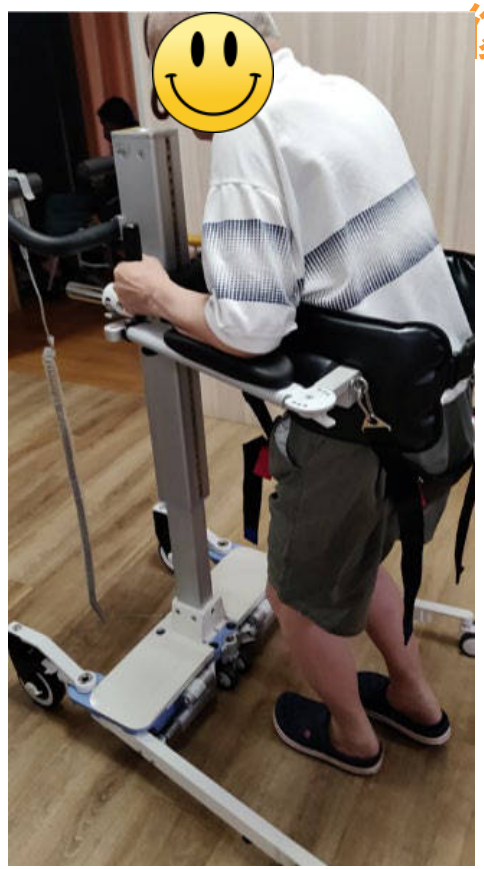

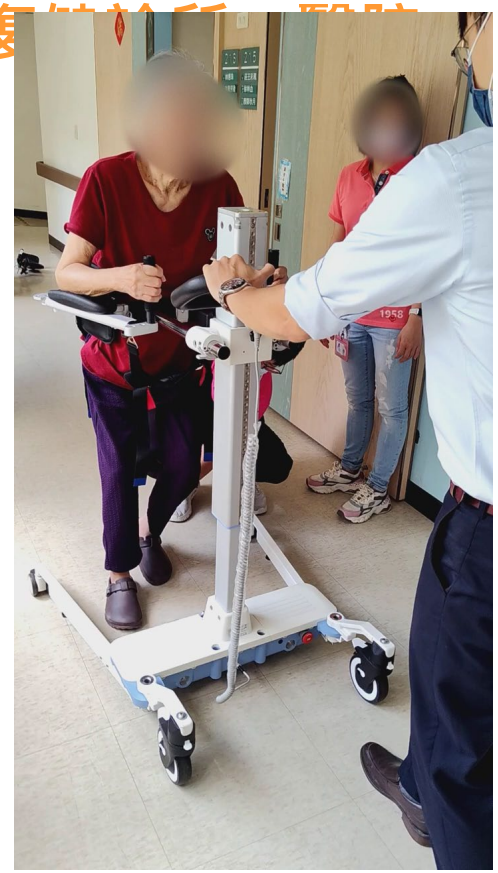

步行訓練


資料來源｜全能照護｜2026年03月


應用案例-懸吊步態訓練機

- 設備體積小，適合居家及復健場域使用。
- 可與其他輔具搭配進行復健訓練。

◆ **主要用戶:**
居家、照護機構
、



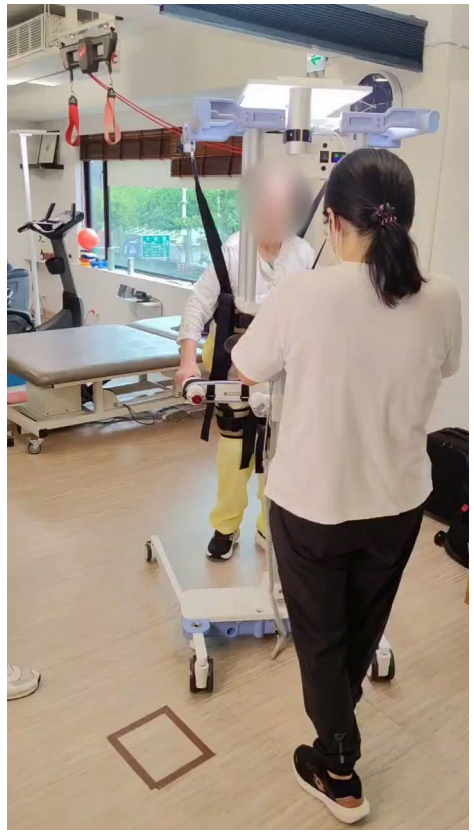

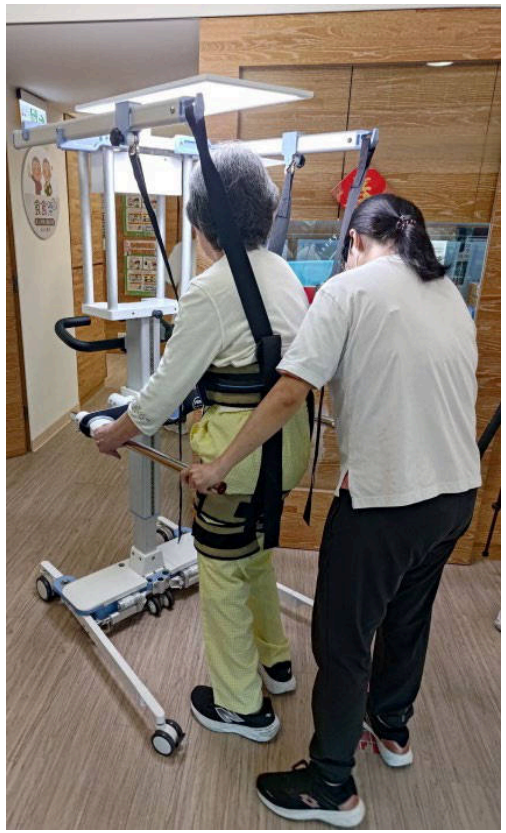

步行訓練





搭配復健跑步機

資料來源｜全能照護｜2026年03月

操作系統資訊


●訓練前設定/訓練中顯示-即時監測個案生理狀況



個案選擇



設備選擇

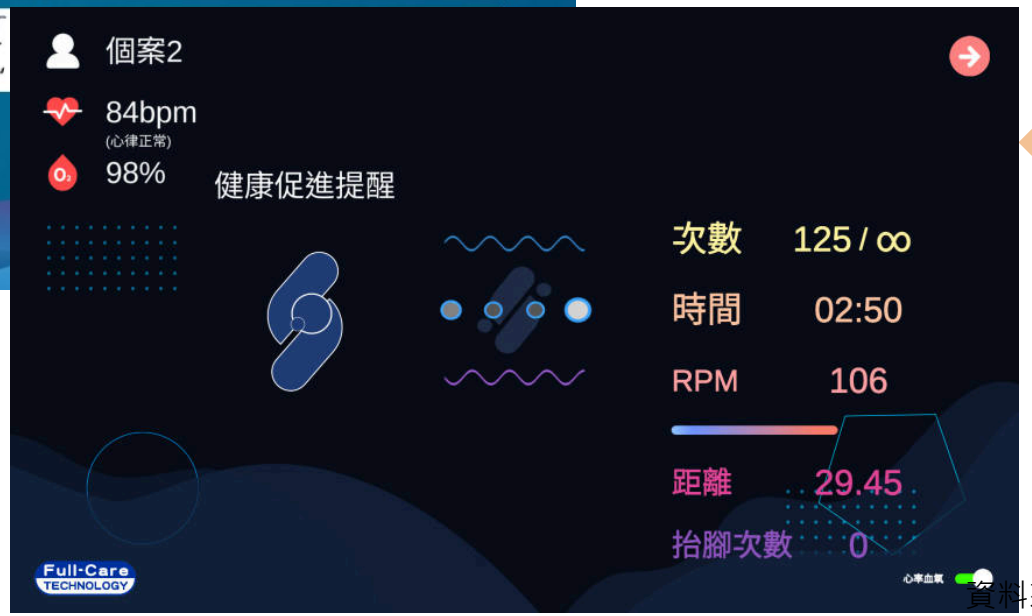

即時數據

資料來源｜全能照護｜2026年03月



資料來源｜緯創醫學-智慧助行器BSG(家用個人醫療版)｜2026年05月

臨床驗證1_ 髖關節置換術後使用

BSG臨床驗證IRB

膝/髖關節置換術後使用(萬芳骨科合作)

顯著提升術後病人的行走速度、步幅角度與關節活動度





Comparing performance improvement between the two walker groups

Variables	Conventional Walker	Smart Walker (BSG)	P-value
Hip range of motion (°)	6.88 ± 17.50	23.44 ± 13.00	0.005
Gait analysis Speed (m/s)	0.03 ± 0.03	0.08 ± 0.07	0.024
Gait analysis Stride angle (°)	7.13 ± 12.93	16.45 ± 11.63	0.040



資料來源｜緯創醫學-智慧助行器BSG(家用個人醫療版)｜2026年05月




廁 所



BSG APP

BestShape Go行走訓練APP





1. 新增使用者，長按可刪除。
2. 若使用者名單空白，會自動帶入系統預設人名







1. 點選完成訓練。
2. 重置-清除使用者和回復預設模式

使用者可依能力選擇模式



3｜Hip-BO
（2026年Q3）

1｜Free-Walk



2｜Nim-BO
（純自費）

資料來源｜福寶科技｜2026年05月





資料來源｜臉書粉專：醫生壞掉以後｜2026年05

行


1 行動自如



2 平衡穩定度較差



3 需扶著走



4 無法走.但坐得穩



5 無法走.且坐不穩



LEVEL1 LEVEL2 LEVEL3(單手) LEVEL3(雙手) LEVEL4-5
















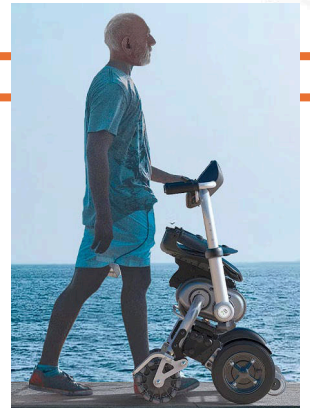



長照 智慧輔具

- EI 01 移位類
- EI 02 移動類
- **EI 03 排泄類**
- EI 04 居家照顧床類
- EI 05 安全看視類

EI 03	排泄類	活動能力有困難且動作控制能力不佳、執行排泄活動經常有困難，需使用輔助如廁或輔助處理排泄物裝置者	可於居家環境中協助照顧者處理排泄物，並應符合下列功能之一： 一、可進行活動監控或生理數據記錄，藉由影像、壓力、訊號或其他方式感測，或透過雲端方式管理數據，並具有掌握受照顧者活動及異常事件通報功能，且得透過應用程式、簡訊、社群媒體或其他方式即時推播訊息、分析判斷與回饋機制(使用者或設備本體)之設備。 二、具備排泄監控、排泄警示或其他任一反應。	由長照特約單位訂定，並報經地方主管機關備查

資料來源｜全國法規資料庫｜長期照顧服務申請及給付辦法｜2025年06月19日

工作流程

正昌容
健康是座山

人性化智能處理流程

(1)自動偵測



自動感應排泄物

(2)自動處理大小便



吸抽大小便

(3)自動溫水清洗



溫水清洗

(4)自動烘乾




暖風烘乾

監測功能

透過顏色和聲音可以獲知尿片的乾濕程度（吸收狀態），選擇最佳的更換時機。



依排尿量的多少，紙尿褲標示與顯示燈的顏色會發生相應改變，以此來獲知尿片的乾濕情況，并在尿量較多需要更換時(紅色)，透過手機獲取通知，或由顯示燈呈紅色並發出聲音進行報警。

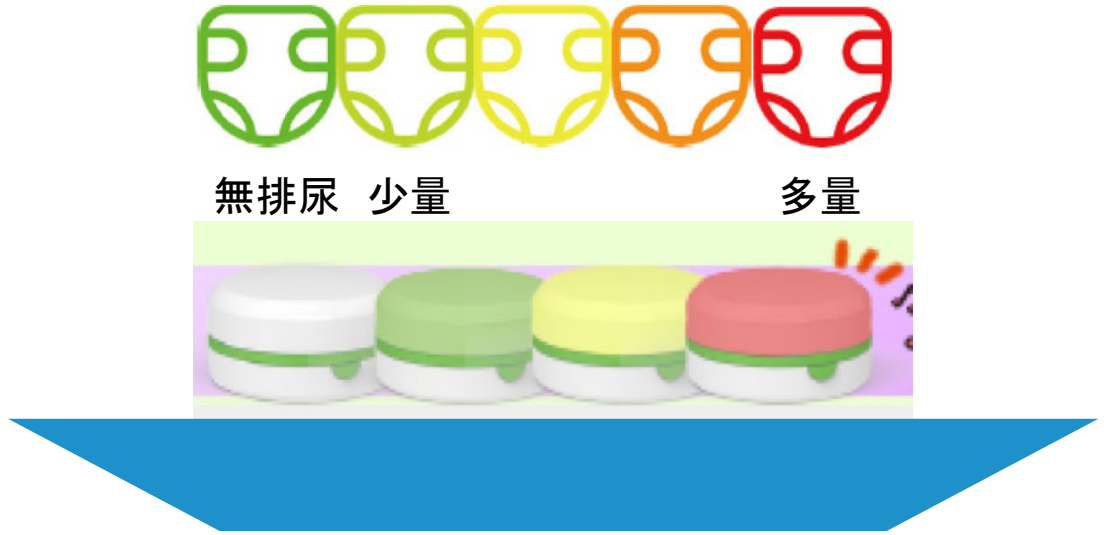

透過減少無效的尿片更換與不必要的照護，可以降低照護者的負擔。同時，可以選擇最佳時機提供排泄照護，也能減少被照護者的非舒適時間。

資料來源｜雲林縣輔助器具資源中心黃劭瑋主任、佳樂美公司｜2026年03月





▲ 専用お知らせ機器

◀ DFree

長照 智慧輔具

- EI 01 移位類
- EI 02 移動類
- EI 03 排泄類
- **EI 04 居家照顧床類**
- EI 05 安全看視類

【EI 04】居家照顧床組(含床墊及床架)
【EI 04】氣墊床
【EI 04】床墊
【EI 04】床架(含側欄)
【EI 04】床用感應墊

EI 04	居家照顧床類	長期臥床、執行翻身或坐起活動經常有困難，或下肢與平衡功能不佳之高跌倒風險者，需使用輔助照顧長時間臥床或不定時離床裝置	一、居家照顧床組(含床墊及床架)、床墊、氣墊床、床架(含側欄)或床用感應墊，並應符合下列功能之一： (一)可進行活動監控或生理數據記錄，藉由影像、壓力、訊號或其他方式感測，或透過雲端方式管理數據，並具有掌握受照顧者活動及異常事件通報功能，且得透過應用程式、簡訊、社群媒體或其他方式即時推播訊息、分析判斷與回饋機制(使用者或設備本體)之設備。 (二)具備壓力偵測、行動感知、離床活動或其他任一反應。 二、具異常事件通報功能，如久臥或翻身次數提醒、離床警報或其他方式。	由長照特約單位訂定，並報經地方主管機關備查

資料來源｜全國法規資料庫｜長期照顧服務申請及給付辦法｜2025年06月19日

回首頁

呼吸詳細


9月13日 12:00 ~ 9月14日 12:00

休息呼吸率: 17.3 次/分

9月13日 06:00 ~ 現在

最高呼吸率:	33.0
最低呼吸率:	13.0
呼吸率中位數:	15.0
平均呼吸率:	17.0
標準差:	3.8


- 呼吸率 次/分鐘
- 呼吸趨勢線

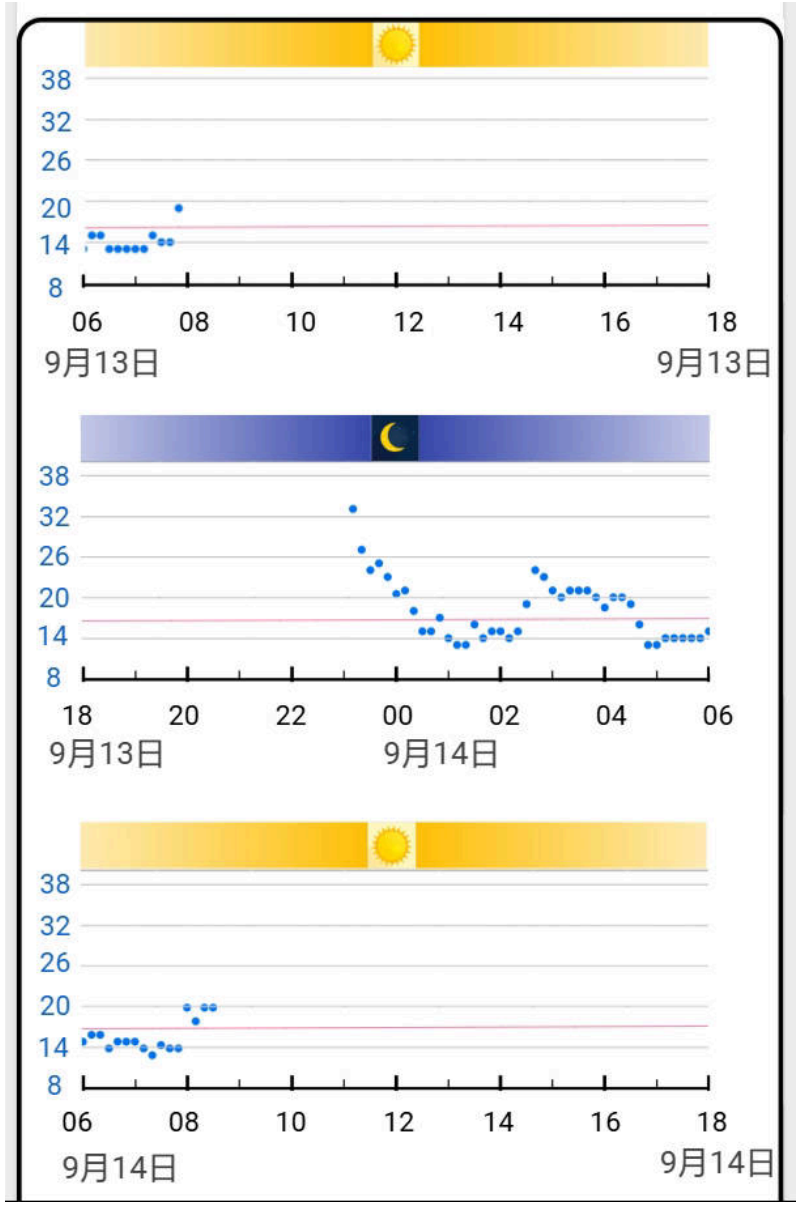

回首頁

翻身分析


一週 翻身次數與平均間隔時間:

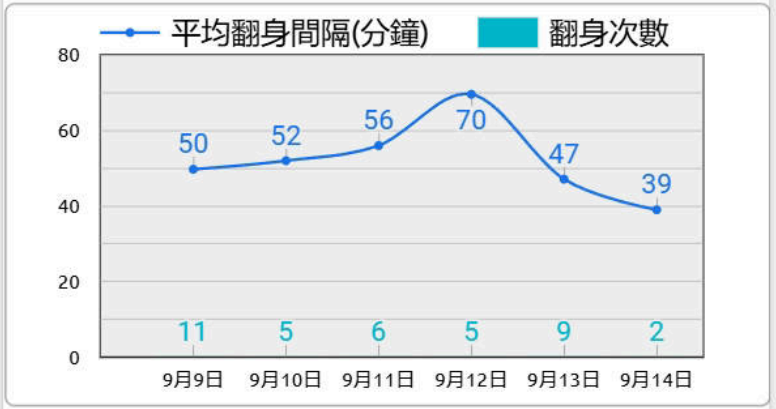


詳細資料: (近兩日)

	月/日	時 (24H)	翻身次數
1.	9月14日	2	1
2.	9月14日	1	1
3.	9月13日	23	1
4.	9月13日	7	2

案例: 吳伯伯避免成為重症患者

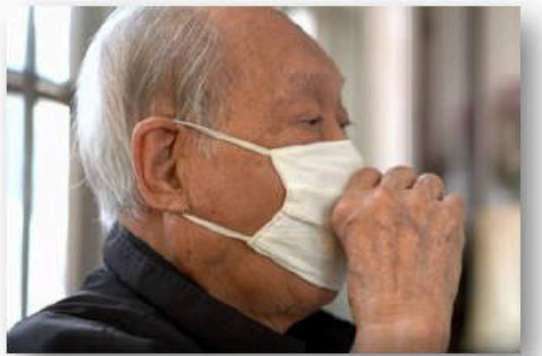

呼吸率追蹤

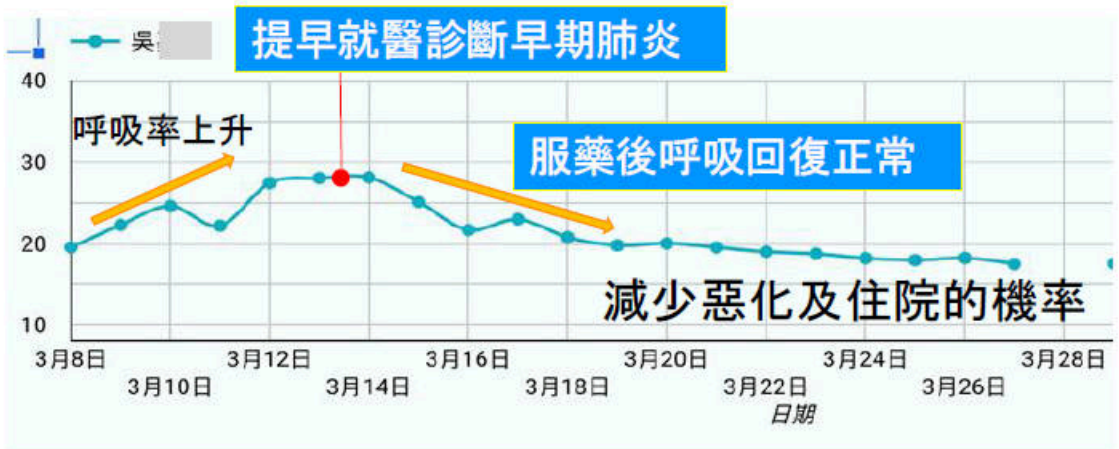


休息追蹤





肺炎的提早發現避免惡化

案例:郭伯伯 安寧陪伴


2022年1月28日 - 2022年2月24日
昨日與今日 呼吸通知
2
新增
長輩離開
家屬入院陪伴
每日休息平均呼吸
resident_name
respiration
26.51
呼吸持續升高, 醫生判斷, 安寧
呼吸通知分析
住民
類型
計數
respirationRateGreater
46
呼吸異常通知
24 hr 分時分析
Record Count

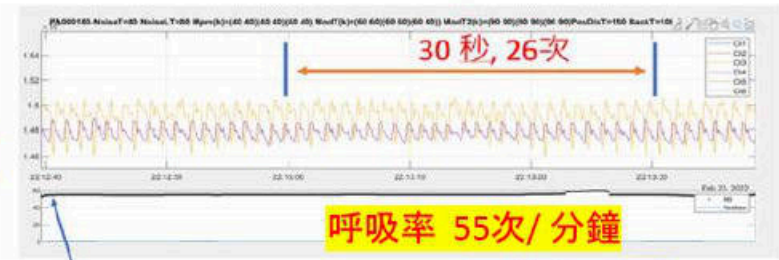
30 秒, 26次
呼吸率 55次/ 分鐘
正常為12~26
~52-55

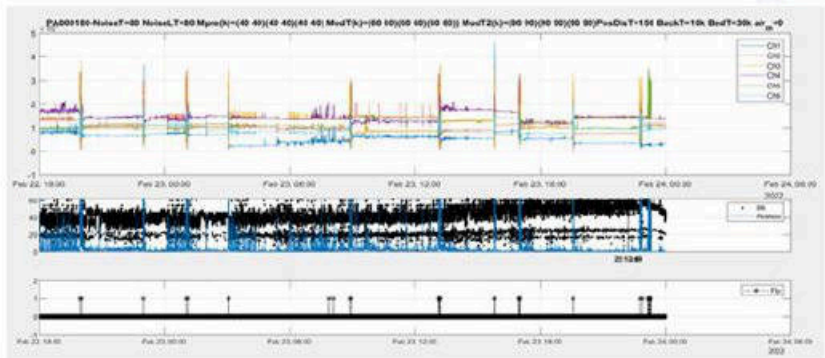

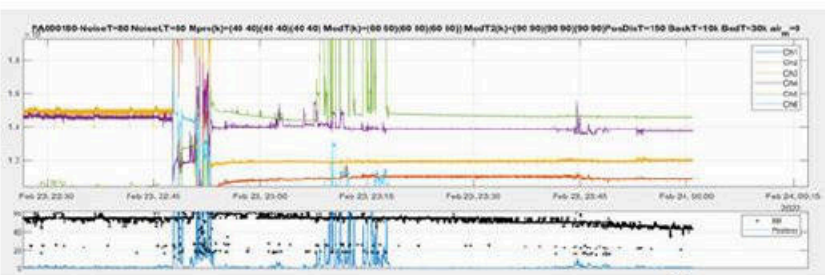

智慧照護床墊

WhizPad Care Relieve System




（二）智慧照護床墊管理系統介紹 - 後端管理系統-臥床歷程與生活常模查詢

- 臥床狀態顯示
- 臥床活動量顯示
- 睡眠活動分析
- 壓力點統計與分析
- 臥床常模分析



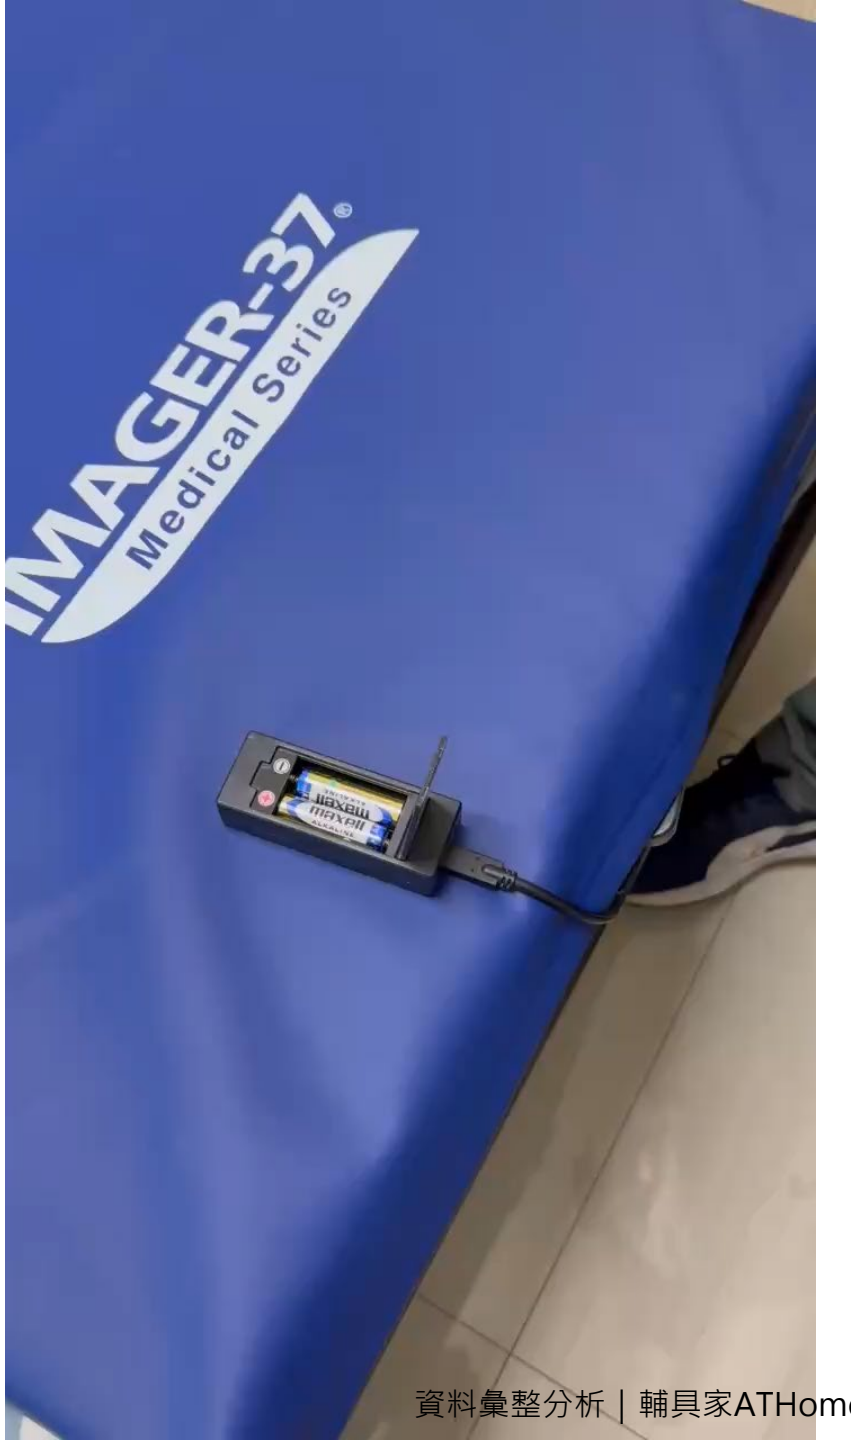


IMAGER-37
Medical Series
maxell
MAXELL

12:31

Care Relief System
安心臥照護系統 家用版

返回

BLE閘道



WhizConnect



NB-IoT

BLE裝置



WhizPad



FORA P30



FORA O2



FORA IR42

2:44

Care Relief System
安心臥照護系統 家用版

一般 | WhizConnect

所有裝置



mini臥房
08F80D6009B1
設定 刪除



臥房
08F80D6009D1
設定 刪除



mini床
08F80D611545
設定 刪除


新增裝置 | 分享裝置

首頁 管理 設定

9:16

Care Relief System
安心臥照護系統 家用版

智慧床墊資訊 | 量測資訊

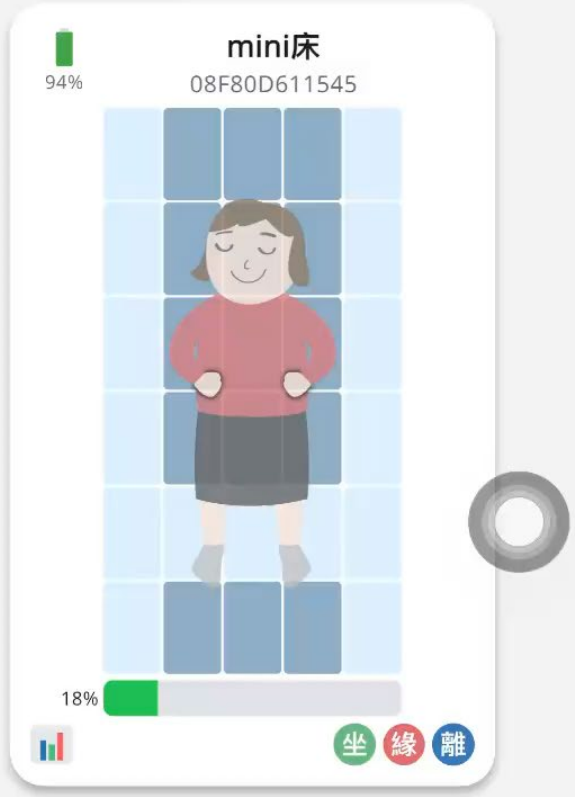

首頁 管理 設定

06月30日


長照 智慧輔具

- EI 01 移位類
- EI 02 移動類
- EI 03 排泄類
- EI 04 居家照顧床類
- **EI 05 安全看視類**

EI 05	安全看視類	長期臥床、獨居、失智症者或需生理或活動數據監控者	一、穿戴式裝置(不含手機、手錶)、感應式或室內建置式設備，並應符合下列功能之一： (一)藉由物聯網(IOT)方式，以語音、應用程式或遠端控制驅動家庭使用之相關設施，並具操控、安全防護及警示功能之設備。 (二)具影像或動作感應、監測、安全防護、遠端開關及編寫自動化情境控制功能，並可使用應用程式或智慧音箱控制相關系統與設備。 二、本組合為補助應用程式及其搭配穿戴式、感應式或室內建置式之訊號發射或接收設備，但不補助手機、手錶或其他日常生活用品。	由長照特約單位訂定，並報經地方主管機關備查

資料來源｜全國法規資料庫｜長期照顧服務申請及給付辦法｜2025年06月19日



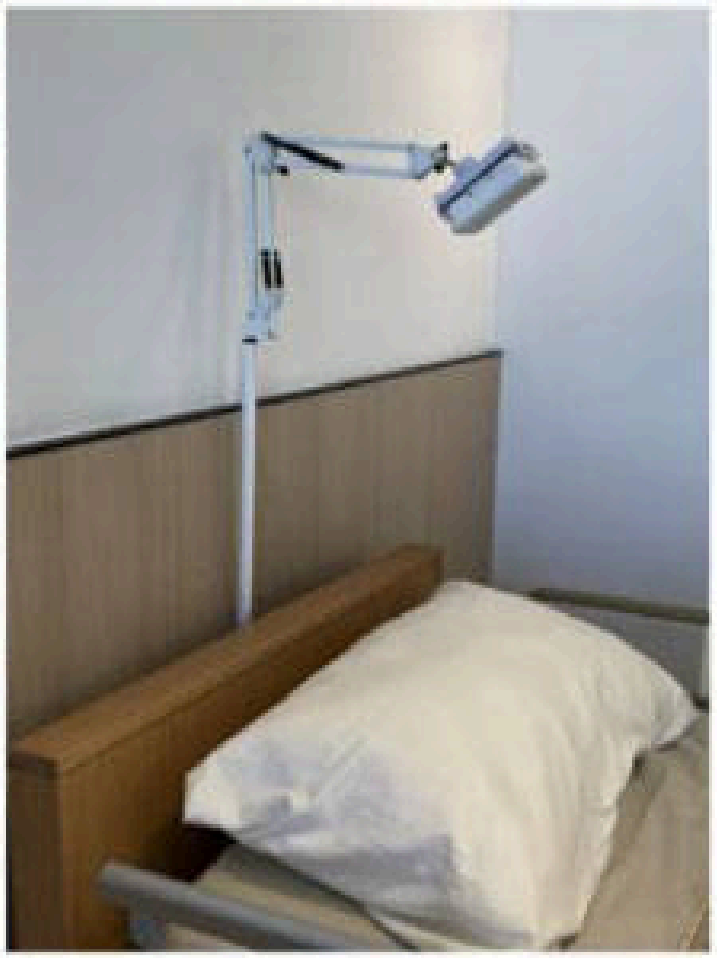



Millimeter-wave radar detects physiological signals


Hospital / Home settings

每日bRDI、PB%快篩推播 & PB報告

LINE Notify

【Bestshape VS 】
睡眠快篩報告
日期: 04.11 21 - 04.12 07
場域: RD Test Site (21-07)
受測人數: 4 位
bRDI≥30人數: 0 位 (0%)
(bRDI與PB定義註記於群組記事本)
下列數值依序呈現：
bRDI / Sleep time / PB%/
PB events / Cycle-length avg.

床號: 0120
23/ 4.8H/ 15%/ 40/ 80.0
床號: 112
20/ 5.3H/ ≤5%/ -/ -
床號: 199
20/ 4.1H/ 16%/ 58/ 57.4
床號: 193
12/ 2.9H/ 9%/ 16/ 89.8

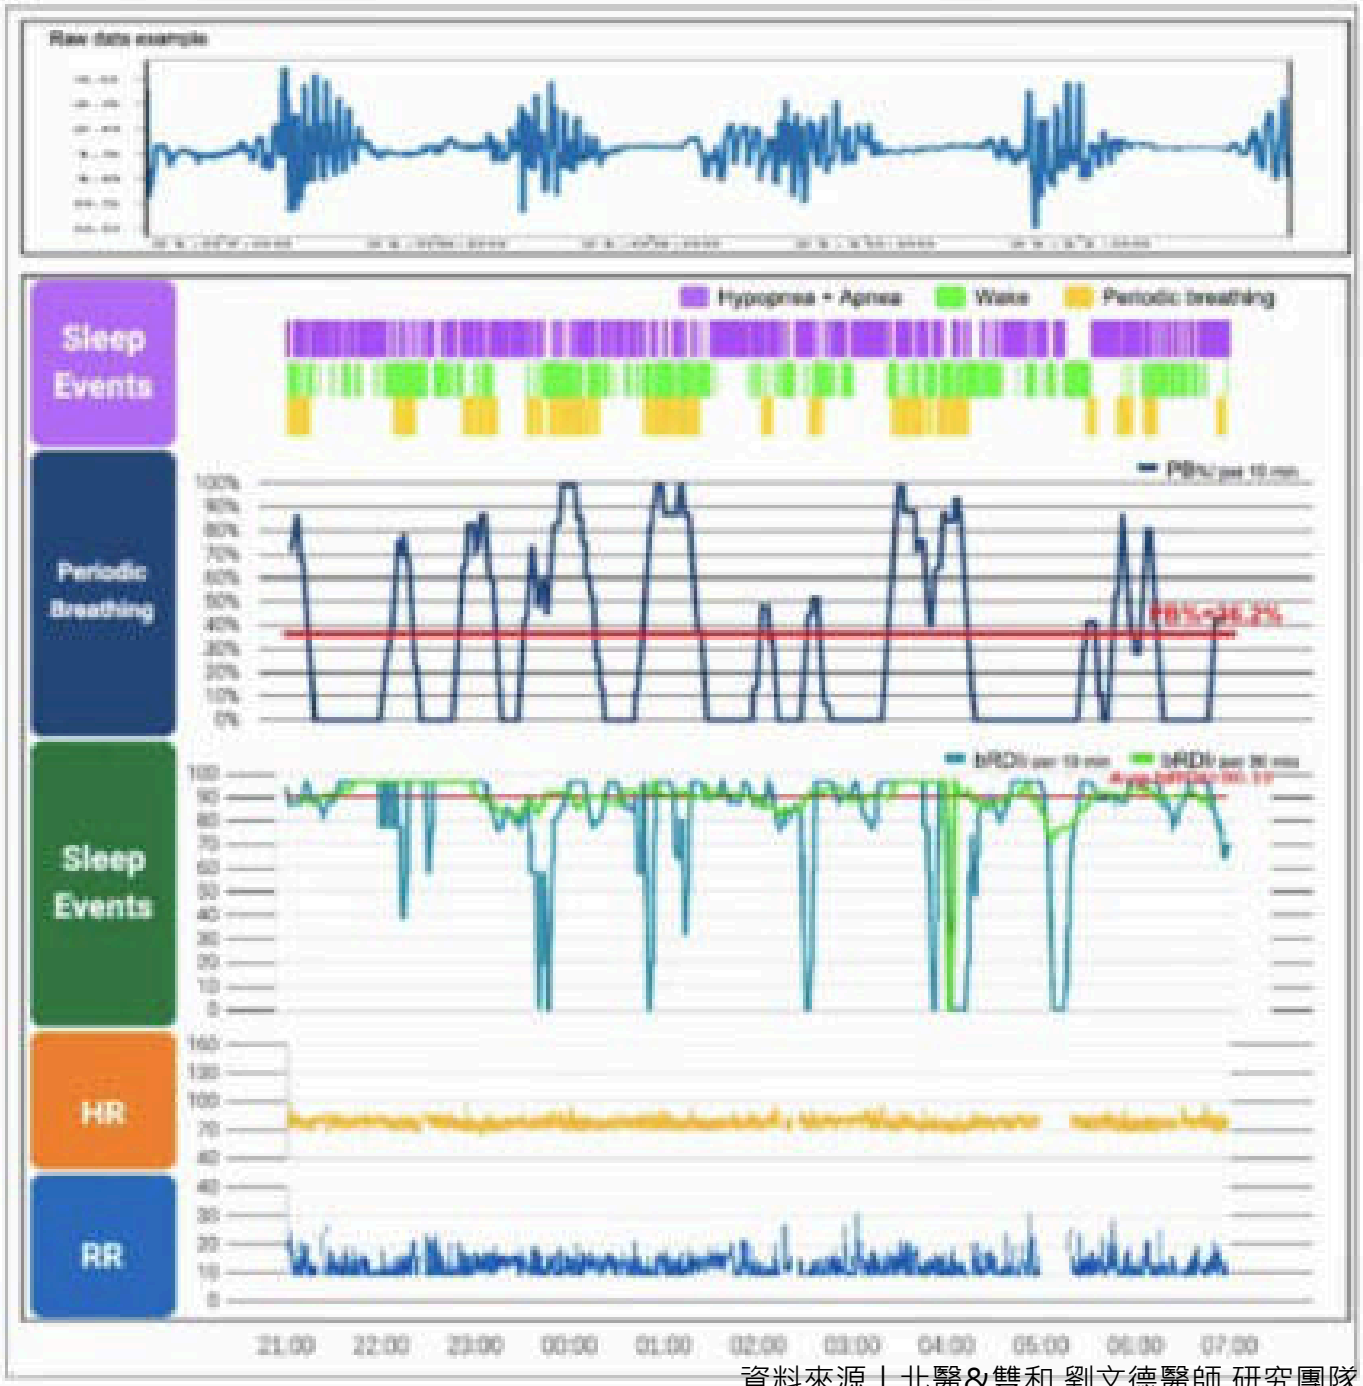

bRDI 88.2 + PB 37.8%

睡眠檢測報告

BestShape®

姓名	零四一六	身高	- 公分
性別	M	體重	- 公斤
年齡	-	BMI	-
測試周期	2025/03/11 21:00 – 2025/03/12 12:00		

睡眠品質分析		參考
上床	03/11 21:36	> 7時
起床	03/12 05:18	
睡眠效率(睡眠時間/在床時間)	87.9%	≥ 85%
睡眠時間	6 時 46 分	
睡眠狀態		
• 清醒	11 分, 2.7%	
• 快速動眼期	0 分, 0.0%	21–30%
• 淺眠	6 時 39 分, 95.6%	≤ 80%
• 深眠	7 分, 1.7%	16–20%
入睡耗時	30 分	< 30分


休息狀態	
穩定休息	6 時 24 分, 91.4%
時時醒醒	33 分, 7.9%
離床	1 次, 3 分, 0.7%
翻動	12 次

參考文獻: 美國國家睡眠基金會 (National Sleep Foundation, NSF)

睡眠呼吸指數

呼吸中止指數	88.2 事件/小時	低通氣呼吸 + 呼吸中止	427 事件

呼吸中止指數: **輕度**=5 - 14.9, **中度**=15 - 29.9, **重度**=30以上
*呼吸中止指數為每個小時的呼吸中止事件次數
•**呼吸中止指數**: AHI ≥ 30/h 靈敏性: 92.08%, 專一性: 80.13%



生理訊號


呼吸率		心率	
平均 13.2 次/分	標準差 1.7	平均 62.4 次/分	標準差 8.8
血氧			
缺氧指數	51.8 事件/小時	缺氧事件次數	268

* 缺氧指數與缺氧事件為AI模型透過睡眠的呼吸事件的時間與頻率預測產生
• **缺氧指數準確度**: ODI ≥ 10 靈敏性: 80.49%, 專一性: 66.66%

睡眠檢測報告

BestShape®

姓名	零四一六	身高	- 公分
性別	M	體重	- 公斤
年齡	-	BMI	-
測試周期	2025/03/11 21:00 – 2025/03/12 12:00		

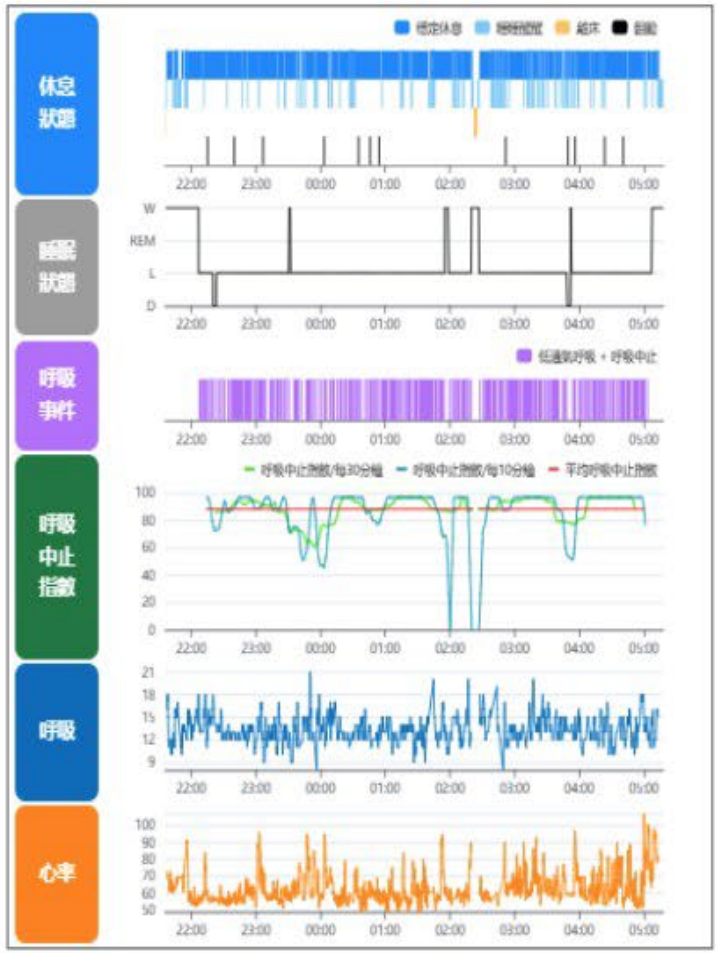


週期性呼吸分析


BestShape®

測試周期	2025/03/11 21:00 – 2025/03/12 12:00	睡眠時長	6 時 46 分

週期性呼吸			
週期性呼吸發生率(週期性呼吸時間/睡眠時間)	37.8 %		
週期性呼吸事件	21.1 事件/小時	148 事件	
週期性呼吸時長	平均 64.0 秒	標準差 5.4 秒	
週期性呼吸最大時長	85.5 秒		

陳施氏呼吸			
陳施氏呼吸發生率(陳施氏呼吸時間/睡眠時間)	- %		
陳施氏呼吸/週期性呼吸時間比例	- %		
陳施氏呼吸事件	- 事件/小時	- 事件	
陳施氏呼吸時長	平均 - 秒	標準差 - 秒	

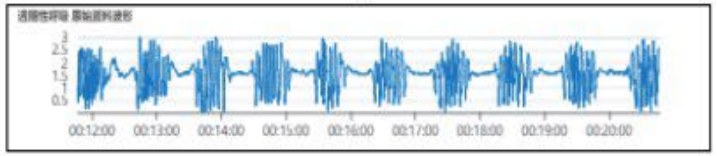

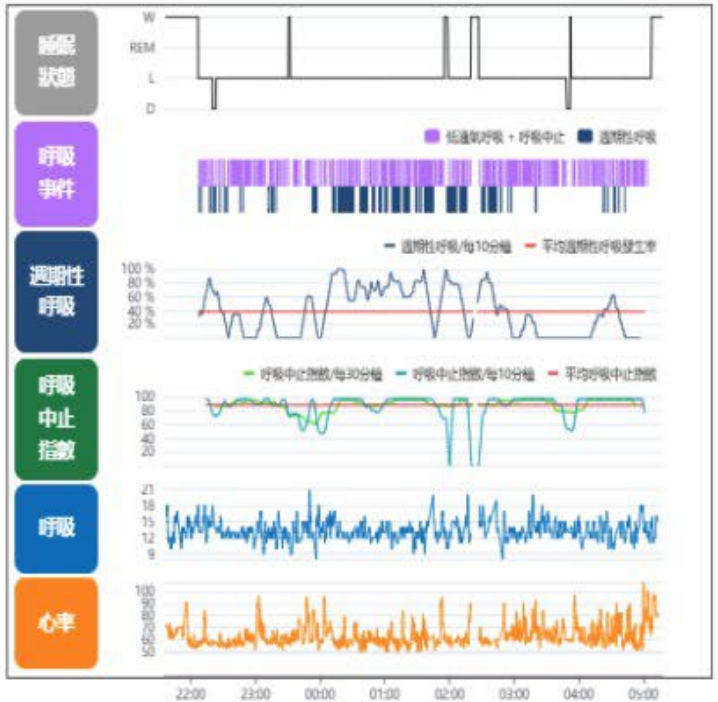

核心特色 7 ：智慧居家跌倒偵測應用系統

- 分析：心跳、呼吸、生活作息、離臥床等特徵綜合與醫警事件進行風險評估建模及分群
- 將長者分為醫警風險低、中、高之群組，分別建構醫警預測模型






及時的坐姿提醒



1 通知列訊息提醒

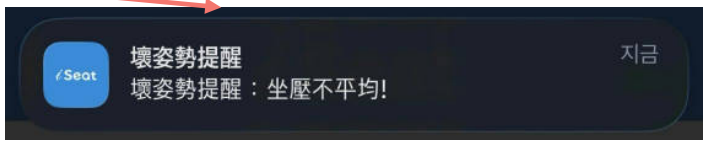

2 快顯視窗提醒




3 蜂鳴器提醒



資料來源｜輔具家ATHome｜康揚Karma｜2026年03月28日

簡單且直覺的
即時視覺回饋

提升臨床專業與使用者/
家屬的溝通效率！

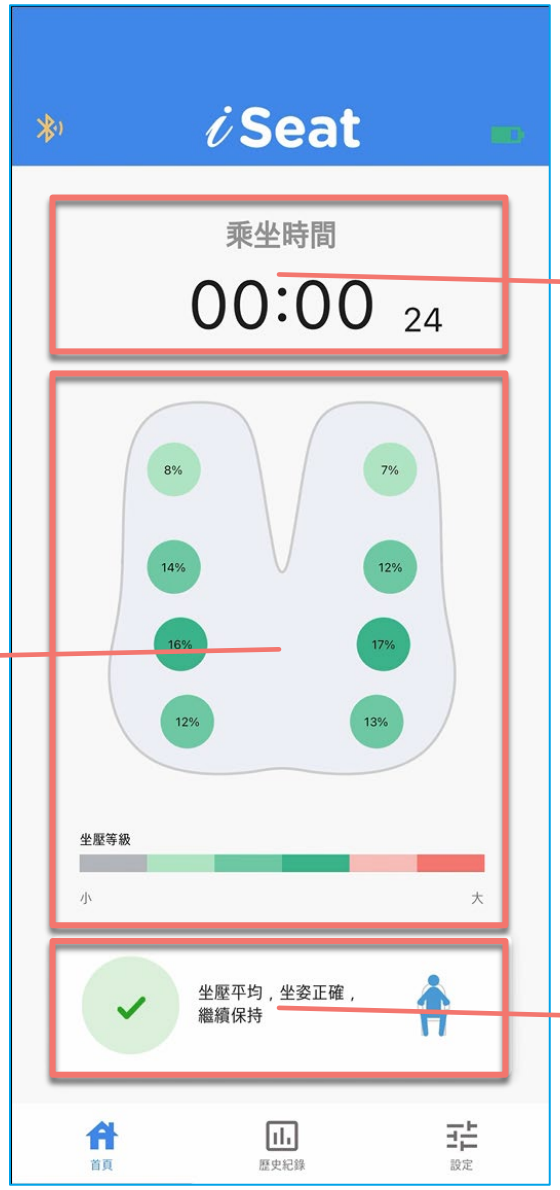

累計的
乘坐時間

即時可視的
壓力變化

即時可視的
狀態顯示

資料來源｜輔具家ATHome｜康揚Karma｜2026年03月28日

11:31

Care Watch

毛旻🦕｜客廳沙發🛋️
4 /5000 步
2025/09/10 09:53

毛旻🦕｜🧍mini床墊🛏️
15 /5000 步
2025/09/10 08:50

爸媽🏠｜👴爸比床🛏️
14 /5000 步
2025/09/10 04:26 → 我爸9/10起床時間

爸媽🏠｜👩媽咪床🛏️
5 /5000 步
2025/09/10 05:12 → 我媽9/10起床時間

劉小旻｜手錶⌚
0 /5000 步
2025/08/10 23:27



感應器(床用款)

8:46

裝置

毛旻🦕｜浴室PIR感應🛁⚡
2025/08/29 04:00

毛旻🦕｜浴室門🛁🚪
12 分鐘前

毛旻🦕｜大門口🚪
5 分鐘前

爸媽🏠｜大門口🚪
20 分鐘前

爸媽🏠｜冰箱A🍽️
6 分鐘前



震動感應器(一般款)

8:46

Station

毛旻🦕｜客廳🛋️
已連線

毛旻🦕｜書房📖
已連線

毛旻🦕｜廚房🍽️
已連線

爸媽🏠｜一樓臥房Station
已連線

爸媽🏠｜二樓臥房station
已連線

爸媽🏠｜一樓客廳station
已連線




訊號接收器Station


7:48
提醒
無法偵測到多個
偵測器，請檢查裝置電池和位置
6 小時
最後活動
爸媽🏠｜冰箱A🍽️
48 分鐘前
Care Watch
顯示更多
緊急按鈕🔘‼️Button_E9A3
爸媽🏠｜👴爸比床🛏️
1 /5000 步
2026/07/27 14:01
隨身感應器
劉小旻🧍｜公事包
Powered by Care Active

Emergency SOS notification

The cloud sends the critical notifications to everyone when the emergency button is triggered.

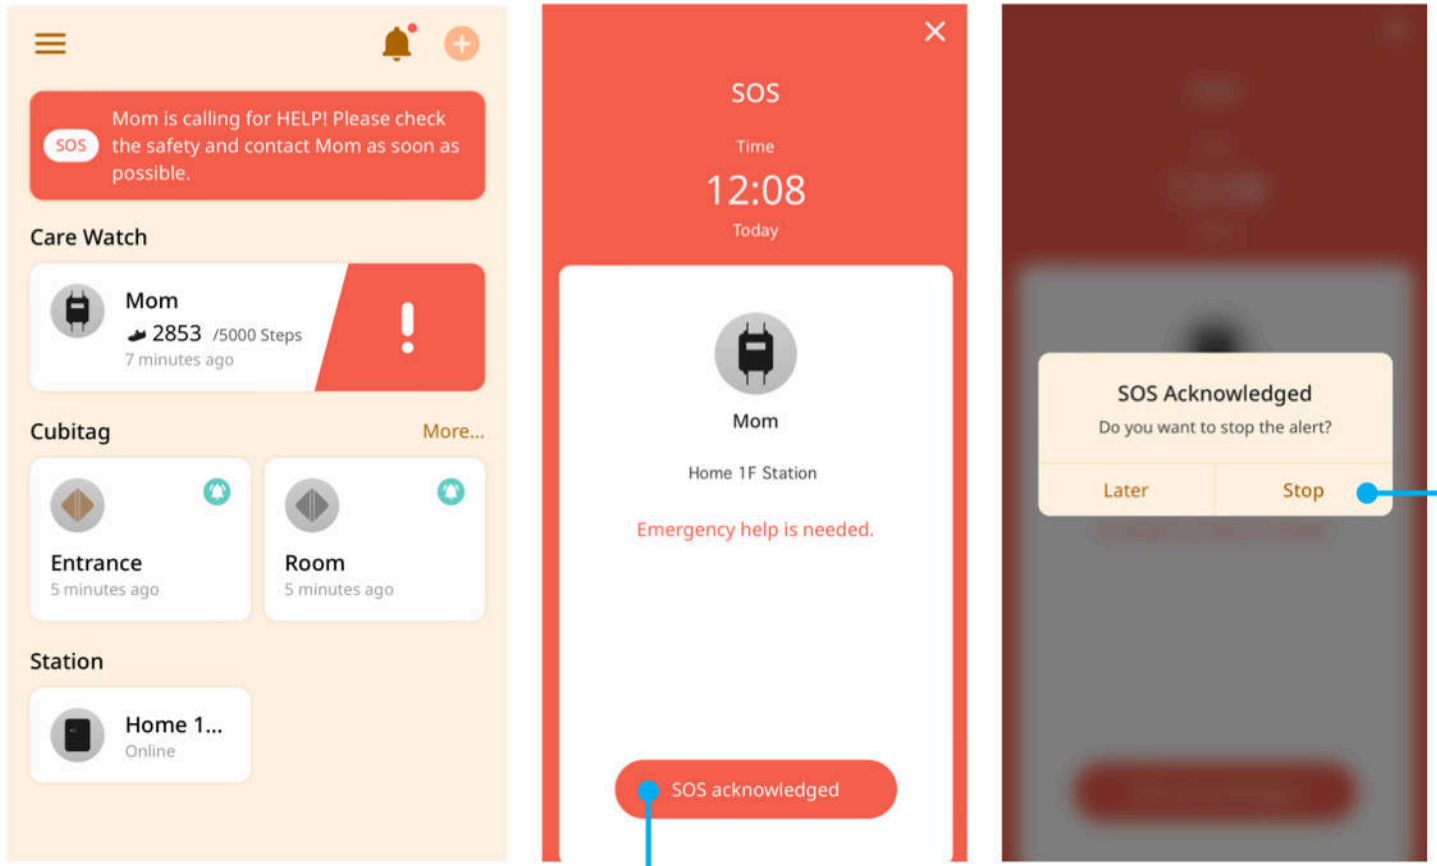


As soon as one person presses stop, the alert notification will be disengaged.

If no one stops it, the notification will be sent every 5 minutes, until someone disengages it.

內建遠距視訊，讓關心即時到位

小安照顧助理內建遠距視訊功能，無需額外安裝 App，護理人員與家屬可隨時連線，即時掌握家中長輩的生活與健康狀況。
系統採用高整合設計，讓遠距關懷更有效率，提升照護的便利性，打造真正安心、智慧照護新體驗。

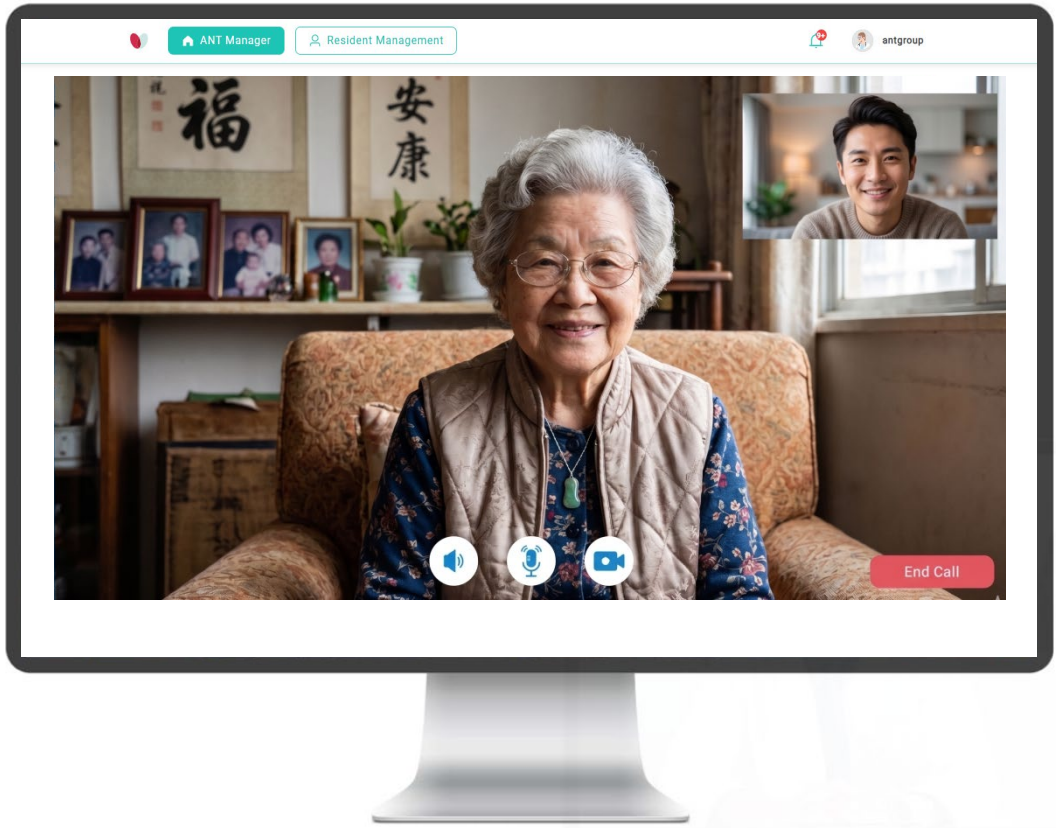



20年後的自己，您會是哪個行動力等級？


1 行動自如



2 平衡穩定度較差



3 需扶著走




4 無法走.但坐得穩



5 無法走.且坐不穩




整體而言，約有15%為重度/極重度失能 需要長期照顧協助

1	2	3	4	5
行動自如	平衡穩定度較差	需扶著走	無法走.但坐得穩	無法走.且坐不穩
				

身體狀況	健康	衰弱	失能	重.極重度
人口佔比	約68%	約17%		約15%
2025年 500萬名銀髮族 (超高齡社會)	約340萬人	約85萬人		約75萬人

各階段「行動力等級」重點目標

行動力等級

1	2	3	4	5
行動自如	平衡穩定度較差	需扶著走	無法走.但坐得穩	無法走.且坐不穩
				
盡情豐富人生	預防退化失能	打造自立生活	積極復能自主	發揮最大潛能

行

1

行動自如




2

平衡穩定度較差



3

需扶著走



4

無法走.但坐得穩



5

無法走.且坐不穩




LEVEL1 | LEVEL2 | LEVEL3(單手) | LEVEL3(雙手) | LEVEL4-5








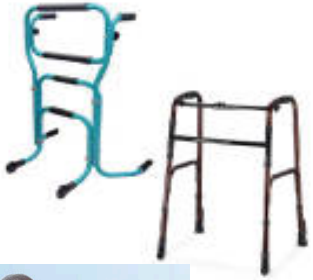








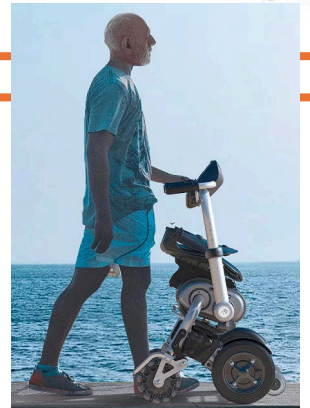



長照3.0智慧科技輔具｜對民眾的實質影響與選擇建議（2026年07月01日起）

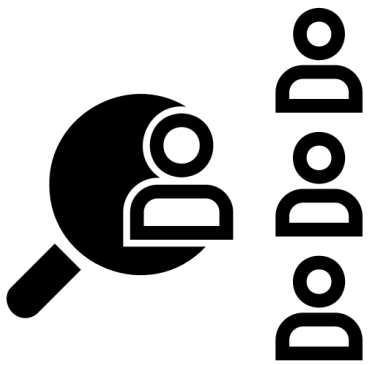


長照3.0將擴大服務對象（2026年1月1日起，智慧輔具7月起）

- **全年齡失智症者**：
  從過去僅限50歲以上失智症者，放寬至未滿50歲的年輕型失智症者，只要符合失能程度評估，即可申請長照服務。
- **急性後期整合照護計畫（PAC）對象**：
  PAC收案對象（如腦中風、燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭與衰弱高齡病人等）在出院後若經評估仍失能，可無縫銜接長照3.0服務，避免出院後的照顧空窗期。

短期需求｜長照3.0租賃搭配身障購買



積極恢復健康｜長照租賃3.0強化居家復能

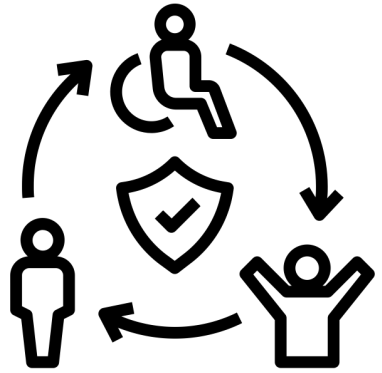

資料彙整分析｜輔具家ATHome

輔具家 ATHome

| 輔具家ATHome |

專注長照第三包錢：輔具 X 住宅改造 X 爬梯機

劉旻宜MINI / 營運長 / 物理治療師
athome.taiwan@gmail.com

LINE請搜尋 @athome.taiwan

輸入「JUBO好朋友」取得今日簡報完整檔

